


TERMINOS DE REFERENCIA

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ESPECIALIZADO A TODO COSTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE LAS IPRESS DE LA UNIDAD
EJECUTORA DE SALUD SAN IGNACIO"

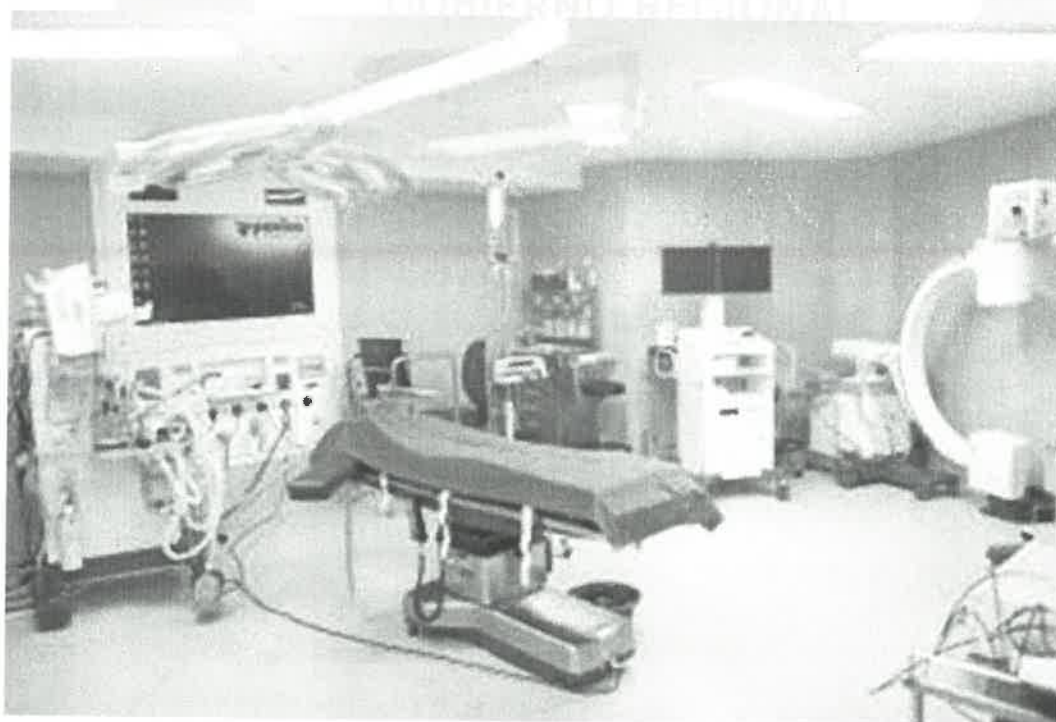

JOSE HONER VARGAS SAMAÑE
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

TERMINOS DE REFERENCIA

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO A TODO COSTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA DE SALUD SAN IGNACIO"

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo especializado a todo costo de equipos biomédicos de las IPRESS de la Unidad Ejecutora de salud San Ignacio.

2. FINALIDAD PÚBLICA

El presente proceso de contratación del servicio de mantenimiento preventivo/correctivo busca fortalecer a los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención, a través de Mantener operativos los equipos de los EESS de la jurisdicción de la Unidad Ejecutora Salud San Ignacio para brindar adecuada atención a los usuarios de los servicios de salud que acuden a los referidos establecimientos de salud.

3. ANTECEDENTES

- Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS), de la Red de Salud San Ignacio cuentan con diferentes equipos biomédicos los que permiten brindar una atención de calidad a los usuarios de salud, pero ello depende del buen funcionamiento de dichos equipos, por lo que resulta imperante realizar el mantenimiento tanto preventivo como correctivo de los mismos.
- Los equipos biomédicos deben presentar un funcionamiento óptimo de forma permanente.
- La operatividad de los mismos representa la garantía de un diagnóstico adecuado a fin de efectuar un tratamiento correcto.
- A fin de garantizar la permanente funcionalidad de cada uno de los equipos, se les debe someter a un servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo especializado.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

- **Objetivo General**

Contratar a una empresa para que realice a todo costo, el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos de las IPRESS de la jurisdicción de la Unidad Ejecutora Salud San Ignacio, para mantener su operatividad y satisfacer la demanda de atenciones.

- **Objetivos Específicos**

Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos, a fin de mantenerlos operativos y poder satisfacer la demanda de atenciones en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, según detalle:



JOSE ROYER VARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

CUADRO RELACIÓN DE EQUIPOS

Íte m	DENOMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	CANT.	IPRESS DONDE SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO
1	HEMOGLOBINOMETRO	532266650057	EKF DIAGNOSTIC	1000 MA	1	YANDILUZA
2	INCUBADORA DE TRANSPORTE	532269990001	FANEM	IT-158-TS	1	SAN JOSE DE LOURDES
3	OXIMETRO DE PULSOS DIGITAL	532288390024	ADVANCE	PQ-100B	1	SAN JOSE DE LOURDES
4	ASPIRADORA DE SECRECIONES PORTATIL	532208120024	CAMI	NEW ASKIR 30	1	SAN JOSE DE LOURDES
5	MONITOR FETAL	532281880006	EDAN	F3	1	SAN JOSE DE LOURDES
6	HEMOGLOBINOMETRO	532266650037	EKF DIAGNOSTIC	MEDICAL	1	NUEVO TRUJILLO
7	MANOMETRO DE BALON DE OXIGENO	532246190012	LINCOLN	MEDICAL	1	SIETE DE AGOSTO
8	CENTRÍFUGA PARA TUBOS	532220490024	LWS-USA	U8V-2	1	HUARANGUILLO
9	CENTRÍFUGA PARA TUBOS	675003800005	GREETMED	GT119-200	1	HUARANGUILLO
10	PANTOSCOPIO	532289980029	RIESTER		1	HUARANGUILLO
11	CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL	112220300003	VESTFROST		1	FRONTERA SAN FRANCISCO
12	REFRIGELADORA Y CONGELADORA PARA VACUNAS	112260390110	VESTFROST		1	FRONTERA SAN FRANCISCO
13	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	532266650029	EKF DIAGNOSTIC	3000-0031-6801	1	APANGOYA
14	ESTERILIZADOR	532260470062	FAAETA	45H	1	CALABOZO
15	HEMOGLOBINOMETRO	532266650074	EKF		1	LA CAPILLA
16	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	532266650040	EKF-DIAGNOSTIC	3000-00316801	1	LA LIMA DE LA COIPA
17	ESTERILIZADOR DE CALOR SECO 35-40L	532260470081	JP SELECTA	DIGITEHEAT	1	LLANO GRANDE
18	ASPIRADORA DE SECRECIONES	532208120018	THOMAS	MEDICAL	1	SAN FRANCISCO
19	CAMILLA	536427150015			1	PACAYPITE
20	LAMPARA INCANDESCENTE	532271820059			1	PACAYPITE
21	PANTOSCOPIO	532289980074	RIESTER		1	PANCHIA
22	ESTERILIZADOR	532260470071	FAETA	45H	1	PANCHIA
23	HEMOGLOBINOMETRO	532266650061	EKF		1	PANCHIA
24	CENTRIFUGA DE 8 TUBOS	532220490013	LW SCIENTIFIC		1	PANCHIA
25	MICROCENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO	532220690002	MPW	MPW-215	1	CHURUYACU
26	CONTADOR HEMATOLOGICO	532223110003	GEMMY	DBC-8E	1	CHURUYACU
27	CENTRIFUGA PARA TUBOS	532220490006	HETTICH	206	1	CHURUYACU
28	MICROSCOPIO BINOCULAR	532278560057	CARL-ZEISS	PRIMO STAR	1	CHURUYACU
29	MONITOR FETAL	532281880010	EDAN		1	CHURUYACU
30	EQUIPO NEBULIZADOR ELECTROCO PORTATIL	532255710094	INALAMAX	N5	1	LA BERMEJA
31	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	532266650066	EKF	3000-0031-6801	1	LA BERMEJA
32	HEMOGLOBINOMETRO	532266650064	EKF DIAGNOSTIC	300-0810-6801	1	CHARAPE
33	MONITOR FETAL	532281880009	EDAN	F3	1	HUARANGO
34	CAMILLA GINECOLOGICA	536427150048	KL-2C		1	HUARANGO
35	AIRE ACONDICIONADO	112236140004	ELECTROLUX		1	HUARANGO
36	HEMOGLOBINOMETRO	532266650022	EKF DIAGNOSTIC	3000-0031-6801	1	HUARANDOZA
37	CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL	112220300009	VESFOROST	MF-114	1	HUARANDOZA



JOSE ROYER VARGAS SAMAHUE
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

38	CONGELADORA	112220300016	VESTFROST	MF 114	1	LA MUSHCA
39	ROTADOR SEROLOGICO	532293140003	DIGISYSTEM	DSR-2800D	1	SAN IGNACIO
40	ASPIRADORA DE SECRECIONES PORTATIL	536430710002	HERBEI PUKANG	F-46	1	SAN IGNACIO
41	INCUBADORA PARA BEBES - INCUBADORA PARA NEONATOS 150 V	532288390044	EDAN	M3	1	SAN IGNACIO
42	COCHE DE PARO	112220300018	VESTFROST A/S	MF314	1	SAN IGNACIO
43	COCHE DE PARO EQUIPADO	532245240001	FANEM	BILITRON 3006 BTP	1	SAN IGNACIO
44	OXIMETRO DE PULSOS	532278560078	OPTIKA	B-292PLI	1	SAN IGNACIO
45	CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL	532220490037	NEXTSPIN	NEXTSPIN-112	1	SAN IGNACIO
46	EQUIPO DE FOTOTERAPIA	532220490034	NEXTSPIN	NEXTSPIN-112	1	SAN IGNACIO
47	ESTERILIZADOR CALOR SECO	532278560042	ZEISS	PRIMOSTAR	1	SAN IGNACIO
48	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	532230960098	MEDILU	FD1	1	EL HUABO
49	MONITOR FETAL	532281880002	EDAN	F3	1	TABACONAS
50	HEMOGLOBINOMETRO	532266650177	EKF DIAGNOSTIC	3040-0010-0218	1	CHARAPE
51	DOPPLER FETAL	532230960114	EDAN	S-D5	1	HUARANGO
52	HEMOGLOBINOMETRO	532266650134	EKF	3040-0010-0218	1	HUARANGO
53	REFRIGERADORA PARA VACUNA ICE LINED 75L	1122603900095	VESFOROST	MK-204	1	HUARANDOZA
54	ECOGRAFO	532250000003	SANSUNG	SONOACE R3	1	TAMBORAPA PUEBLO
55	CUNA DE CALOR RADIANTE	532278560062	ZEISS	PRIMOSTAR	1	SAN IGNACIO
56	HEMOGLOBINOMETRO	532266650088	EKF DIAGNOSTIC	300-0031-6801	1	PUERTO SAN FRANCISCO
57	DOPPLER PORTATIL	532248020014	MEDIBLU	FD1	1	YANDILUZA
58	EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO	532250000002	CHISON	8500	1	SAN JOSE DE LOURDES
59	ESTERILIZADOR A VAPOR - AUTOCLAVE DE 60 L	532260470046	TOPSTEL	CHS-ST065	1	SAN JOSE DE LOURDES
60	ESTERILIZADOR DE CALOR SECO DE 60 L	532260470080	MEMMERT	SN55	1	SAN JOSE DE LOURDES
61	EQUIPO NEBULIZADOR	532255710072	THOMAS	1147	1	SAN JOSE DE LOURDES
62	EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO	532210730001	JISICO	J-BSCV2	1	SAN IGNACIO
63	MONITOR FETAL INTRA PARTO PORTATIL	532270940005	HEFEI HEALTH	DL-620B	1	SAN IGNACIO
64	CUNA DE CALOR RADIANTE	532270940006	HEFEI HEALTH	DL-620B	1	SAN IGNACIO
65	ANALIZADOR BIOQUIMICO	532288390048	EDAN	H100B	1	SAN IGNACIO
66	MICROSCOPIO BINOCULAR	532260470137	MEMMERT ALEMANIA	SL55	1	SAN IGNACIO
67	CENTRIFUGA CLINICA PARA 12 TUBOS	532269040001	FANEM	1186	1	SAN IGNACIO
68	CENTRIFUGA CLINICA PARA 12 TUBOS	532230010003	CUMEDICAL		1	SAN IGNACIO
69	MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCULAR CON OPTICA AL INFINITO	532208120037	THOMAS	1633GL	1	SAN IGNACIO
70	MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCULAR CON OPTICA AL INFINITO	532269990004	GIGANTE	MILLENNIUM	1	SAN IGNACIO
71	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA - CAMARA DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO A2 X 6 FT	536430710001	HERBEI PUKANG	F-45-3	1	SAN IGNACIO
72	CAMILLA METALICA PARA EXAMEN GINECOLOGICO	532260470110	OVENS	EG	1	SAN IGNACIO
73	LAMPARA CIALITICA RODABLE	532227630002	FANEM		1	SAN IGNACIO



JOSE ROYER VARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

74	LAMPARA CIALITICA RODABLE	532250000013	UNITED IMAGING	IUSTAR160	1	SAN IGNACIO
75	OXIMETRO DE PULSOS	532281880011	BISTOS	BT350	1	SAN IGNACIO
76	MONITOR FETAL INTRA PARTO PORTATIL	532227630004	FANEM	MULTISYSTEM 2051	1	SAN IGNACIO
77	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO CAPACIDAD 220 kg	532202400007	EMPSUM	EMP-168	1	SAN IGNACIO
78	COCHE DE PARO EQUIPADO	536427150096	INSEGES	SIN MODELO	1	SAN IGNACIO
79	ESTERILIZADOR DE CALOR SECO	532281880014	EDAN	F9	1	SAN IGNACIO
80	MESA (DIVAN) UNIVERSAL PARA EXAMEN DE GINECOLOGIA Y UROLOGIA	602206520230	T-SCALE	M301	1	SAN IGNACIO
81	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	536430710003	LELYS-PERU	S/M	1	SAN IGNACIO
82	INCUBADORA CON CUPULA ESTANDAR	536450000020	S&S MEDICAL	S/M	1	SAN IGNACIO
83	DESFIBRILADOR	602206520232	GREETMED	GT131-200 HEALTHSAL	1	SAN IGNACIO
84	MESA (DIVAN) UNIVERSAL PARA EXAMEN DE GINECOLOGIA Y UROLOGIA	536450000019	S&S MEDICAL	S/M	1	SAN IGNACIO
85	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 105 L	112260390062	VESTFROST A/S	MK304	1	SAN IGNACIO
86	CORTINA DE AIRE 90 cm	112226730001	COLD POINT		1	SAN IGNACIO
87	UNIDAD DENTAL ELECTRICA COMPLETA	532298200017	NACIONAL		1	SAN IGNACIO
88	MICROMOTOR DENTAL	532278380015	NSK	EX -203C	1	SAN IGNACIO
89	MICROMOTOR DENTAL	532278380020	NSK	EX -203C	1	SAN IGNACIO
90	CONGELADORA	112216780001	VESTFROST	MF114	1	SAN ANTONIO
91	BALANZA DE PIE	602206160300	SECA	803	1	SAN ANTONIO
92	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 75 L	112260390133	VESTFORST-SOLUTIONS	VLS-304AAC	1	CHAMANAL
93	GLUCOMETRO PORTATIL	602246040247	ACCU-CHEK	ROCHE NC PERFOMA	1	CHAMANAL
94	SILLA DE RUEDA METALICA	536493790059			1	IHUAMACA
95	FRIGOBAR	112252140037	INDURAMA	RL-100	1	IHUAMACA
96	HEMOGLOBINOMETRO	532266650139	EKF	3000-0031681	1	PERINGOS
97	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	532230960122	EDAN	M-SONOTRAX II PRO	1	ALTO TAMBILLO
98	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	532266650123	EKF DIAGNOSTIC	3040-0010-0218	1	ALTO TAMBILLO
99	CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS 98 L	112260390054	VESTFROST	MF-114	1	ALTO TAMBILLO
100	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 48L	112260390087	VESTFROST	MK-114	1	ALTO TAMBILLO
101	GLUCOMETRO PORTATIL	602246040246	ACCU-CHEK	ROCHE NC PERFOMA	1	ALTO TAMBILLO
102	BALANZA PEDIATRICA DE SOBREMESA	602208560362	SECA	2	1	ALTO TAMBILLO
103	BALANZA DE PIE DE 150KG	602206160359	SECA	803	1	ALTO TAMBILLO
104	DETECTOR DE LATIDOS FETALES DOPPLER	532230960152	EDAN-SONOTRAX	SONOTRAX	1	PUERTO SAN FRANCISCO
105	UNIDAD DENTAL	532298200013	DENTO	BD901	1	BAJO IHUAMACA
106	REFRIGERADORA PARA VACUNAS	112260390135	VESTFROST	VLS 304AC	1	BAJO IHUAMACA
107	CENTRIFUGA	532220490041	S/M	PLC-05	1	BAJO IHUAMACA



JOSE ROMER VARELA SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

108	REFRIGERADORA PARA VACUNAS	112260390089	VESTFROST	MK-144	1	CHINCHIQUELLA
109	CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS 98 L	112260390056	VESTFROST	MK-145	1	CHINCHIQUELLA
110	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	532266650203	EKF DISGNOSTIC	3040	1	CHINCHIQUELLA
111	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	602206520234	GREETMED		1	CHINCHIQUELLA
112	BALANZA PEDIATRICA DIGITAL	602208560388	SECA	354	1	CHINCHIQUELLA
113	GLUCOMETRO	602246040236	ACCU-CHEK	ROCHE NC PERFORMA	1	CHINCHIQUELLA
114	FRIGOBAR	112252140040	INDURAMA	RI-100	1	CHINCHIQUELLA
115	PANTOSCOPIO	532289980137	RIESTER	3772-550	1	SAN MARTIN
116	BALANZA DE PIE DE 150KG	602206160407	SECA	803	1	SAN MARTIN
117	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	602206520263	GREETMED	GT131-200	1	SAN MARTIN
118	ASPIRADORA DE SECRECIONES	532208120062	SILFAB	N32	1	SAN MARTIN
119	HEMOGLOBINOMETRO	532266650135	EKF DIAGNOSTIC		1	SAN MARTIN
120	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO IC LINED 75 L	112260390137	VESTFORST-SOLUTIONS	VLS-304AC	1	SAN MARTIN
121	CONGELADORA PARA VACUNAS 171 L	112260390156		MF 214	1	SAN MARTIN
122	FRIGOBAR	112252140036	INDURAMA	RI-100	1	SAN MARTIN
123	GLUCOMETRO PORTATIL	602246040238	ACCU-CHEK	ROCHE NC PERFORMA	1	SAN MARTIN
124	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL ADULTO/PEDIATRICO	532288390061	EDAN	H1100B	1	SAN MARTIN
125	MANOMETRO CON HUMIFICADOR	602254240069	MR	YR-88E(M145015FG) MD300C29	1	SAN MARTIN
126	HEMOGLOBINOMETRO	532266650183	EKF-DIAGNOSTIC	3040-0010-02	1	EL HUABO
127	GLUCOMETRO	602246040243	ACCU-CHEK	ROCHENCERF	1	EL HUABO
128	LAMPARA INCANDESCENTE	532271820032	S/M		1	EL HUABO
129	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	602206520198	SECA		1	EL HUABO
130	DESTILADOR DE AGUA	532230630015	GFL	MA-45	1	SAN JOSE DE LOURDES
131	CUNA DE CALOR RADIANTE	532227630005	FANEM	AMPLA 2085	1	SAN JOSE DE LOURDES
132	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 145 L	112260390174	VESTFROST	VLS 404	1	SAN JOSE DE LOURDES
133	LAMPARA CIALITICA RODABLE	532270940007	HEFEI HEALTH	DL-620 B	1	SAN JOSE DE LOURDES
134	MESA DE PARTOS MECANICA	536458570009	HEFEI HEALTH	TF	1	SAN JOSE DE LOURDES
135	ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL	532234770002	CAREWELL	ECG1101G	1	SAN JOSE DE LOURDES
136	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE	532247220006	CARESTR AM DENTAL	CS 2200	1	SAN JOSE DE LOURDES
137	CAMILLA METALICA PARA EXAMEN GINECOLOGICO	536427150073	METAX		1	SAN JOSE DE LOURDES
138	MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCULAR CON OPTICA AL INFINITO	532278560043	CARL ZEISS	PRIMO STAR	1	SAN JOSE DE LOURDES
139	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 75 L	112260390100	VESTFROST MI	MK-304	1	SAN JOSE DE LOURDES
140	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 75 L	112260390125	VESTFROST	MKS240	1	SAN JOSE DE LOURDES
141	PULSIOXIMETRO	532288390005	EDAN	OO13582	1	SAN JOSE DE LOURDES
142	CONGELADORA	112260390043	VESTFROST	MF114	1	NUEVO TRUJILLO



JOSE ROYER BARGAS SAMANE
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

143	CONGELADORA	112260390077	VESTFROST	MK144	1	NUEVO TRUJILLO
144	MANOMETRO DE BALON DE OXIGENO	602254240042	WESTERN MEDICA	MEDICAL	1	SIETE DE AGOSTO
145	CONGELADORA	112260390194	VESTFROST	VLS-304A	1	FRONTERA SAN FRANCISCO
146	ANALIZADOR BIOQUIMICO	532202400008	EMPSUN		1	APANGOYA
147	HEMOGLOBINOMETRO	532266650185	EKF		1	APANGOYA
148	REFRIGERADORA DE CADENA DE FRIO	112260390010	VESTFROST	3000	1	CALABOZO
149	CONGELADORA DE CADENA DE FRIO	112260390050	VESTFROST	MF-114	1	POTRERO GRANDE
150	ESTERILIZADOR	532260470098	MEMMERT - ALEMANI	30-1060	1	POTRERO GRANDE
151	LAMPARA DE CUELLO GANSO	532271820061			1	POTRERO GRANDE
152	BALANZA PEDIATRICA	602208560337			1	POTRERO GRANDE
153	DETECTOR DE LATIDOS	532230960127	EDAN	SONOTRAXIIPRO	1	NAMBALLE
154	ASPIRADORA DE SECRECIONES	532208120047	CAMI	NEW-ASKIR 30	1	NAMBALLE
155	CAMILLA METALICA PARA EXAMEN GINECOLOGICO	536427150135	VAN	SIN MODELO	1	NAMBALLE
156	UNIDAD DENTAL ELECTRICA COMPLETA	532298200026	PREZ	PZ1026	1	NAMBALLE
157	COMPRESORA DE AIRE DE 1 HP (USO ODONTOLOGICO)	532222870003	SIN MARCA	MSV6	1	NAMBALLE
158	CAMILLA DE METAL PEDIATRICA	536425250170	SIN MARCA	SIN MODELO	1	NAMBALLE
159	CAMILLA DE METAL PEDIATRICA	536425250125	GBJHAVAL MEDICAL	SIN MODELO	1	NAMBALLE
160	EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO CON 3 TRADUCTORES	532250000014	ALPINION	ECUBE	1	NAMBALLE
161	MICROSCOPIO TRINOCULAR	532278560073	EUROMEX	BSCOPE	1	NAMBALLE
162	MONITOR FETAL INTRA PARTO PORTATIL	532281880012	BISTOS	BT350	1	NAMBALLE
163	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO CAPACIDAD 220 kg	602206520173	SECA	700	1	NAMBALLE
164	OXIMETRO	532288080002	EDAN	H100B	1	NAMBALLE
165	OXIMETRO DE PULSOS PORTATIL	532288390056	ADVANCE	S-O1	1	NAMBALLE
166	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL ADULTO/PEDIATRICO	532288390453	ADVANCE USA	PO-100B	1	NAMBALLE
167	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTATIL	532230960162	EDAN		1	NAMBALLE
168	CAMILLA DE METAL	536425250085	BERAMED		1	NAMBALLE
169	MESA (DIVAN) UNIVERSAL PARA EXAMEN DE GINECOLOGIA Y UROLOGIA	536450000018	S&S MEDICAL		1	NAMBALLE
170	LAMPARA INCANDESCENTE	532271820084			1	NAMBALLE
171	NEBULIZADOR	532255710133	SILFAB	N32	1	NAMBALLE
172	NEBULIZADOR	532255710114	SILFAB	N32	1	NAMBALLE
173	DETECTOR DE LATIDOS	532250000023	EDAN	SONOTRAX	1	NAMBALLE
174	BALANZA DE PIE	602206520227	TSCALE	M301	1	NAMBALLE
175	MICROSCOPIO TRINOCULAR	532278560075	EUROMEX	BSCOPE	1	LA COIPA
176	EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO PORTATIL	532250000015	SAMSUNG MEDISON	SONOACER3	1	LA COIPA
177	CAMILLA METALICA PARA EXAMEN GINECOLOGICO	536427150181	SIN MARCA		1	LA COIPA
178	UNIDAD DENTAL ELECTRICA COMPLETA	532298200022	WOODPECKER	OLF750	1	LA COIPA
179	ANALIZADOR BIOQUIMICO	602239530005	EMP	EMP-168	1	LA COIPA



JOSE ROYER VARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

180	ROTADOR SEROLOGICO	532293140011	DIGESYSTEN	DSR-2800D-N	1	LA COIPA
181	CONTADOR DIGITAL HEMATOLOGICO DE CELULAS	532223110007	GEMMY		1	LA COIPA
182	HEMOGLOBINOMETRO	532266650146	EKF DIAGNOSTIC	3040-19-0218	1	LA COIPA
183	CAMILLA METALICA PARA EXAMEN GINECOLOGICO	536450000015	S&S MEDICAL		1	LA COIPA
184	LAMPARA CUELLO DE GANZO	462269370001	S/M		1	BUENOS AIRES
185	NEBULIZADOR	532255710102	THOMAS		1	HUACORA
186	GLUCOMETRO	602246040173	ACCU-CHEK		1	HUACORA
187	BALANZA DE PIE	602206520241	GREETMED		1	LA CAPILLA
188	ESTERILIZADOR DE CALOR SECO 35-40L	532260470045	EFISA		1	LA CAPILLA
189	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	602206520247	GREETMED	GT131-200	1	LLANO GRANDE
190	CONGELADORA PARA VACUNAS	112260390019	VETFROST	MF314	1	LOMA LARGA
191	REFRIGERADORA PARA VACUNAS	112260390090	VETFROST	MK144	1	LOMA LARGA
192	CONGELADORA	112260390037	VESTFROST	MK114	1	SAN FRANCISCO
193	CONGELADORA	112260390071	VESTFROST	MK144	1	SAN FRANCISCO
194	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	532230960033	EDAN	SONO TRAX BASIC	1	TAMBOA
195	CONGELADORA	112260390046	VESTFROST	MF-114	1	VIRA VIRA
196	REFRIGERADORA	112260390125	VESTFROST	MKS240	1	VIRA VIRA
197	HEMOGLOBINOMETRO	532266650079	EKF DIAGNOSTIC	300-0031-6801	1	VIRA VIRA
198	CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS 98 L	112260390045	VESTFROST	MF-114	1	VISTA FLORIDA
199	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 75 L	112260390101	VESTFROST	MK204	1	VISTA FLORIDA
200	DETECTOR DE LATIDOS	532230960148	EDAN	SONOTRAX	1	VISTA FLORIDA
201	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	532266650115	EKF DIAGNOSTIC	3000-0031-6801	1	VISTA FLORIDA
202	FRIGOBAR 80L	112252140019	INDURAMA		1	VISTA FLORIDA
203	HEMOGLOBINOMETRO	532266650159	EKF DIAGNOSTIC	3000-0031-6801	1	PACAYPITE
204	BALANZA DE PIE 150 KG CON TALLIMETRO	602206520213	SECA	803	1	PACAYPITE
205	DETECTOR DE LATIDOS	532230960096	EDAN	SONOTRAX	1	TAMBORAPA PUEBLO
206	BALANZA DE PIE	602206160329	SECA	803	1	TAMBORAPA PUEBLO
207	BALANZA DE PIE	602206160429	SECA		1	TAMBORAPA PUEBLO
208	MICROSCOPIO	532278560082	OPTIKA		1	PANCHIA
209	MICROSCOPIO	532278560041	ZEISS	PRIMO STAR	1	PANCHIA
210	TERMOMETRO INFLAROJO	602292810044	CONTEC	TP500	1	PANCHIA
211	ANALIZADOR BIOQUIMICO	532202400014	EMPEROR	EMP-168	1	CHURUYACU
212	PULSOXIMETRO	532288390103	CE	M0300C23	1	CHURUYACU
213	HEMOGLOBINOMETRO	532266650173	EKF DIAGNOSTIC	3040-0010-0218	1	CHURUYACU
214	CUNA DE CALOR RADIANTE	532227630003	FANEM	MULTISYSTEM	1	CHURUYACU
215	COMPRESORA DE AIRE	532222870005	AIR DENT		1	CHURUYACU
216	ECOGRAFO	532250000012	UNITD-IMAGING	IVSTAR160	1	CHURUYACU
217	DETECTOR DE LATIDOS FETALES DOOPLER	532250000019	EDAN	SONOTRAX	1	CHURUYACU
218	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	112236140014	AESX12C6ALN	ELECTROLUX	1	CHURUYACU
219	REFRIGERADORA DOMESTICA	112263860057	INRESA		1	CHURUYACU
220	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	602206520027	SECA	354		LA BERMEJA
221	TENSIOMETRO	602287620735	RIESTER	1350	1	LA BERMEJA



INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

222	TENSIOMETRO	602287620900	RIESTER	1350	1	LA BERMEJA
223	OXIMETRO DE PULSOS PORTATIL ADULTO	532288390062	EDAN	H100B	1	GUAYABAL
224	EQUIPO NEBULIZADOR	532255710066	THOMAS	1147-230VC	1	GUAYABAL
225	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTATIL	532230960112	EDAN	SD5	1	GUAYABAL
226	BALANZA	602208560227	GUERSA	B6	1	GUAYABAL
227	BALANZA	602206520023	SECA		1	GUAYABAL
228	BALANZA	602206520275	GREEDMED		1	GUAYABAL
229	HEMOGLOBINOMETRO	532266650176	EKF		1	GUAYABAL
230	UNIDAD DENTAL ELECTRICA COMPLETA	532298200024	VOVO DENTAL	V-920	1	HUARANGO
231	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 105 L	112260390058	VESTFROST MI	MK-304	1	HUARANGO
232	EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO PORTATIL	532250000057	VINNO	A6	1	HUARANGO
233	MICROSCOPIO BINOCULAR	532278560079	OPTIKA	B-292PLI	1	HUARANGO
234	HEMOGLOBINOMETRO	532266650167	EKF DIAGNOSTIC	3040-0010-0218	1	HUARANGO
235	EQUIPO BAÑO MARIA	672243310022	KERT LAB	CDK-S24	1	HUARANGO
236	CENTRIFUGA DE 24 TUBOS	532220490040	GREEDMED	NEXTSPIN	1	HUARANGO
237	NEBULIZADOR	532255710136	ELMASLAR	CN03	1	HUARANGO
238	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL ADULTO/PEDIATRICO	532288390452	ADVANCE	PO.100B	1	HUARANGO
239	PANTOSCOPIO	532289980172	RIESTER	ENT DIAGNOSTIC SET	1	HUARANGO
240	CONGELADORA	112260390027	VESTFROST MI	MF314	1	HUARANGO
241	CAMILLA GINECOLOGICA	536427150136	BERAMED		1	HUARANGO
242	NEBULIZADOR	532255710122	SILFAB	N32D	1	HUARANGO
243	HEMOGLOBINOMETRO	532266650164	EKF	3040	1	HUARANDOZA
244	CAMILLA METALICA PARA EXAMEN GINECOLOGICO	536427150148	VENMEDIC		1	LA MUSHCA
245	REFRIGERADORA	112260390127	VESFOROST	MKS204	1	LA MUSHCA
246	HEMOGLOBINOMETRO	532266650157	EKF DIAGNOSTIC	309019	1	LA MUSHCA
247	HEMOGLOBINOMETRO	532266650206	EKF		1	LA MUSHCA
248	UPS	462200500063	ELISE	AUR VISTA650	1	LA MUSHCA
249	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	602206520215	SECA		1	LA MUSHCA
250	ESTABILIZADOR PARA CADENA DE FRIO	462252150420	EVERGIT		1	LA MUSHCA
251	NEBULIZADOR	532255710079	THOMAS	1127	1	LA MUSHCA
252	ANALIZADOR BIOQUIMICO	532202400015	EMPEROR	MP-168	1	EL TRIUNFO
253	HEMOGLOBINOMETRO	532266650175	EKF		1	EL TRIUNFO
254	ESTERILIZADOR DE CALOR SECO DE 60 L	532260470079	MEMMERT	SN55	1	SAN JOSE DE LOURDES
255	NEBULIZADOR	532255710118	SILFAB	N32	1	NAMBALLE
256	COMPRESORA DE AIRE DE 1HP	532222870006	AIRIDENT, CHINA	BD-901	1	BAJO IHUAMACA



JOSE ROYER VARGAS SANCHEZ
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO

- 1) El proveedor ejecutará el servicio de diagnóstico y mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos descritos anteriormente, pertenecientes a las IPRESS de la jurisdicción de la Red San Ignacio, se realizará dentro de los ambientes de los establecimientos de salud tal como se indica en el cuadro relación de equipos (IPRESS donde se realizará el mantenimiento).
- 2) El proveedor, deberá realizar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de acuerdo a las actividades requeridas por esta entidad y otras que indique el usuario final quien maneja el equipo al momento de su reparación.
- 3) El proveedor demostrará que los mantenimientos efectuados están correctamente ejecutados, para ello utilizará los equipos mínimos requeridos, por ello previo al inicio del servicio deberá acreditar que el equipamiento mínimo solicitado debe de contar con certificación de calibración vigente.
- 4) El proveedor es el único responsable ante la Red de salud san Ignacio de cumplir con la prestación del servicio contratado, no pudiendo transferir estas responsabilidades a otras entidades o terceros en general.
- 5) El proveedor ejecutará el servicio utilizando sus propios recursos financieros, técnicos, equipamiento, instrumentación, insumos de acuerdo a la naturaleza de cada equipo.
- 6) El Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo, comprende al Equipo y todos sus componentes, según lo solicitado.
- 7) El servicio contratado incluye el suministro e instalación de todos los repuestos y accesorios necesarios para la correcta operatividad de los equipos en la cobertura del contratista por lo que los participantes contarán con todas las facilidades para verificar y evaluar los equipos, bajo supervisión del jefe de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento o quien haga sus veces, antes de ofertar su propuesta técnica.
- 8) El contratista:
 - a. Deberá cumplir con las actividades de mantenimiento descritos en los términos de referencia.
 - b. Brindará el servicio técnico, solicitado por el EE.SS cuando lo estime necesario, como consecuencia de un mal funcionamiento o inoperatividad, del Equipo y/o alguno de sus componentes indicados en el TDR, durante el periodo de garantía.
 - c. Deberá considerar las actividades recomendadas y establecidas en los manuales del fabricante con el fin de complementar las actividades establecidas en los términos de referencia, para beneficio y conservación del equipo y sus componentes.
 - d. Deberá entregar al Servicio Usuario y al jefe de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento o quien haga sus veces, un informe técnico para dejar constancia de las



JOSE ROYER YARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

actividades realizadas y una OTM (Orden de Trabajo de Mantenimiento), de los trabajos realizados y repuestos cambiados, en las fechas realizadas.

- e. Los repuestos, partes y/o software, el contratista procederá a revisarlos, instalarlos, y realizar las pruebas operativas que sean necesarias, hasta asegurar el correcto funcionamiento del equipo antes indicado.

5.1. ACTIVIDADES GENERALES

El Servicio contratado para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Equipo y todos sus componentes, indicados en el TDR, debe asegurar el correcto funcionamiento del mismo; por lo que también se ejecutarán actividades básicas tales como:

- 1) Inspección de integridad, identificando daños y partes faltantes.
- 2) Inspecciones y revisiones globales y específicas del equipo principal y todos sus componentes.
- 3) Ajustes eléctricos, electrónicos y/o mecánicos de acuerdo a lo indicado en los manuales del fabricante y/o términos de referencia.
- 4) Limpieza interna y externa, lubricación, engrase de partes mecánicas.
- 5) Verificación y Regulación de Parámetros de Funcionamiento y Operatividad, cumpliendo con lo indicado por el fabricante y/o normativa vigente.
- 6) Pruebas de funcionamiento.
- 7) Pruebas del sistema de puesta a tierra (en caso sea necesario)
- 8) Pruebas del sistema de aire acondicionado / climatización (de corresponder).
- 9) Otras que demande el mantenimiento.

5.2. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A EJECUTAR

El contratista deberá realizar las siguientes actividades y las que recomienda el fabricante o usuarios quienes manejan los equipos tal como se detalla a continuación:

ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-4 SAN IGNACIO

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA	BIOMEDICO	532210730001	JISICO	J-BSCV2	1310-3
ACTIVIDADES <ol style="list-style-type: none"> 1) DESCONTAMINACIÓN DE LA CABINA CON FORMALDEHIDO SEGÚN LA NORMA NSF-49. 2) COMPROBAR CON UN DETECTOR DE FORMALDEHIDO, QUE NO HAY FUGAS EN LA DESCONTAMINACIÓN Y EN LA VERIFICACIÓN DE LA NEUTRALIZACIÓN DEL FORMALDEHIDO EN LA CABINA DE BIOSEGURIDAD. 3) INSPECCIÓN DE INTEGRIDAD, IDENTIFICANDO DAÑOS Y PARTES FALTANTES. 4) MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 					



JOSE ROYPER VARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA	BIOMEDICO	532210730001	JISICO	J-BSCV2	1310-3
<p>5) MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS PARTES MECÁNICAS DE LA CABINA Y DE LAS PARTES ELÉCTRICAS.</p> <p>6) MANTENIMIENTO DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS.</p> <p>7) BORRADO DE ALARMAS Y REINICIO DEL PORCENTAJE DE SATURACIÓN EN LA PANTALLA DE LAS CABINAS DE BIOSEGURIDAD.</p> <p>8) CAMBIO DE DIEZ (10) LÁMPARAS UV, Y VERIFICACIÓN DE LA INTENSIDAD DE LA LÁMPARA UV.</p> <p>9) CAMBIO DE DIEZ (10) LÁMPARAS FLUORESCENTES</p> <p>10) VERIFICACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y/O CAMBIO DEL MISMO, VERIFICACIÓN DEL AISLAMIENTO ELÉCTRICO.</p> <p>11) VERIFICACIÓN DE LAS LUNAS DE VIDRIO TIPO GUILLOTINA Y/O CAMBIO DEL MISMO</p> <p>12) VERIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE SER NECESARIO EL SISTEMA DE DETECCIÓN DE APERTURA Y CERRADO DE PUERTA DE VIDRIO TIPO GUILLOTINA.</p> <p>13) CAMBIO DE LOS FILTROS HEPA POR (02) UNIDADES</p> <p>14) AJUSTES ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y/O MECÁNICOS CONFORME INDIQUE EL MANUAL DE SERVICIO.</p> <p>15) PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.</p> <p>16) VERIFICACIÓN Y REGULACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO CONFORME INDIQUEN LOS MANUALES DE USUARIO.</p> <p>17) TRASLADO DE LOS FILTROS HEPA MEDIANTE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y/O NORMAS VIGENTES Y ELIMINACIÓN DE LOS FILTROS SATURADOS</p> <p>18) PRUEBA DE INTEGRIDAD DE LOS FILTROS HEPA CON FOTÓMETRO Y GENERADOR DE AEROSOL CON PARTÍCULAS PAO (FOTÓMETRO Y GENERADOR DE AEROSOL).</p> <p>19) PRUEBA DE CONTEO DE PARTÍCULAS (CONTADOR DE PARTÍCULAS).</p> <p>20) PRUEBA DE VOLÚMENES DE INGRESO Y DE RECAMBIO (BALÓMETRO)</p> <p>21) OTRAS QUE DEMANDE EL MANTENIMIENTO, A FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y LA CERTIFICACIÓN ANUAL DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS VIGENTE DEL EQUIPO NSF- 49 Y ENI 12469.</p>					



DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE
CENTRIFUGA CLINICA PARA 12 TUBOS	BIOMEDICO	532220490037	NEXTSPIN	NEXTSPIN-112	TP209040010
CENTRIFUGA CLINICA PARA 12 TUBOS	BIOMEDICO	532220490034	NEXTSPIN	NEXTSPIN-112	TP812212003
<p>ACTIVIDADES:</p> <p>1) DESMONTAJE DEL EQUIPO</p> <p>2) LIMPIEZA DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y TARJETA ELECTRÓNICA</p> <p>3) REVISIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, CONECTORES Y CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO</p> <p>4) VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DEL MECANISMO DE ACOPLA Y AJUSTE DEL ROTOR</p>					

JOSE ROYER VARGAS SAMARIE
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

- 5) REVISIÓN DE APERTURA Y BLOQUEO DE TAPA (LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE BISAGRA)
- 6) LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES (RODAMIENTOS Y SISTEMAS MECÁNICOS)
- 7) REVISIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL ROTOR DE LA CENTRIFUGA Y MOTOR
- 8) VERIFICACIÓN DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO.
- 9) REVISIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, CAMBIAR SI PRESENTA SIGNOS DE QUEMADURA.
- 10) LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO
- 11) REVISIÓN DE PARTES ELÉCTRICAS
- 12) REVISIÓN DE PROGRAMACIÓN
- 13) COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ALARMA DE TERMINO DE PROCESO
- 14) VERIFICACIÓN DEL EMPAQUE DE LA PUERTA
- 15) COMPROBAR LUBRICACIÓN
- 16) REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL, SELECTORES DE VELOCIDAD, TIEMPO DE CENTRIFUGADO, ALARMAS Y LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN DE LA CENTRIFUGA
- 17) CAMBIO DE FUSIBLES
- 18) REVISIÓN DE PARTES MECÁNICAS
- 19) LIMPIEZA DE LOS COMPONENTES INTERNOS
- 20) COMPROBACIÓN DE MECANISMO DE ACOPLE Y AJUSTE DE ROTORES
- 21) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y TOTAL OPERATIVIDAD DEL EQUIPO CON VERIFICACIÓN DEL USUARIO.
- 22) ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL USUARIO.

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE
CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL	BIOMEDICO	112220300018	VESTFROST A/S	MF314	20082559005

ACTIVIDADES:

- 1) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO
- 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO, REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO.
- 3) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES.
- 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS.
- 5) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE
- 6) PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES.
- 7) LIJADO Y PINTADO DE INFRAESTRUCTURA.
- 8) SUMINISTRO Y CAMBIO DE COMPRESOR Y CAPILAR
- 9) SUMINISTRO Y LLENADO DE GAS REFRIGERANTE 404A PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
- 10) VERIFICAR EL CONTROLADOR DE TEMPERATURA
- 11) VERIFICAR EL SENSOR DE TEMPERATURA
- 12) VERIFICAR EL LAMPARA LED PARA EL INTERIOR DE LA CÁMARA
- 13) VERIFICAR EL ESTABILIZADOR DE ESTADO SOLIDO DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO
- 14) VERIFICAR EL TERMOHIGRÓMETRO CALIBRADO
- 15) VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE GAS
- 16) VERIFICACIÓN DE FUGA DE GAS
- 17) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA Y CONTROL
- 18) OTRAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO



JOSE ROYTER VARGAS SAMARIE
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE
DESFIBRILADOR	BIOMEDICO	532230010003	CU MEDICAL SYSTEMS	LIFEGAIN-CU-HUI	M4R39E018
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) INSPECCION GENERAL 2) LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO 3) REVISIÓN Y PRUEBAS DEL SISTEMA 4) LIMPIEZA EXTERNA, CONECTORES, CABLES, ACCESORIOS. 5) MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS INTERNOS, TALES COMO TARJETAS ELECTRÓNICAS, FLATS, CABLES, CONECTORES, FILTROS, PORTAFUSIBLES Y CABLE DE PODER. 6) LIMPIEZA DE LA TARJETA DE FUENTE DE ALIMENTACION 7) LIMPIEZA DE LA TARJETA PRINCIPAL 8) MANTENIMIENTO DE LA MEMBRANA DE TECLADO 9) LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PALETAS DE DESFIBRILACIÓN EXTERNA ADULTO 10) LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PALETAS DE DESFIBRILACIÓN PEDIATRICAS 11) INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO: TARJETAS Y CABLES INTERNOS 12) INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INDICADORES DE FUNCIONABILIDAD: AUDIO, VISUALES DE OPERATIVIDAD. 13) SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE BATERÍA 14) VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE DESEMPEÑO Y CALIBRACIÓN. 15) COMPROBACIÓN DE LA SALIDA DE ENERGÍA CON ANALIZADOR PARA DESFIBRILADOR. 16) PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA: CORRIENTES DE FUGA, RESISTENCIA TIERRA CON ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA. 17) PRUEBA DE OPERATIVIDAD Y ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO EN TODOS SUS PARÁMETROS DE TRABAJOS ESTABLECIDOS POR FÁBRICA. 18) PRUEBAS FINALES DE OPERACIÓN QUEDANDO EL EQUIPO OPERATIVO LISTO PARA 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE
EQUIPO DE FOTOTERAPIA	BIOMEDICO	532245240001	FANEM	BILITRON 3006 BTP	DAI 09943
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) DESMONTAJE DEL EQUIPO, REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 2) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, 3) CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES. 5) VERIFICACIÓN DE LUMINOSIDAD 6) SUMINISTRO E INSTALACIÓN LEDS DEFECTUOSOS 7) OTRAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO. 					



JOSE ROYER VARGAS SAMANE
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 228147

*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE
ESTERILIZADOR DE CALOR SECO	BIOMEDICO	532260470137	MEMMERT ALEMANIA	SL55	B221.0349
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) DESMONTAJE DEL EQUIPO, REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO 2) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 3) LIMPIEZA DE LA CÁMARA INTERNA 4) SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE PUERTA 5) REVISION EXTERNA DE EQUIPO Y VERIFICACION DE PARTES Y COMPONENTES. 6) AJUSTES ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y/O MECÁNICOS. 7) REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS. 8) LIMPIEZA TÉCNICA, LUBRICACIÓN, ENGRASE Y MANTENIMIENTO DE LA PUERTA. 9) CAMBIO DE EMPAQUETADURA ORIGINAL 10) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON TIRAS INDICADORA DE ESTERILIZACIÓN. 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
INCUBADORA CON CUPULA ESTANDAR	BIOMEDICO	532269040001	FANEM	1186	CJ4755

ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) DESMONTAJE DEL EQUIPO 2) VERIFICAR EL MÓDULO CALEFACTOR. 3) VERIFICAR A LA BASE RODANTE 4) VERIFICAR A LA BASE DE LA CUNA 5) VERIFICAR TARJETA DE CONTROL DEL DISPLAY 6) SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA TIPO PIEL 7) SUMINISTRO DE FILTROS DE INGRESO DE AIRE 8) LIMPIEZA DE MANGAS DE INGRESO 9) PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA Y FUNCIONAMIENTO. 10) REVISAR Y VERIFICAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL CHASIS DEL EQUIPO LA BASE RODABLE Y LAS 04 GARRUCHAS. REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD. 11) LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES INTERNA Y EXTERNAS DEL CHASIS, BASE RODABLE Y LAS (04) GARRUCHAS DEL EQUIPO, LIMPIEZA Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE CALOR RADIANTE: CALEFACTOR, RESISTENCIAS ELÉCTRICAS Y SISTEMA ELÉCTRICO Y CONECTORES. 12) LIMPIEZA Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO DE PARÁMETROS: PANEL DE CONTROL: TARJETA ELECTRÓNICA DEL PANEL DE CONTROL, CONECTORES Y CABLEADO. 13) SISTEMA DE SEGURIDAD ELÉCTRICO FUSIBLES, CABLE PODER, ENCHUFE Y PUESTA A TIERRA. 14) LIMPIEZA Y REVISIÓN DE ACCESORIOS Y FILTROS DE AIRE. 					
--	--	--	--	--	--



JOSE ROYER VARGAS SANCHEZ
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
LAMPARA CIALITICA RODABLE	BIOMEDICO	532270940005	HEFEI HEALTH	DL-620B	10122029-006759
LAMPARA CIALITICA RODABLE	BIOMEDICO	532270940006	HEFEI HEALTH	DL-620B	10122030-006761

ACTIVIDADES:

- 1) VERIFICACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO.
- 2) INSPECCIÓN VISUAL REVISIÓN DEL ESTADO ESTRUCTURAL DEL CHASIS, LÁMPARAS, MICAS, FILTROS, BRAZOS MECÁNICOS, SISTEMA DE FIJACIÓN DE ANCLAJE AL TECHO, SISTEMA DE RUEDAS.
- 3) LIMPIEZA GENERAL, INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO.
- 4) INSPECCIÓN DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, CABLES Y CONECTORES.
- 5) VERIFICACIÓN DE ESTADO Y LIMPIEZA DE LAS PARTES Y COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, TALES COMO TARJETAS ELECTRÓNICAS, CABLES, CONECTORES, FUSIBLES, PORTAFUSIBLES, CABLE DE PODER, ENTRE OTROS. REVISIÓN, ALINEAMIENTO Y AJUSTE DEL TUBO DE BRIDAS
- 6) REVISIÓN, AJUSTE Y MANTENIMIENTO DE ARTICULACIONES, SISTEMA DE POSICIONAMIENTO, TORNILLO DE AJUSTE DE FRENO. REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO Y APAGADO.
- 7) SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE PIEZAS, PARTES, COMPONENTES Y CONSUMIBLES DE OPERACIÓN ORIGINALES DIRECTAMENTE DE FÁBRICA, INDICADO EN LOS MANUALES DEL SERVICIO TÉCNICO DEL FABRICANTE, SEGÚN LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA, LOS MISMOS QUE, DE SER EL CASO, DEBERÁN SER DETALLADOS EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
- 8) REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, ELIMINACIÓN DE FALSOS CONTACTOS.
- 9) LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE VOLTAJE EN FUENTES DE PODER.
- 10) OTRAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO QUE INDIQUE EL FABRICANTE, LAS MISMAS QUE, DE SER EL CASO, DEBERÁN SER DETALLADOS EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
- 11) PRUEBA DE NIVEL DE INTENSIDAD DE LA ILUMINACIÓN.
- 12) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y TOTAL OPERATIVIDAD DEL EQUIPO CON VERIFICACIÓN DEL PERSONAL.



DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
MICROSCOPIO BINOCULAR	BIOMEDICO	532278560078	OPTIKA	B-292PLI	548797

ACTIVIDADES:

- 1) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO
- 2) MANTENIMIENTO AL MICROSCOPIO EN GENERAL (EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA)
- 3) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE OCULARES CON PAPEL LENTE
- 4) INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE OBJETIVOS CON EL USO DE PAPEL LENTE
- 5) REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL CONDENSADOR
- 6) LIMPIEZA DE PLATINA
- 7) REVISIÓN Y PRUEBA DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN

JOSE ROGER VARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

- 8) MANTENIMIENTO, REPONER O INSTALAR EFECTUAR INSPECCIÓN EXTERNA DEL EQUIPO (TORNILLOS MACROMÉTRICOS, MICROMÉTRICOS)
- 9) MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ÓPTICO, LIMPIEZA DE ACCESORIOS Y VERIFICACIÓN DE CONTACTOS.
- 10) MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DE CONTROL Y REAJUSTE DE COMPONENTES
- 11) REEMPLAZO DE LÁMPARA HALÓGENA
- 12) ARMADO DE LA UNIDAD, CALIBRACIÓN.
- 13) PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA Y FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA AL SERVICIO.

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCULAR CON OPTICA AL INFINITO	BIOMEDICO	532278560042	ZEISS	PRIMOSTAR	3144004269
MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCULAR CON OPTICA AL INFINITO	BIOMEDICO	532278560062	ZEISS	PRIMOSTAR	3144033047

ACTIVIDADES:

- 1) REQUIERE OBJETIVOS Y MP
- 2) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE OCULARES CON PAPEL LENTE
- 3) REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL CONDENSADOR
- 4) REVISIÓN Y PRUEBA DE AJUSTE MACROMÉTRICO Y MICROMÉTRICO
- 5) REVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- 6) MANTENIMIENTO AL MICROSCOPIO EN GENERAL (EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA)
- 7) MANTENIMIENTO, REPONER O INSTALAR EFECTUAR INSPECCIÓN EXTERNA DEL EQUIPO (TORNILLOS MACROMÉTRICOS, MICROMÉTRICOS)
- 8) MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ÓPTICO, LIMPIEZA DE ACCESORIOS Y VERIFICACIÓN DE CONTACTOS
- 9) MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DE CONTROL Y REAJUSTE DE COMPONENTES
- 10) REEMPLAZO DE LÁMPARA HALÓGENA
- 11) ARMADO DE LA UNIDAD, CALIBRACIÓN.
- 12) PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA Y FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA AL SERVICIO.



DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
ROTADOR SEROLOGICO	BIOMEDICO	532293140003	DIGISYSTEM	DSR-2800D	14010021

ACTIVIDADES:

- 1) DESMONTAJE DE EQUIPO LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y REVISIÓN DE PARTES Y ACCESORIOS.
- 2) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES.
- 3) AJUSTE Y VERIFICACIÓN DE EJE DE MOTOR
- 4) LIMPIEZA DE CÁMARA DE ROTOR
- 5) CALIBRACIÓN DE RPM CON TACÓMETRO.

JOSE ROYCE VARGAS SARAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

- 6) VERIFICACIÓN DE TIEMPO DE PROGRAMACIÓN
- 7) REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS.
- 8) REVISIÓN Y LIMPIEZA DE PLATAFORMA
- 9) LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE PERILLA DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
COCHE DE PARO	BIOMEDICO	536430710001	HERBEI PUKANG	F-45-3	11648

ACTIVIDADES:

- 1) INSPECCIÓN MECÁNICA DEL COCHE MECÁNICO
- 2) LIMPIEZA, LUBRICAR LAS PARTES MECÁNICAS
- 3) REVISIÓN DE CONTROL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
- 4) REVISIÓN DEL ESTADO DE LAS RUEDAS
- 5) PINTADO EN LAS ÁREAS QUE LO REQUIERAN
- 6) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD Y ENTREGA.

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
MONITOR FETAL INTRA PARTO PORTATIL	BIOMEDICO	532281880011	BISTOS	BT350	

ACTIVIDADES:

- 1) REQUIERE PROGRAMACION
- 2) INSPECCIÓN O REVISIÓN GLOBAL Y ESPECIFICAS DEL EQUIPO.
- 3) AJUSTES ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y/O MECÁNICOS.
- 4) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE LOS TRANSDUCTORES
- 5) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD AL SISTEMA DE IMPRESIÓN,
- 6) LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, ENGRASE.
- 7) PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.
- 8) VERIFICACIÓN, Y REGULACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO.



DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
CUNA DE CALOR RADIANTE	BIOMEDICO	532227630004	FANEM	MULTISYSTEM 2051	

ACTIVIDADES:

- 1) VERIFICACIÓN DEL EQUIPO.
- 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO Y LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES INTERNAS, EXTERNA Y CÚPULA.
- 3) LIMPIEZA DE LOS COMPONENTES INTERNOS.
- 4) LIMPIEZA Y REVISIÓN DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS (LIMPIA CONTACTOS DE RESIDUO CERO).
- 5) LUBRICACIÓN DEL VENTILADOR DEL MÓDULO DE CALEFACCIÓN.
- 6) LIMPIEZA DE RUEDAS Y FRENOS DE LA BASE.
- 7) VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS PARTES MECÁNICAS
- 8) REEMPLAZO DE 01 SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL.

JOSE ROYER YARGAS SARAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

- 9) MONTAJE DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERACIÓN, Y FUNCIONAMIENTO DENTRO DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS.

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
MONITOR FETAL INTRA PARTO PORTATIL	BIOMEDICO	532281880014	EDAN	F9	AFGA0054

ACTIVIDADES:

- 1) INSPECCIÓN O REVISIÓN GLOBAL Y ESPECIFICAS DEL EQUIPO.
- 2) AJUSTES ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y/O MECÁNICOS.
- 3) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE LOS TRANSDUCTORES
- 4) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD AL SISTEMA DE IMPRESIÓN,
- 5) LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, ENGRASE.
- 6) PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.
- 7) VERIFICACIÓN, Y REGULACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO.

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
COCHE DE PARO EQUIPADO	BIOMEDICO	536430710003	LELYS-PERU	S/M	S/S

ACTIVIDADES:

- 1) INSPECCIÓN MECÁNICA DEL COCHE MECÁNICO
- 2) LIMPIEZA, LUBRICAR LAS PARTES MECÁNICAS
- 3) REVISIÓN DE CONTROL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
- 4) REVISIÓN DEL ESTADO DE LAS RUEDAS
- 5) PINTADO EN LAS ÁREAS QUE LO REQUIERAN
- 6) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD Y ENTREGA.

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	BIOMEDICO	602206520232	GREETMED	GT131-200 HEALTHSAL	1201904150040

ACTIVIDADES:

- 1) REQUIERE, REPARACION DEL TALLIMETRO (SE ENCUENTRA ROTO)
- 2) VERIFICACIÓN DE PESOS CON PESAS PATRONES: 1KG, 2 KG, 5 KG.
- 3) AJUSTE DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS SEGÚN MANUAL DE FABRICANTE.
- 4) REPARACIÓN Y AJUSTE DEL MECANISMO DE CONTRAPESO
- 5) ALINEAMIENTO DEL BRAZO VASCULANTE PINTADO DE LA ESTRUCTURA METALICA
- 6) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA BASE INTERIOR



JOSE ROYER VARGAS SAMANE
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 105 L	ELECTROMECHANICO	112260390062	VESTFROST A/S	MK304	20134913176
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO. 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO, REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 3) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES. 5) LIJADO Y PINTADO DE PARTES OXIDADAS. 6) SUMINISTRO Y LLENADO DE GAS REFRIGERANTE 404A O SEGÚN FABRICANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 7) VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y FUGA DE GAS REFRIGERANTE. 8) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA 					

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
CUNA DE CALOR RADIANTE	BIOMEDICO	532227630002	PALLMANNMED/CHINA	BN-100	1120702025
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1 DESMONTAJE DE LA UNIDAD PRINCIPAL. 2.- REQUIERE SENSOR DE TEMPERATURA 3.- REQUIERE TRANSISTOR DE POTENCIA 4.- LIMPIEZA DE LOS COMPONENTES INTERNOS. 5.- LIMPIEZA Y REVISIÓN DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS (LIMPIA CONTACTOS DE RESIDUO CERO) 6.- LUBRICACIÓN DEL VENTILADOR DEL MÓDULO DE CALEFACCIÓN. 7.- INSPECCIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO. 8.- MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL (RESOLDANDO LOS PUNTOS). 9.- VERIFICACION DE RESISTENCIA CALEFACTORA, VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA. 10.- SUMINISTRO DE 01 SENSOR DE PIEL. 6.- SUMINISTRO DE CABLE DE PODER 7.- SUMINISTRO Y CAMBIO DE TARJETAL DE CONTROL DE TEMPERATURA. 8.- SUMINITRO Y CAMBIO DE FILTROS DE INGRESO DE AIRE 9.- SUMINISTRO Y CAMBIO DE COLCHONETA DE PACIENTE 10.-SUMINIUSTRO Y CAMBIO DE MAGAS DE INGRESO A LA CABINA 11.- LIMPIEZA DE RUEDAS Y FRENOS DE LA BASE 12.-SUMINISTRO DE BALON DE OXIGENO TIPO PORTATIL 13.- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. 					



JOSE RIVERA VILLALBA SARAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
OXIMETRO DE PULSOS	BIOMEDICO	532288390048	EDAN	H100B	360101-M18C11260037
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE BATERIAS RECARGABLES Y MP 2) AJUSTES ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y/O MECÁNICOS. 3) VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA Y SISTEMA INDICADOR DE SPO2 Y FC 4) LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, ENGRASE 5) DESMONTAJE DE EQUIPO LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y REVISIÓN DE PARTES Y ACCESORIOS. 6) REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS 7) PRUEBA CON SIMULADOR DE OXIMETRO CON CERTIFICACION VIGENTE 8) SUMINISTRO DE 02 SENSORES DE SPO2 CON CABLE DE EXTENSIÓN. 9) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
ASPIRADORA DE SECRECIONES PORTATIL	BIOMEDICO	532208120037	THOMAS	1633GL	111200004197
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1.- DESMONTAJE DEL EQUIPO DE ASPIRADOR DE SECRECIONES. 2.- REQUIERE REPARACION DE CIRCUITO NEUMATICO 3.- REQUIERE CAMBIO DE REGULADOR DE PRESION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4.- MANTENIMIENTO DE MOTOR (ENGRASADO DE RODAMIENTO Y BARNIZADO DEL ESTATOR) 5.- SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO, VERIFICACIÓN DE MANOMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO 6.- LIMPIEZA DEL SISTEMA DE DIAFRAGMA Y VÁLVULA DEL COMPRESOR 7.- SUMINISTRO Y CAMBIO AL CABEZAL, DIAFRÁGMA, CÁMARA, PISTÓN, VALVULAS. 8.- SUMINISTRO Y CAMBIO DE PERILLA REGULADORA Y AJUSTE AL SISTEMA ELÉCTRICO Y MOTOR 9.- SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERAS DE CONEXIÓN AL EQUIPOS AL PACIENT. 10.- SUMINISTRO DE 10 FILTROS HIDROFOBICOS 11.-ARMADO DEL EQUIPO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA Y FUNCIONAMIENTO 					



DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
OXIMETRO DE PULSOS	BIOMEDICO	532288390044	EDAN	M3	302104-M16C1300009-01
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) SE VA A USAR MEDIDOR DE PARÁMETRO DE SATURACIÓN DE OXÍGENO 2) DESMONTAJE DE EQUIPO 3) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA 4) REVISIÓN DE PARTES Y ACCESORIOS. 5) REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS 6) PRUEBA CON SIMULADOR DE OXIMETRO CON CERTIFICACION VIGENTE 					

JOSE ROYTER VARGAS SAMAME
 INGENIERO ELECTRONICO
 REG. CIP. 223147

- 7) SUMINISTRO DE SENSORES DE SPO2 CON CABLE DE EXTENSIÓN, 01 ADULTO, 01 PEDIATRICO, 01 NEONATAL
- 8) LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, ENGRASE
- 9) AJUSTES ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y/O MECÁNICOS.
- 10) SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE BATERIAS DEL EQUIPO
- 11) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
INCUBADORA PARA BEBES - INCUBADORA PARA NEONATOS 150 V	BIOMEDICO	532269990004	GIGANTE	MILLENIUM	11800MILL

ACTIVIDADES:

- 1) REQUIERE SENSOR DE TEMPERATURA
- 2) REVISAR Y VERIFICAR EL SISTEMA DE CONTROL DE PARÁMETROS: TEMPERATURA AL INTERIOR DE LA INCUBADORA, TEMPERATURA DE LA PIEL DEL NEONATO, HUMEDAD RELATIVA. REVISAR Y VERIFICAR LOS SENSORES DE TEMPERATURA Y OTROS ACCESORIOS DEL SISTEMA DE MONITOREO.
- 3) REVISAR Y VERIFICAR EL SISTEMA ELÉCTRICO DE SEGURIDAD FUSIBLE, CABLE PODER, ENCHUFE Y PUESTA A TIERRA.
- 4) REVISAR Y VERIFICAR EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN RADIANTE: CALEFACTOR, RESISTENCIA Y OTROS ACCESORIOS.
- 5) REVISAR Y VERIFICAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL CHASIS DEL EQUIPO LA BASE RODABLE Y LAS 04 GARRUCHAS. REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD.
- 6) LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES INTERNA Y EXTERNAS DEL CHASIS, BASE RODABLE Y LAS (04) GARRUCHAS DEL EQUIPO
- 7) LIMPIEZA Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE CALOR RADIANTE: CALEFACTOR, RESISTENCIAS ELÉCTRICAS Y SISTEMA ELÉCTRICO Y CONECTORES.
- 8) LIMPIEZA Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO DE PARÁMETROS: PANEL DE CONTROL: TARJETA ELECTRÓNICA DEL PANEL DE CONTROL, CONECTORES Y CABLEADO ASÍ MISMO LOS SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA.
- 9) LIMPIEZA Y REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA, TARJETA ELECTRÓNICA DE POTENCIA CABLEADO INTERNO Y CONECTORES. SISTEMA DE SEGURIDAD ELÉCTRICO FUSIBLES, CABLE PODER, ENCHUFE Y PUESTA A TIERRA.
- 10) LIMPIEZA Y REVISIÓN DE ACCESORIOS Y FILTROS DE AIRE.



DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
ESTERILIZADOR DE CALOR SECO	BIOMEDICO	532260470110	OVENS	EG	E-001

ACTIVIDADES:

- 1) REQUIERE TERMOSTATO
- 2) REQUIERE FUSIBLE TERMICO
- 3) DESMONTAJE DEL EQUIPO

JOSE ROYER VARGAS SANCHEZ
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

- 4) REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO.
- 5) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS.
- 6) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES.
- 7) LIMPIEZA DE LA CÁMARA INTERNA.
- 8) SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE PUERTA
- 9) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA CON TERMÓMETRO EXTERNO.
- 10) PRUEBA CON TIRAS INDICADORA DE ESTERILIZACIÓN.

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
CUNA DE CALOR RADIANTE	BIOMEDICO	532227630002	FANEM		

ACTIVIDADES:

- 1) REQUIERE SENSOR DE TEMPERATURA
- 2) REQUIERE TRANSISTOR DE POTENCIA
- 3) VERIFICACIÓN DEL EQUIPO.
- 4) DESMONTAJE DEL EQUIPO Y LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES INTERNAS, EXTERNA Y CÚPULA.
- 5) LIMPIEZA DE LOS COMPONENTES INTERNOS.
- 6) LIMPIEZA Y REVISIÓN DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS (LIMPIA CONTACTOS DE RESIDUO CERO).
- 7) LUBRICACIÓN DEL VENTILADOR DEL MÓDULO DE CALEFACCIÓN.
- 8) LIMPIEZA DE RUEDAS Y FRENOS DE LA BASE.
- 9) VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS PARTES MECÁNICAS
- 10) REEMPLAZO DE 01 SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL.
- 11) MONTAJE DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERACIÓN, Y FUNCIONAMIENTO DENTRO DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS.



DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO	BIOMEDICO	532250000013	UNITED IMAGING	IUSTAR160	IUSTAR160

ACTIVIDADES:

- 1) INSPECCIÓN MECÁNICA EXTERNA DEL EQUIPO,
- 2) MANTENIMIENTO AL PANEL DE CONTROL
- 3) MANTENIMIENTO A TARJETAS ELECTRÓNICAS DE PROCESAMIENTO, CONTROL, ALIMENTACIÓN.
- 4) EVALUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRANSDUCTOR E IMPRESORA.
- 5) LIMPIEZA DEL EQUIPO.
- 6) PRUEBA DEL EQUIPO.

JOSE ROBERTO VARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
MONITOR FETAL INTRA PARTO PORTATIL	BIOMEDICO	532281880011	BISTOS	BT350	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE PROGRAMACION 2) INSPECCIÓN O REVISIÓN GLOBAL Y ESPECIFICAS DEL EQUIPO. 3) AJUSTES ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y/O MECÁNICOS. 4) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE LOS TRANSDUCTORES 5) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD AL SISTEMA DE IMPRESIÓN. 6) LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, ENGRASE. 7) PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 8) VERIFICACIÓN, Y REGULACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO. 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
ANALIZADOR BIOQUIMICO	BIOMEDICO	532202400007	EMPSUM	EMP-168	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) EXAMINAR EL EXTERIOR DEL EQUIPO Y EVALUAR SU CONDICIÓN FÍSICA GENERAL. 2) VERIFICAR LA LIMPIEZA DE LAS CUBIERTAS Y EL AJUSTE DE LAS MISMAS. 3) PROBAR EL CABLE DE CONEXIÓN Y SU SISTEMA DE ACOPLES. 4) COMPROBAR QUE SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES Y QUE ESTÁN LIMPIOS. 5) EXAMINAR LOS CONTROLES DEL EQUIPO. 6) VERIFICAR QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y QUE SE PUEDEN ACCIONAR SIN DIFICULTAD. 7) VERIFICAR EL ESTADO DE BRAZO PORTA ELECTRODO. 8) REVISAR LAS BATERÍAS SI APLICA; CAMBIAR SI ES NECESARIO. 9) EFECTUAR UNA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO MIDIENDO UNA SOLUCIÓN CONOCIDA. 					



DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
CAMILLA METALICA PARA EXAMEN GINECOLOGICO	MOBILIARIO	536427150096	INSEGES	SIN MODELO	SIN SERIE
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE PINTURA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2) INSPECCIONAR CONDICIONES FÍSICAS DEL MOBILIARIO 3) REVISIÓN DE CONTROL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO 4) VERIFICAR EL ESTADO DE LA COLCHONERA 5) REVISAR SISTEMA MECÁNICO 6) REVISIÓN DEL ESTADO DE LAS RUEDAS 					

JOSE ROYER VARGAS SARAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO CAPACIDAD 220 kg	BIOMEDICO	602206520230	T-SCALE	M301	0328012024
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE BATERIA Y REQUIERE CARGADOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO VERIFICACIÓN DE PESOS CON PESAS PATRONES: 1KG, 2 KG, 5 KG. 2) AJUSTE DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS SEGÚN MANUAL DE FABRICANTE. 3) REPARACIÓN Y AJUSTE DEL MECANISMO DE CONTRAPESO 4) ALINEAMIENTO DEL BRAZO VASCULANTE PINTADO DE LA ESTRUCTURA METALICA 5) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA BASE INTERIOR 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
MESA (DIVAN) UNIVERSAL PARA EXAMEN DE GINECOLOGIA Y UROLOGIA	BIOMEDICO	536450000020	S&S MEDICAL	S/M	S/S
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE REPARACION DE PULSADORES DE MOVIMIENTO 2) REQUIERE PINTURA 3) INSPECCIÓN MECÁNICA DE LA MESA - CAMILLA. 4) LIMPIEZA, LUBRICAR LAS PARTES MECÁNICAS 5) REVISIÓN DE CONTROL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO 6) VERIFICAR EL ESTADO DE LA COLCHONERA 7) REVISIÓN DEL ESTADO DE LAS RUEDAS 8) PINTADO EN LAS ÁREAS QUE LO REQUIERE 					



DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
MESA (DIVAN) UNIVERSAL PARA EXAMEN DE GINECOLOGIA Y UROLOGIA	BIOMEDICO	536450000019	S&S MEDICAL	S/M	S/S
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIRE PINTURA 2) INSPECCIÓN MECÁNICA DE LA MESA - CAMILLA. 3) LIMPIEZA, LUBRICAR LAS PARTES MECÁNICAS 					

JOSE ROYER VARGAS SARRAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

- 4) REVISIÓN DE CONTROL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
- 5) VERIFICAR EL ESTADO DE LA COLCHONERA
- 6) REVISIÓN DEL ESTADO DE LAS RUEDAS
- 7) PINTADO EN LAS ÁREAS QUE LO REQUIERE

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
CORTINA DE AIRE 90 cm	BIOMEDICO	112226730001	COLD POINT		
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE REPARACION DE SISTEMA DE VENTILACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2) RETIRAR LA REJILLA PROTECTORA. 3) RETIRAR Y LIMPIAR EL FILTRO. SI ESTÁ DEMASIADO OBSTRUIDO, SUSTITUIR POR OTRO DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DEL ORIGINAL. 4) VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR. 5) ASPIRAR EL CONDENSADOR Y SUS ALETAS DIFUSOR 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
UNIDAD DENTAL ELECTRICA COMPLETA	BIOMEDICO	532298200017	NACIONAL		LT22-24-800N-32SE
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE REPARACION DEC IRCUITO NEUMATICO 2) REQUIERE REPARACION DE INTERRUPTOR DE CONTROL 3) EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA 4) VERIFICAR ESTADO DE MANGUERAS Y EMPAQUES EN EL SISTEMA HIDRÁULICO Y NEUMÁTICO 5) VERIFICAR FUGAS DE JERINGA TRIPLE EN BOTONERAS 6) VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE (EYECTOR Y ESCUPIDERA) Y EFECTUAR LIMPIEZA 7) EFECTUAR LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE JERINGA TRIPLE 8) LUBRICAR Y LIMPIAR PIEZA DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD (MICROMOTOR) 9) VERIFICAR LA PRESIÓN DE JERINGA TRIPLE 10) VERIFICAR FUNCIONAMIENTO Y LUBRICAR VÁLVULA PILOTO 11) VERIFICAR PRESIÓN DE SALIDA DE PIEZA DE MANO 12) REVISIÓN Y AJUSTE DE MOVIMIENTOS: SILLÓN: ESPALDAR, BRAZOS 13) REVISIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN 14) VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 					



JOSE ROYER VARGAS SÁNCHEZ
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
MICROMOTOR DENTAL	BIOMEDICO	532278380015	NSK	EX -203C	37674
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE CAMBIO DE CABEZAL 2) DESMONTAJE DE EQUIPO 3) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO 4) LIMPIEZA DE ACCESORIOS Y VERIFICACIÓN DE CONTACTOS 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
MICROMOTOR DENTAL	BIOMEDICO	532278380020	NSK	EX -203C	225802
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE CAMBIO DE CABEZAL 2) DESMONTAJE DE EQUIPO 3) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO 4) LIMPIEZA DE ACCESORIOS Y VERIFICACIÓN DE CONTACTOS 					

ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-2 BAJO IHUAMACA

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
REFRIGERADORA PARA VACUNAS	BIOMEDICO	112260390135	VESTFROST	VLS 304AC	20194736595
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO. 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO, REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 3) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES. 5) LIJADO Y PINTADO DE PARTES OXIDADAS. 6) SUMINISTRO Y LLENADO DE GAS REFRIGERANTE 404A O SEGÚN FABRICANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 7) VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y FUGA DE GAS REFRIGERANTE. 8) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA 					



JOSE ROYER VARGAS SAMANE
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
UNIDAD DENTAL	BIOMEDICO	532298200013	DENTO	BD901	8031305621
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE REPARACION DE TARJETA DE CONTROL. 2) REQUIERE REEMPLAZO DE LAMPARA. 3) REQUIERE REAPRACION DE SISTEMA DE DRENAJE. 4) REQUIERE BOTELLA DE AGUA Y MP -EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA. 5) VERIFICAR ESTADO DE MANGUERAS Y EMPAQUES EN EL SISTEMA HIDRÁULICO Y NEUMÁTICO. 6) VERIFICAR FUGAS DE JERINGA TRIPLE EN BOTONERAS. 7) VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE (EYECTOR Y ESCUPIDERA) Y EFECTUAR LIMPIEZA. 8) EFECTUAR LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE JERINGA TRIPLE. 9) LUBRICAR Y LIMPIAR PIEZA DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD (MICROMOTOR). 10) VERIFICAR LA PRESIÓN DE JERINGA TRIPLE. 11) VERIFICAR FUNCIONAMIENTO Y LUBRICAR VÁLVULA PILOTO. 12) VERIFICAR PRESIÓN DE SALIDA DE PIEZA DE MANO. 13) REVISIÓN Y AJUSTE DE MOVIMIENTOS: SILLÓN: ESPALDAR, BRAZOS. 14) REVISIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN. 15) -VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
CENTRIFUGA	BIOMEDICO	532220490041	S/M	PLC-05	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE REPARACION DE TARJETA POWER Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO. 3) EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 4) REVISIÓN Y LIMPIEZA PARA EVITAR FIBRINAS. 5) LIMPIEZA DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y TARJETA ELECTRÓNICA. 6) REVISIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, CONECTORES Y CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO. 7) VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DEL MECANISMO DE ACOPLÉ Y AJUSTE DEL ROTOR. 8) REVISIÓN DE APERTURA Y BLOQUEO DE TAPA (LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE BISAGRA). 9) LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES (RODAMIENTOS Y SISTEMAS MECÁNICOS). 10) REVISIÓN Y LIMPIEZA DE EMPAQUETADURA. 11) REVISIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL ROTOR DE LA CENTRIFUGA Y MOTOR. 12) REVISIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, CAMBIAR SI PRESENTA SIGNOS DE QUEMADURA. 13) REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL, SELECTORES DE VELOCIDAD, TIEMPO DE CENTRIFUGADO, ALARMAS Y LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN DE LA CENTRIFUGA. 14) CAMBIO DE FUSIBLES. 					



JOSE EDYFER VARGAS SARRABIE
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-1 ALTO TAMBILLO

EQUIPOS MÉDICOS CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
DETECTOR DE LATIDOS FETALES	BIOMEDICO	532230960122	EDAN	M-SONOTRAX II PRO	190041
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) APERTURA Y LIMPIEZA INTEGRAL DEL EQUIPO. 2) MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE TRANSDUCTOR. 3) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 48L	BIOMEDICO	112260390087	VESTFROST	MK-114	20123808337
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO. 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO, REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 3) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES. 5) LIJADO Y PINTADO DE PARTES OXIDADAS. 6) SUMINISTRO Y LLENADO DE GAS REFRIGERANTE 404A O SEGÚN FABRICANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 7) VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y FUGA DE GAS REFRIGERANTE. 8) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA. 					



DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS 98 L	BIOMEDICO	112260390054	VESTFROST	MF-114	20125161839
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO. 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO, REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 3) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES. 					

JOSE ROYER VARGAS SAMANE
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

- 5) LIJADO Y PINTADO DE PARTES OXIDADAS.
- 6) SUMINISTRO Y LLENADO DE GAS REFRIGERANTE 404A O SEGÚN FABRICANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
- 7) VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y FUGA DE GAS REFRIGERANTE.
- 8) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA.

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
BALANZA PEDIATRICA DE SOBREMESA	BIOMEDICO	602208560362	SECA	2	2

ACTIVIDADES:

- 1) DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
- 2) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO.
- 3) LIMPIEZA DE ACCESORIOS Y VERIFICACIÓN DE CONTACTOS.

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	532266650123	EKF DIAGNOSTIC	3040-0010-0218	3040-16-2854

ACTIVIDADES:

- 1) REQUIERE CALIBRACION.
- 2) INSPECCIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO.
- 3) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO.
- 4) REVISIÓN DEL SISTEMA DE ELÉCTRICO Y AJUSTE DE PIEZAS.
- 5) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO.
- 6) CAMBIO DE BATERÍAS CUANDO LO REQUIERA.
- 7) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD.



DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
GLUCOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	602246040246	ACCU-CHEK	ROCHE NC PERFOMA	67805094554

ACTIVIDADES:

- 1) REQUIERE TARJETA PRINCIPAL
- 2) DESMONTAJE INTEGRAL E INSPECCIÓN DEL EQUIPO
- 3) REALIZAR LA LIMPIEZA DEL EQUIPO
- 4) VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS Y CONEXIONES INTERNAS
- 5) LIMPIEZA DEL EQUIPO.
- 6) OPERATIVIDAD DEL EQUIPO.

JOSE ROYER VARGAS SANCHEZ
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
BALANZA DE PIE DE 150KG	BIOMEDICO	602206160359	SECA	803	
ACTIVIDADES: 1) REQUIERE TARJETA DE CONTROL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 2) DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 3) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 4) LIMPIEZA DE ACCESORIOS Y VERIFICACIÓN DE CONTACTOS					

ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-1 CHAMANAL

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 75 L	BIOMEDICO	112260390133	VESTFORST-SOLUTIONS	VLS-304AAC	20194736590
ACTIVIDADES: 1) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO. 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO, REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 3) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES. 5) LIJADO Y PINTADO DE PARTES OXIDADAS. 6) SUMINISTRO Y LLENADO DE GAS REFRIGERANTE 404A O SEGÚN FABRICANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 7) VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y FUGA DE GAS REFRIGERANTE. 8) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA					



EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
GLUCOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	602246040247	ACCU-CHEK	ROCHE NC PERFOMA	68830208447
ACTIVIDADES: 1) REQUIERE CALIBRACION. 2) DESMONTAJE INTEGRAL E INSPECCIÓN DEL EQUIPO. 3) REALIZAR LA LIMPIEZA DEL EQUIPO. 4) VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS Y CONEXIONES INTERNAS. 5) LIMPIEZA DEL EQUIPO. 6) OPERATIVIDAD DEL EQUIPO.					

JOSE ROYER VARGAS SAMANIE
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-1 CHINCHIQUELLA

EQUIPOS MÉDICOS CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
REFRIGERADORA PARA VACUNAS	BIOMEDICO	112260390089	VESTFROST	MK-144	20123808295
CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS 98 L	BIOMEDICO	112260390056	VESTFROST	MK-145	20125161994
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO. 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO, REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 3) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES. 5) LIJADO Y PINTADO DE PARTES OXIDADAS. 6) SUMINISTRO Y LLENADO DE GAS REFRIGERANTE 404A O SEGÚN FABRICANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 7) VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y FUGA DE GAS REFRIGERANTE. 8) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	532266650203	EKF DISGNOSTIC	3040	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) INSPECCIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO 2) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO 3) REVISIÓN DEL SISTEMA DE ELÉCTRICO Y AJUSTE DE PIEZAS 4) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO 5) CAMBIO DE BATERÍAS CUANDO LO REQUIERA 6) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD 					



JOSE ROYER VARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	BIOMEDICO	602206520234	GREETMED		GT/19/0027
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) MANTENIMIENTO PREVENTIVO VERIFICACIÓN DE PESOS CON PESAS PATRONES: 1KG, 2 KG, 5 KG. 2) AJUSTE DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS SEGÚN MANUAL DE FABRICANTE. REPARACIÓN Y AJUSTE DEL MECANISMO DE CONTRAPESO 3) ALINEAMIENTO DEL BRAZO VASCULANTE PINTADO DE LA ESTRUCTURA METALICA 4) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA BASE INTERIOR 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
BALANZA PEDIATRICA DIGITAL	BIOMEDICO	602208560388	SECA	354	8354262220742
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 2) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 3) LIMPIEZA DE ACCESORIOS Y VERIFICACIÓN DE CONTACTOS. 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
FRIGOBAR	BIOMEDICO	112252140040	INDURAMA	RI-100	1701302520270
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO. 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO, REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 3) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES. 5) LIJADO Y PINTADO DE PARTES OXIDADAS. 6) SUMINISTRO Y LLENADO DE GAS REFRIGERANTE 404A O SEGÚN FABRICANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 7) VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y FUGA DE GAS REFRIGERANTE. 8) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA. 					



JOSE ROYER VARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
RÉG. CIP. 223147

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
GLUCOMETRO	BIOMEDICO	602246040236	ACCU-CHEK	ROCHE NC PERFOMA	68805085801
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE CALIBRACION. 2) DESMONTAJE INTEGRAL E INSPECCIÓN DEL EQUIPO 3) REALIZAR LA LIMPIEZA DEL EQUIPO 4) VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS Y CONEXIONES INTERNAS 5) LIMPIEZA DEL EQUIPO. 6) OPERATIVIDAD DEL EQUIPO. 					

ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-1 EL HUABO

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
DETECTOR DE LATIDOS FETALES	BIOMEDICO	532230960098	MEDILU	FD1	460241- M17804550041
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE BATERIAS RECARGABLES. 2) REQUIERE REEMPLAZAR TRANSDUCTOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3) APERTURA Y LIMPIEZA INTEGRAL DEL EQUIPO. 4) MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE TRANSDUCTOR. 5) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA 					



DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650183	EKF-DIAGNOSTIC	3040-0010-02	3040-21-1660
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE CALIBRACION, TARJETA PRINCIPAL AVERIADA. 2) INSPECCIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO 3) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO 4) REVISIÓN DEL SISTEMA DE ELÉCTRICO Y AJUSTE DE PIEZAS 5) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO 6) CAMBIO DE BATERÍAS CUANDO LO REQUIERA 7) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD 					

JOSE ROYER MARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
GLUCOMETRO	BIOMEDICO	602246040243	ACCU-CHEK	ROCHENCERF	
ACTIVIDADES: 1) TARJETA PRINCIPAL AVERIADA, LECTURA ERRONEA. 2) DESMONTAJE INTEGRAL E INSPECCIÓN DEL EQUIPO 3) REALIZAR LA LIMPIEZA DEL EQUIPO 4) VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS Y CONEXIONES INTERNAS 5) LIMPIEZA DEL EQUIPO. 6) OPERATIVIDAD DEL EQUIPO.					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
LAMPARA INCANDESCENTE	BIOMEDICO	532271820032	S/M		
ACTIVIDADES: 1) REQUIERE LAMPARA. 2) REQUIERE REEMPLAZO DEL CIRCUITO ELECTRICO. 3) REQUIERE PINTURA Y MP INSPECCIÓN MECÁNICA DE LA LÁMPARA. 4) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LA LÁMPARA. 5) REVISIÓN DEL SISTEMA DE ELÉCTRICO Y AJUSTE DE PIEZAS. 6) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO. 7) PINTADO EN LAS ÁREAS QUE LO REQUIERAN. 8) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD.					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	BIOMEDICO	602206520198	SECA		
ACTIVIDADES: 1) REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 2) VERIFICACIÓN DE PESOS CON PESAS PATRONES: 1KG, 2 KG, 5 KG. 3) AJUSTE DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS SEGÚN MANUAL DE FABRICANTE. REPARACIÓN Y AJUSTE DEL MECANISMO DE CONTRAPESO. 4) ALINEAMIENTO DEL BRAZO VASCULANTE PINTADO DE LA ESTRUCTURA METALICA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA BASE INTERIOR.					



JOSE ROYER VARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-1 IHUAMACA

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
SILLA DE RUEDA METALICA	BIOMEDICO	536493790059			
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE LLANTAS (2) Y MP. 2) INSPECCIÓN MECÁNICA DE LA SILLA DE RUEDAS. 3) LIMPIEZA, LUBRICAR LAS PARTES MECÁNICAS. 4) REVISIÓN DE CONTROL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO. 5) REVISIÓN DEL ESTADO DE LAS RUEDAS. 6) PINTADO EN LAS ÁREAS QUE LO REQUIERAN. 7) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD. 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
FRIGOBAR	BIOMEDICO	112252140037	INDURAMA	RL-100	1701302380270
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE CARGA DE GAS, RELAY DE MOTOR AVERIADO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO. 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO, REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 3) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES. 5) LIJADO Y PINTADO DE PARTES OXIDADAS. 6) SUMINISTRO Y LLENADO DE GAS REFRIGERANTE 404A O SEGÚN FABRICANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 7) VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y FUGA DE GAS REFRIGERANTE. 8) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA. 					



ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-1 PERINGOS

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650139	EKF	3000-0031681	3000-103555
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) INSPECCIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO. 2) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 3) REVISIÓN DEL SISTEMA DE ELÉCTRICO Y AJUSTE DE PIEZAS. 					

JOSE POMEY VARGAS SAMANIE
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

- 4) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO.
- 5) CAMBIO DE BATERÍAS CUANDO LO REQUIERA.
- 6) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD.

ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-1 PUERTO SAN FRANCISCO

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650088	EKF DIAGNOSTIC	300-0031- 6801	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) INSPECCIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO. 2) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 3) REVISIÓN DEL SISTEMA DE ELÉCTRICO Y AJUSTE DE PIEZAS. 4) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO. 5) CAMBIO DE BATERÍAS CUANDO LO REQUIERA. 6) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD. 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
DETECTOR DE LATIDOS FETALES DOPPLER	BIOMEDICO	532230960152	EDAN- SONOTRAX	SONOTRAX	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) APERTURA Y LIMPIEZA INTEGRAL DEL EQUIPO. 2) MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE TRANSDUCTOR. 3) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA 					



ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-1 SAN ANTONIO

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
CONGELADORA	BIOMEDICO	112216780001	VESTFROST	MF114	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE BURLETE PARA PUERTA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 2) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO. 3) DESMONTAJE DEL EQUIPO, REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 5) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES. 					

JOSE ROYPER VARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

- 6) LIJADO Y PINTADO DE PARTES OXIDADAS.
- 7) SUMINISTRO Y LLENADO DE GAS REFRIGERANTE 404A O SEGÚN FABRICANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
- 8) VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y FUGA DE GAS REFRIGERANTE.
- 9) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA.

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
BALANZA DE PIE	BIOMEDICO	602206160300	SECA	803	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) TARJETA DE CONTROL AVERIADA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 2) DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO 4) LIMPIEZA DE ACCESORIOS Y VERIFICACIÓN DE CONTACTOS 					

ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-2 SAN MARTIN

EQUIPOS MÉDICOS CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
PANTOSCOPIO	BIOMEDICO	532289980137	RIESTER	3772-550	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) INSPECCIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO 2) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO 3) REVISIÓN DEL SISTEMA DE ELÉCTRICO Y AJUSTE DE PIEZAS 4) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO 5) CAMBIO DE BATERÍAS CUANDO LO REQUIERA 6) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
ASPIRADORA DE SECRECIONES	BIOMEDICO	532208120062	SILFAB	N32	DB5422E
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) INSPECCIÓN VISUAL. 2) MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EQUIPO. 3) DESMONTAJE INTEGRAL DEL EQUIPO. 4) LIMPIEZA EL INTERIOR Y EXTERNA DEL CHASIS. 5) MANTENIMIENTO DE MOTOR (ENGRASADO DE RODAMIENTO Y BARNIZADO DEL ESTATOR). 6) LIMPIEZA DEL SISTEMA DE DIAFRAGMA Y VÁLVULA DEL COMPRESOR. 7) LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ENCENDIDO. Y APAGADO DEL EQUIPO. 8) MONTAJE INTEGRAL DEL EQUIPO. 9) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS BACTERIOLÓGICO Y CAMBIO DE MANGUERAS SILICONADAS. 10) VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 					



JOSE ROYER VARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO IC LINED 75 L	BIOMEDICO	112260390137	VESTFORST-SOLUTIONS	VLS-304AC	20194736592
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO. 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO, REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 3) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES. 5) LIJADO Y PINTADO DE PARTES OXIDADAS. 6) SUMINISTRO Y LLENADO DE GAS REFRIGERANTE 404A O SEGÚN FABRICANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 7) VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y FUGA DE GAS REFRIGERANTE. 8) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA. 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
CONGELADORA PARA VACUNAS 171 L	BIOMEDICO	112260390156		MF 214	11527809
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO. 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO, REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 3) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES. 5) LIJADO Y PINTADO DE PARTES OXIDADAS. 6) SUMINISTRO Y LLENADO DE GAS REFRIGERANTE 404A O SEGÚN FABRICANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 7) VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y FUGA DE GAS REFRIGERANTE. 8) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA 					



DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
FRIGOBAR	BIOMEDICO	112252140036	INDURAMA	RI-100	1701302400270
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO. 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO, REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 3) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES. 5) LIJADO Y PINTADO DE PARTES OXIDADAS. 6) SUMINISTRO Y LLENADO DE GAS REFRIGERANTE 404A O SEGÚN FABRICANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 					

JOSE ROYER VARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

- 7) VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y FUGA DE GAS REFRIGERANTE.
- 8) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA.

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL ADULTO/PEDIATRICO	BIOMEDICO	532288390061	EDAN	H1100B	202869965757
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) SE VA A USAR MEDIDOR DE PARÁMETRO DE SATURACIÓN DE OXÍGENO. 2) INSPECCIÓN O REVISIÓN GLOBAL Y ESPECIFICAS DEL EQUIPO. 3) AJUSTES ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y/O MECÁNICOS. 4) VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA Y SISTEMA INDICADOR DE SPO2 Y FC 5) PRUEBAS Y VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE SPO2. 6) LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, ENGRASE. 7) PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 8) VERIFICACIÓN, Y REGULACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO. 					

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
BALANZA DE PIE DE 150KG	BIOMEDICO	602206160407	SECA	803	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) TARJETA DE CONTROL AVERIADA MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 2) DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 3) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 4) LIMPIEZA DE ACCESORIOS Y VERIFICACIÓN DE CONTACTOS. 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	BIOMEDICO	602206520263	GREETMED	GT131-200	GT/19
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO VERIFICACIÓN DE PESOS CON PESAS PATRONES: 1KG, 2 KG, 5 KG. 2) AJUSTE DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS SEGÚN MANUAL DE FABRICANTE. REPARACIÓN Y AJUSTE DEL MECANISMO DE CONTRAPESO. 3) ALINEAMIENTO DEL BRAZO VASCULANTE PINTADO DE LA ESTRUCTURA METALICA. 4) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA BASE INTERIOR 					



[Handwritten signature]
EJECUTIVO VARGAS SAMAME
AGENTE ELECTRONICO
REC. CIP. 223147

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650135	EKF DIAGNOSTIC		
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) TARJETA PRINCIPAL AVERIADA. 2) INSPECCIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO. 3) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 4) REVISIÓN DEL SISTEMA DE ELÉCTRICO Y AJUSTE DE PIEZAS. 5) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO. 6) CAMBIO DE BATERÍAS CUANDO LO REQUIERA. 7) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD. 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
GLUCOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	602246040238	ACCU-CHEK	ROCHE NC PERFORMA	68805095171
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) TARJETA DE CONTROL AVERIADA. 2) DESMONTAJE INTEGRAL E INSPECCIÓN DEL EQUIPO 3) REALIZAR LA LIMPIEZA DEL EQUIPO 4) VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS Y CONEXIONES INTERNAS 5) LIMPIEZA DEL EQUIPO. 6) OPERATIVIDAD DEL EQUIPO. 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
MANOMETRO CON HUMIFICADOR	BIOMEDICO	602254240069	MR	YR- 88E(M145015FG) MD300C29	YR-88E
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) TIENE FUGA EN SU REGULADOR Y MP. 2) DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 3) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 4) LIMPIEZA DE ACCESORIOS Y VERIFICACIÓN DE CONTACTOS. 					



JOSE ROYER VARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-1 YANDILUZA

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650057	EKF DIAGNOSTIC	1000 MA	300-0031-6801

ACTIVIDADES:

- 1) REQUIERE BATERIAS.
- 2) REQUIERE CALIBRACION.
- 3) INSPECCIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO.
- 4) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO.
- 5) REVISIÓN DEL SISTEMA DE ELÉCTRICO Y AJUSTE DE PIEZAS.
- 6) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO.
- 7) CAMBIO DE BATERÍAS CUANDO LO REQUIERA.
- 8) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD.

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
DOPPLER PORTATIL	BIOMEDICO	532248020014	MEDIBLU	FD1	02-01-210722-10

ACTIVIDADES:

- 1) REQUIERE BATERIAS.
- 2) REQUIERE CALIBRACION.
- 3) INSPECCIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO.
- 4) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO.
- 5) REVISIÓN DEL SISTEMA DE ELÉCTRICO Y AJUSTE DE PIEZAS.
- 6) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO.
- 7) CAMBIO DE BATERÍAS CUANDO LO REQUIERA.
- 8) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD.



ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-3 SAN JOSE DE LOURDES

EQUIPOS MÉDICOS CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO	BIOMEDICO	532250000002	CHISON	8500	1406009

ACTIVIDADES:

- 1) INSPECCIÓN MECÁNICA EXTERNA DEL EQUIPO, MANTENIMIENTO AL PANEL DE CONTROL
- 2) MANTENIMIENTO A TARJETAS ELECTRÓNICAS DE PROCESAMIENTO, CONTROL, ALIMENTACIÓN.
- 3) EVALUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRANSDUCTOR E IMPRESORA.
- 4) LIMPIEZA DEL EQUIPO.
- 5) PRUEBA DEL EQUIPO.

JOSE ROYER VASQUEZ SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
ESTERILIZADOR A VAPOR - AUTOCLAVE DE 60 L	BIOMEDICO	532260470046	TOPSTEL	CHS-ST065	65214035
ESTERILIZADOR DE CALOR SECO DE 60 L	BIOMEDICO	532260470080	MEMMERT	SN55	B214. 1652

ACTIVIDADES:

- 1) DESMONTAJE DEL EQUIPO
- 2) REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO.
- 3) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS.
- 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES.
- 5) LIMPIEZA DE LA CÁMARA INTERNA.
- 6) SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE PUERTA
- 7) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA CON TERMÓMETRO EXTERNO.
- 8) PRUEBA CON TIRAS INDICADORA DE ESTERILIZACIÓN.

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
EQUIPO NEBULIZADOR	BIOMEDICO	532255710072	THOMAS	1147	81400002011

ACTIVIDADES:

- 1) REQUIERE REGULADOR DE PRESION
- 2) VERIFICACIÓN INTEGRAL DEL EQUIPO.
- 3) DESMONTAJE DEL EQUIPO, REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO.
- 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS.
- 5) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES.
- 6) LUBRICACIÓN DE RODAJES DEL MOTOR.
- 7) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES.



JOSE ROYER YARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
DESTILADOR DE AGUA	ELECTROMECHANICO	532230630015	GFL	MA-45	SIN SERIE
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DEL TANQUE GENERADOR DE VAPOR 2) LIMPIEZA DEL CONDENSADOR 3) RETIRAR LOS PANELES PROTECTORES O ABRIR LA PUERTA QUE PERMITE ACCEDER AL CONDENSADOR. 4) ESTERILIZACIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DESTILADA. 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
CUNA DE CALOR RADIANTE	BIOMEDICO	532227630005	FANEM	AMPLA 2085	FAK26705
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) VERIFICACIÓN DEL EQUIPO. 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO Y LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES INTERNAS, EXTERNA Y CÚPULA. 3) LIMPIEZA DE LOS COMPONENTES INTERNOS. 4) LIMPIEZA Y REVISIÓN DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS (LIMPIA CONTACTOS DE RESIDUO CERO). 5) MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL (RESOLDANDO LOS PUNTOS). 6) LUBRICACIÓN DEL VENTILADOR DEL MÓDULO DE CALEFACCIÓN. 7) LIMPIEZA DE RUEDAS Y FRENOS DE LA BASE. 8) VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS PARTES MECÁNICAS 9) REEMPLAZO DE 01 SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL. 10) MONTAJE DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERACIÓN, Y FUNCIONAMIENTO DENTRO DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS. 					



DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 145 L	EQUIPO DE REFRIGERACION	112260390174	VESTFROST	VLS 404	112443282
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO. 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO, REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 3) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 					

JOSE ROYER VARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

- 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES.
- 5) LIJADO Y PINTADO DE PARTES OXIDADAS.
- 6) SUMINISTRO Y LLENADO DE GAS REFRIGERANTE 404A O SEGÚN FABRICANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
- 7) VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y FUGA DE GAS REFRIGERANTE.
- 8) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
MESA DE PARTOS MECANICA	MOBILIARIO	536458570009	HEFEI HEALTH	TF	HL-TF-007
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO. 2) LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. 3) LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE GARRUCHAS. 4) TAPIZADO DE LA MESA 5) AJUSTE Y REEMPLAZO DE PIERNERAS 6) LUBRICACIÓN Y AJUSTE DE PARTES MECANICAS 7) LIMPIEZA Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENO. 8) LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE COLCHONETA. 9) LIMPIEZA DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y/O ELECTRÓNICOS (UTILIZAR LIMPIA CONTACTOS DE RESIDUO CERO) 10) PRUEBAS OPERATIVAS. 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE	BIOMEDICO	532247220006	CARESTR AM DENTAL	CS 2200	CDYO549
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO 2) AJUSTES DE LAS INTERFACES. 3) MANTENIMIENTO DEL CABEZAL PORTA TUBO 4) MANTENIMIENTO DEL DISPARADOR 5) LIMPIEZA DEL EQUIPO. 6) OPERATIVIDAD DEL EQUIPO. 7) VERIFICACIÓN ÓPTICA DEL ESTADO DEL TUBO DE RAYOS "X" 8) COMPROBACIÓN DE FRENOS MECÁNICOS Y LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES EN COLUMNA 9) COMPROBAR TODOS LOS FUNCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS 					



JOSE ROYER VARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED-75 L	REFRIGERACIÓN	112260390100	VESTFROST MI	MK-304	20082141257
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO. 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO, REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 3) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES. 5) LIJADO Y PINTADO DE PARTES OXIDADAS. 6) SUMINISTRO Y LLENADO DE GAS REFRIGERANTE 404A O SEGÚN FABRICANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 7) VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y FUGA DE GAS REFRIGERANTE. 8) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 75 L	REFRIGERACIÓN	112260390125	VESTFROST	MKS240	20181404494
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO. 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO, REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 3) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES. 5) LIJADO Y PINTADO DE PARTES OXIDADAS. 6) SUMINISTRO Y LLENADO DE GAS REFRIGERANTE 404A O SEGÚN FABRICANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 7) VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y FUGA DE GAS REFRIGERANTE. 8) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA 					



JOSE RIVERA VARGAS SANAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
ESTERILIZADOR DE CALOR SECO DE 60 L	BIOMEDICO	532260470079	MEMMERT	SN55	B214. 1559
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) DESMONTAJE DEL EQUIPO 2) REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 3) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 4) AJUSTES ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y/O MECÁNICOS. 5) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES. 6) LIMPIEZA DE LA CÁMARA INTERNA. 7) SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE PUERTA 8) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA CON TERMÓMETRO EXTERNO. 9) PRUEBA CON TIRAS INDICADORA DE ESTERILIZACIÓN. 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
ASPIRADORA DE SECRECIONES PORTATIL	BIOMEDICO	532208120024	CAMI	NEW ASKIR 30	48201
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) INSPECCIÓN VISUAL. 2) MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EQUIPO. 3) DESMONTAJE INTEGRAL DEL EQUIPO. 4) LIMPIEZA EL INTERIOR Y EXTERNA DEL CHASIS 5) MANTENIMIENTO DE MOTOR (ENGRASADO DE RODAMIENTO Y BARNIZADO DEL ESTATOR). 6) LIMPIEZA DEL SISTEMA DE DIAFRAGMA Y VÁLVULA DEL COMPRESOR. 7) LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ENCENDIDO. Y APAGADO DEL EQUIPO. 8) MONTAJE INTEGRAL DEL EQUIPO. 9) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS BACTERIOLÓGICO Y CAMBIO DE MANGUERAS SILICONADAS. 10) VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 					



JOSE ROYER VARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

EQUIPOS MÉDICOS CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
LAMPARA CIALITICA RODABLE	BIOMEDICO	532270940007	HEFEI HEALTH	DL-620 B	14046334

ACTIVIDADES:

- 1) REQUIERE BATERIAS (2)
- 2) INSPECCIÓN VISUAL REVISIÓN DEL ESTADO ESTRUCTURAL DEL CHASIS, LÁMPARAS, MICAS, FILTROS, BRAZOS MECÁNICOS, SISTEMA DE FIJACIÓN DE ANCLAJE AL TECHO, SISTEMA DE RUEDAS.
- 3) VERIFICACIÓN DE ESTADO Y LIMPIEZA DE LAS PARTES Y COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, TALES COMO TARJETAS ELECTRÓNICAS, CABLES, CONECTORES, FUSIBLES, PORTAFUSIBLES, CABLE DE PODER, ENTRE OTROS.
- 4) REEMPLAZO DE PANTALLA DEL CABEZAL DEL EQUIPO
- 5) REVISIÓN, ALINEAMIENTO Y AJUSTE DEL TUBO DE BRIDAS
- 6) REVISIÓN, AJUSTE Y MANTENIMIENTO DE ARTICULACIONES, SISTEMA DE POSICIONAMIENTO, TORNILLO DE AJUSTE DE FRENO.
- 7) REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO Y APAGADO. REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE ACTIVACIÓN DE LÁMPARA DE RESERVA.
- 8) REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, ELIMINACIÓN DE FALSOS CONTACTOS.

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL	BIOMEDICO	532234770002	CAREWELL	ECG1101G	101G18C10292532

ACTIVIDADES:

- 1) REQUIERE ELECTRODOS TIPO PINTA Y CHUPONES PARA ADULTOS
- 2) REQUIERE BATERIAS
- 3) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO (TECLADO, PERILLAS, BOTONES Y DISPLAY)
- 4) MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DE CONTROL Y REAJUSTE DE COMPONENTES.
- 5) PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
CAMILLA METALICA PARA EXAMEN GINECOLOGICO	MOBILIARIO	536427150073	METAX		

ACTIVIDADES:

- 1) REQUIERE RETOQUE DE PINTURA
- 2) INSPECCIONAR CONDICIONES FÍSICAS DEL MOBILIARIO
- 3) REVISIÓN DE CONTROL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO



JOSE ROYER VARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

4) VERIFICAR EL ESTADO DE LA COLCHONERA

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCULAR CON OPTICA AL INFINITO	BIOMEDICO	532278560043	CARL ZEISS	PRIMO STAR	314004920

ACTIVIDADES:

- 1) TARJETA DE CONTROL DE LUMINUSIDAD AVERIADA
- 2) MANTENIMIENTO AL MICROSCOPIO EN GENERAL (EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA)
- 3) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO
- 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE OCULARES CON PAPEL LENTE
- 5) INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE OBJETIVOS CON EL USO DE PAPEL LENTE
- 6) REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL CONDENSADOR
- 7) LIMPIEZA DE PLATINA
- 8) REEMPLAZO DE LÁMPARA HALÓGENA
- 9) ARMADO DE LA UNIDAD, CALIBRACIÓN
- 10) REVISIÓN Y PRUEBA DE AJUSTE MACROMÉTRICO Y MICROMÉTRICO
- 11) REVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- 12) REVISIÓN Y PRUEBA DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN
- 13) LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO
- 14) PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA Y FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA AL SERVICIO



DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
PULSIOXIMETRO	BIOMEDICO	532288390005	EDAN	OO13582	

ACTIVIDADES:

- 1) TARJETA INOPERATIVA
- 2) SE VA A USAR MEDIDOR DE PARÁMETRO DE SATURACIÓN DE OXÍGENO.
- 3) INSPECCIÓN O REVISIÓN GLOBAL Y ESPECIFICAS DEL EQUIPO.
- 4) AJUSTES ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y/O MECÁNICOS.
- 5) VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA Y SISTEMA INDICADOR DE SPO2 Y FC
- 6) PRUEBAS Y VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE SPO2.
- 7) LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, ENGRASE.
- 8) PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.
- 9) VERIFICACIÓN, Y REGULACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO.

JOSE ROYER YARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
INCUBADORA DE TRANSPORTE	BIOMEDICO	532269990001	FANEM	IT-158-TS	CF-7893
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE SENSOR DE TEMPERATURA 2) REVISAR Y VERIFICAR EL SISTEMA DE CONTROL DE PARÁMETROS: TEMPERATURA AL INTERIOR DE LA INCUBADORA, TEMPERATURA DE LA PIEL DEL NEONATO, HUMEDAD RELATIVA. 3) REVISAR Y VERIFICAR LOS SENSORES DE TEMPERATURA Y OTROS ACCESORIOS DEL SISTEMA DE MONITOREO. 4) REVISAR Y VERIFICAR EL SISTEMA ELÉCTRICO DE SEGURIDAD FUSIBLE, CABLE PODER, ENCHUFE Y PUESTA A TIERRA. 5) REVISAR Y VERIFICAR EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN RADIANTE: CALEFACTOR, RESISTENCIA Y OTROS ACCESORIOS. 6) REVISAR Y VERIFICAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL CHASIS DEL EQUIPO LA BASE RODABLE Y LAS 04 GARRUCHAS. 7) REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD. 8) LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES INTERNA Y EXTERNAS DEL CHASIS, BASE RODABLE Y LAS (04) GARRUCHAS DEL EQUIPO. 9) LIMPIEZA Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE CALOR RADIANTE: CALEFACTOR, RESISTENCIAS ELÉCTRICAS Y SISTEMA ELÉCTRICO Y CONECTORES. 10) LIMPIEZA Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO DE PARÁMETROS: PANEL DE CONTROL: TARJETA ELECTRÓNICA DEL PANEL DE CONTROL, CONECTORES Y CABLEADO, ASÍ MISMO LOS SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA. 11) LIMPIEZA Y REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA, TARJETA ELECTRÓNICA DE POTENCIA CABLEADO INTERNO Y CONECTORES. 12) SISTEMA DE SEGURIDAD ELÉCTRICO FUSIBLES, CABLE PODER, ENCHUFE Y PUESTA A TIERRA. 13) LIMPIEZA Y REVISIÓN DE ACCESORIOS Y FILTROS DE AIRE. 					



DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
OXIMETRO DE PULSOS DIGITAL	BIOMEDICO	532288390005	ADVANCE	PQ-100B	316048-M
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE TARJETA PRINCIPAL 2) REQUIERE SENSOR DE SATURACION 3) SE VA A USAR MEDIDOR DE PARÁMETRO DE SATURACIÓN DE OXÍGENO. 4) INSPECCIÓN O REVISIÓN GLOBAL Y ESPECIFICAS DEL EQUIPO. 5) AJUSTES ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y/O MECÁNICOS. 6) VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA Y SISTEMA INDICADOR DE SPO2 Y FC 7) PRUEBAS Y VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE SPO2. 8) LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, ENGRASE. 9) PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 10) VERIFICACIÓN, Y REGULACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO. 					

JOSÉ ROYER VARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
MONITOR FETAL	BIOMEDICO	532281880006	EDAN	F3	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE TRANSDUCTORES 2) INSPECCIÓN O REVISIÓN GLOBAL Y ESPECIFICAS DEL EQUIPO. 3) AJUSTES ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y/O MECÁNICOS. 4) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE LOS TRANSDUCTORES 5) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD AL SISTEMA DE IMPRESIÓN 6) LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, ENGRASE 7) PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 8) VERIFICACIÓN, Y REGULACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO. 					

ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-1 FRONTERA SAN FRANCISCO

EQUIPOS MÉDICOS CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL	ELECTROMECHANICO	112220300003	VESTFROST		20100303660
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO. 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO 3) REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 5) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES. 6) LIJADO Y PINTADO DE PARTES OXIDADAS. 7) SUMINISTRO Y LLENADO DE GAS REFRIGERANTE 404A O SEGÚN FABRICANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 8) VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y FUGA DE GAS REFRIGERANTE. 9) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA 					



JOSE RUTEN VARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
REFRIGELADORA Y CONGELADORA PARA VACUNAS	ELECTROMECHANICO	112260390110	VESTFROST		
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO. 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO 3) REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 5) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES. 6) LIJADO Y PINTADO DE PARTES OXIDADAS. 7) SUMINISTRO Y LLENADO DE GAS REFRIGERANTE 404A O SEGÚN FABRICANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 8) VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y FUGA DE GAS REFRIGERANTE. 9) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
CONGELADORA	BIOMEDICO	112260390194	VESTFROST	VLS-304A	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO. 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO, REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 3) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES. 5) LIJADO Y PINTADO DE PARTES OXIDADAS. 6) SUMINISTRO Y LLENADO DE GAS REFRIGERANTE 404A O SEGÚN FABRICANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 7) VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y FUGA DE GAS REFRIGERANTE. 8) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA 					



JOSE ROYER VARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-2 APANGOYA

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650185	EKF		
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) INSPECCIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO. 2) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 3) REVISIÓN DEL SISTEMA DE ELÉCTRICO Y AJUSTE DE PIEZAS. 4) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO. 5) CAMBIO DE BATERÍAS CUANDO LO REQUIERA. 6) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD. 					

EQUIPOS MÉDICOS CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	532266650029	EKF DIAGNOSTIC	3000-0031-6801	300-10-3612
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) LECTURA ERRONEA, REQUIERE CALIBRACION 2) INSPECCIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO. 3) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 4) REVISIÓN DEL SISTEMA DE ELÉCTRICO Y AJUSTE DE PIEZAS. 5) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO. 6) CAMBIO DE BATERÍAS CUANDO LO REQUIERA. 7) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD 					



DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
ANALIZADOR BIOQUIMICO	BIOMEDICO	532202400008	EMPSUN		
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE REEMPLAZO DE LAMPARA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 2) EXAMINAR EL EXTERIOR DEL EQUIPO Y EVALUAR SU CONDICIÓN FÍSICA GENERAL. 3) VERIFICAR LA LIMPIEZA DE LAS CUBIERTAS Y EL AJUSTE DE LAS MISMAS. 4) PROBAR EL CABLE DE CONEXIÓN Y SU SISTEMA DE ACOPLES. 5) COMPROBAR QUE SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES Y QUE ESTÁN LIMPIOS. 6) EXAMINAR LOS CONTROLES DEL EQUIPO. 7) VERIFICAR QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y QUE SE PUEDEN ACCIONAR SIN DIFICULTAD. 8) VERIFICAR EL ESTADO DE BRAZO PORTA ELECTRODO. 					

JOSE RIVERA YANIGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

- 9) REVISAR LAS BATERÍAS SI APLICA.
- 10) CAMBIAR SI ES NECESARIO.
- 11) EFECTUAR UNA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO MIDIENDO UNA SOLUCIÓN CONOCIDA.

ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-2 CALABOZO

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
ESTERILIZADOR	BIOMEDICO	532260470062	FAAETA	45H	SIN SERIE
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) DESMONTAJE DEL EQUIPO. 2) REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 3) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES. 5) LIMPIEZA DE LA CÁMARA INTERNA. 6) SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE PUERTA. 7) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA CON TERMÓMETRO EXTERNO. 8) PRUEBA CON TIRAS INDICADORA DE ESTERILIZACIÓN. 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
REFRIGERADORA DE CADENA DE FRIO	BIOMEDICO	112260390010	VESTFROST	3000	SIN SERIE
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO. 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO, REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 3) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES. 5) LIJADO Y PINTADO DE PARTES OXIDADAS. 6) SUMINISTRO Y LLENADO DE GAS REFRIGERANTE 404A O SEGÚN FABRICANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 7) VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y FUGA DE GAS REFRIGERANTE. 8) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA 					



JOSE ROYER MARGAS SAMANE
Nº. CIP. 223147

ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-1 POTRERO GRANDE

EQUIPOS MÉDICOS CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
CONGELADORA DE CADENA DE FRIO	REFRIGERACIÓN	112260390050	VESTFROST	MF-114	20125161848

ACTIVIDADES:

- 1) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO.
- 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO, REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO.
- 3) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS.
- 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES.
- 5) LIJADO Y PINTADO DE PARTES OXIDADAS.
- 6) SUMINISTRO Y LLENADO DE GAS REFRIGERANTE 404A O SEGÚN FABRICANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
- 7) VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y FUGA DE GAS REFRIGERANTE.
- 8) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
ESTERILIZADOR	BIOMEDICO	532260470098	MEMMERT - ALEMANI	30-1060	SN30

ACTIVIDADES:

- 1) DESMONTAJE DEL EQUIPO
- 2) REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO.
- 3) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS.
- 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES.
- 5) LIMPIEZA DE LA CÁMARA INTERNA.
- 6) SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE PUERTA
- 7) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA CON TERMÓMETRO EXTERNO.
- 8) PRUEBA CON TIRAS INDICADORA DE ESTERILIZACIÓN.



JOSE ROYER VARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147



JOSE ROYER VARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
CONGELADORA	BIOMEDICO	112260390043	VESTFROST	MF114	
CONGELADORA	BIOMEDICO	112260390077	VESTFROST	MK144	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO. 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO. 3) REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 5) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES. 6) LIJADO Y PINTADO DE PARTES OXIDADAS. 7) SUMINISTRO Y LLENADO DE GAS REFRIGERANTE 404A O SEGÚN FABRICANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 8) VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y FUGA DE GAS REFRIGERANTE. 9) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA. 					

ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-2 07 DE AGOSTO

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
MANOMETRO DE BALON DE OXIGENO	BIOMEDICO	532246190012	LINCOLN	MEDICAL	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) TIENE FUGA, NO REGULA OXIGENO. 2) DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 3) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 4) LIMPIEZA DE ACCESORIOS Y VERIFICACIÓN DE CONTACTOS 					



DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
MANOMETRO DE BALON DE OXIGENO	BIOMEDICO	602254240042	WESTERN MEDICA	MEDICAL	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) TIENE FUGA, NO REGULA OXIGENO. 2) DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 3) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 4) LIMPIEZA DE ACCESORIOS Y VERIFICACIÓN DE CONTACTOS. 					

JOSE ROYER VARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-3 HUARANGUILLO

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
CENTRÍFUGA PARA TUBOS	BIOMEDICO	532220490024	LWS-USA	U8V-2	V201617
CENTRÍFUGA PARA TUBOS	BIOMEDICO	675003800005	GREETMED	GT119-200	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) DESMONTAJE DEL EQUIPO. 2) EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 3) REVISIÓN Y LIMPIEZA PARA EVITAR FIBRINAS. 4) LIMPIEZA DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y TARJETA ELECTRÓNICA. 5) REVISIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, CONECTORES Y CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO. 6) VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DEL MECANISMO DE ACOPLE Y AJUSTE DEL ROTOR. 7) REVISIÓN DE APERTURA Y BLOQUEO DE TAPA (LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE BISAGRA). 8) LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES (RODAMIENTOS Y SISTEMAS MECÁNICOS). 9) REVISIÓN Y LIMPIEZA DE EMPAQUETADURA. 10) REVISIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL ROTOR DE LA CENTRIFUGA Y MOTOR. 11) REVISIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, CAMBIAR SI PRESENTA SIGNOS DE QUEMADURA. 12) REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL, SELECTORES DE VELOCIDAD, TIEMPO DE CENTRIFUGADO, ALARMAS Y LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN DE LA CENTRIFUGA. 13) CAMBIO DE FUSIBLES. 					

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
PANTOSCOPIO	BIOMEDICO	532289980029	RIESTER		
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE BATERIAS 2) INSPECCIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO. 3) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 4) REVISIÓN DEL SISTEMA DE ELÉCTRICO Y AJUSTE DE PIEZAS. 5) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO. 6) CAMBIO DE BATERÍAS CUANDO LO REQUIERA. 7) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD. 					

ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-3 NAMBALLE

EQUIPOS MÉDICOS CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
ASPIRADORA DE SECRECIONES	BIOMEDICO	532208120047	CAMI	NEW-ASKIR 30	80657
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) INSPECCIÓN VISUAL. 2) MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EQUIPO. 3) MANTENIMIENTO AL CABEZAL, DIAFRAGMA, CÁMARA, PISTÓN, VALVULAS 4) MANTENIMIENTO Y AJUSTE AL SISTEMA ELÉCTRICO Y MOTOR 5) DESMONTAJE INTEGRAL DEL EQUIPO. 6) LIMPIEZA EL INTERIOR Y EXTERNA DEL CHASIS 7) MANTENIMIENTO DE MOTOR (ENGRASADO DE RODAMIENTO Y BARNIZADO DEL ESTATOR). 8) LIMPIEZA DEL SISTEMA DE DIAFRAGMA Y VÁLVULA DEL COMPRESOR. 9) LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL EQUIPO. 10) MONTAJE INTEGRAL DEL EQUIPO. 11) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS BACTERIOLÓGICO Y CAMBIO DE MANGUERAS SILICONADAS. 12) VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
DETECTOR DE LATIDOS	BIOMEDICO	532230960127	EDAN	SONOTRAXIIPRO	190044
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) APERTURA Y LIMPIEZA INTEGRAL DEL EQUIPO. 2) MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE TRANSDUCTOR. 3) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA 4) PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 5) ENTREGA DE EQUIPO OPERATIVO. 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
COMPRESORA DE AIRE DE 1 HP (USO ODONTOLOGICO)	ELECTROMECAÁNICO	532222870003	SIN MARCA	MSV6	SIN SERIE
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) DESMONTAJE INTEGRAL E INSPECCIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO 2) VERIFICACIÓN Y CAMBIO DEL PRESOSTATO. 3) REVISION DE CONEXIONES INTERNAS. 					



JOSE ROYER VARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

- 4) AJUSTES DE LAS CONEXIONES Y LIMPIEZA DE LOS CONTACTOS.
- 5) VERIFICACION Y MANTENIMIENTO DEL ESTADO DEL MOTOR. (CAMBIO DE FAJA SI LO REQUIERE)
- 6) ARMADO DEL EQUIPO.
- 7) VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE DESEMPEÑO.
- 8) PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA Y FUNCIONAMIENTO.

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO CON 3 TRADUCTORES	BIOMEDICO	53225000014	ALPINION	ECUBE	L014559

ACTIVIDADES:

- 1) INSPECCIÓN MECÁNICA EXTERNA DEL EQUIPO
- 2) MANTENIMIENTO AL PANEL DE CONTROL
- 3) MANTENIMIENTO A TARJETAS ELECTRÓNICAS DE PROCESAMIENTO, CONTROL, ALIMENTACIÓN.
- 4) EVALUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRANSDUCTOR E IMPRESORA.
- 5) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO (TECLADO, PERILLAS, BOTONES Y DISPLAY).
- 6) PRUEBA DEL EQUIPO.

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
MICROSCOPIO TRINOCULAR	BIOMEDICO	532278560073	EUROMEX	BSCOPE	1960330

ACTIVIDADES:

- 1) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO
- 2) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE OCULARES CON PAPEL LENTE
- 3) INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE OBJETIVOS CON EL USO DE PAPEL LENTE
- 4) REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL CONDENSADOR
- 5) LIMPIEZA DE PLATINA
- 6) REEMPLAZO DE LÁMPARA HALÓGENA
- 7) ARMADO DE LA UNIDAD, CALIBRACIÓN.
- 8) MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DE CONTROL Y REAJUSTE DE COMPONENTES
- 9) REVISIÓN Y PRUEBA DE AJUSTE MACROMÉTRICO Y MICROMÉTRICO
- 10) REVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- 11) REVISIÓN Y PRUEBA DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN
- 12) LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO



JOSÉ ROVER MANGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
OXIMETRO DE PULSOS PORTATIL	BIOMEDICO	532288390056	ADVANCE	S-01	316048-M18A09180047

ACTIVIDADES:

- 1) SE VA A USAR MEDIDOR DE PARÁMETRO DE SATURACIÓN DE OXÍGENO.
- 2) INSPECCIÓN O REVISIÓN GLOBAL Y ESPECIFICAS DEL EQUIPO.
- 3) AJUSTES ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y/O MECÁNICOS.
- 4) VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA Y SISTEMA INDICADOR DE SPO2 Y FC
- 5) SUMINISTRO DE CABLE DE AC BASE
- 6) SUMINISTRO DE SENSORES DE SPO2 CON CABLE DE EXTENSIÓN, ADULTO, PEDIATRIC Y NEONATAL.
- 7) SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS
- 8) PRUEBAS Y VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE SPO2.
- 9) LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, ENGRASE.
- 10) PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.
- 11) VERIFICACIÓN, Y REGULACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO.

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL ADULTO/PEDIATRICO	BIOMEDICO	532288390453	ADVANCE USA	PO-100B	20308870004

ACTIVIDADES:

- 1) SE VA A USAR MEDIDOR DE PARÁMETRO DE SATURACIÓN DE OXÍGENO.
- 2) INSPECCIÓN O REVISIÓN GLOBAL Y ESPECIFICAS DEL EQUIPO.
- 3) AJUSTES ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y/O MECÁNICOS.
- 4) SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS
- 5) SUMINISTRO DE SENSORES DE SPO2 CON CABLE DE EXTENSIÓN, ADULTO, PEDIATRIC Y NEONATAL.
- 6) SUMINISTRO DE CABLE DE AC BASE
- 7) VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA Y SISTEMA INDICADOR DE SPO2 Y FC
- 8) PRUEBAS Y VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE SPO2.
- 9) LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, ENGRASE.
- 10) PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.
- 11) VERIFICACIÓN, Y REGULACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO.



JOSE ROYER VARGAS SAMAME
INTENDENTE ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTATIL	BIOMEDICO	532230960162	EDAN		1
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) APERTURA Y LIMPIEZA INTEGRAL DEL EQUIPO. 2) MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE TRANSDUCTOR. 3) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
CAMILLA DE METAL	MOBILIARIO	536425250085	BERAMED		
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) INSPECCIONAR CONDICIONES FÍSICAS DEL MOBILIARIO 2) REVISIÓN DE CONTROL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO 3) VERIFICAR EL ESTADO DE LA COLCHONERA 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
NEBULIZADOR	BIOMEDICO	532255710133	SILFAB	N32	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) VERIFICACIÓN INTEGRAL DEL EQUIPO. 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO 3) REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 5) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES. 6) LUBRICACIÓN DE RODAJES DEL MOTOR. 7) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES. 					



DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
NEBULIZADOR	BIOMEDICO	532255710114	SILFAB	N32	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) VERIFICACIÓN INTEGRAL DEL EQUIPO. 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO 3) REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 					

JOSE ROYER YARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

- 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS.
- 5) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES.
- 6) LUBRICACIÓN DE RODAJES DEL MOTOR.
- 7) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES.

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
DETECTOR DE LATIDOS	BIOMEDICO	532250000023	EDAN	SONOTRAX	

ACTIVIDADES:

- 1) APERTURA Y LIMPIEZA INTEGRAL DEL EQUIPO.
- 2) MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE TRANSDUCTOR.
- 3) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
NEBULIZADOR	BIOMEDICO	532255710118	SILFAB	N32	

ACTIVIDADES:

- 1) VERIFICACIÓN INTEGRAL DEL EQUIPO.
- 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO
- 3) REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO.
- 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS.
- 5) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES.
- 6) LUBRICACIÓN DE RODAJES DEL MOTOR.
- 7) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES.



EQUIPOS MÉDICOS CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
CAMILLA METALICA PARA EXAMEN GINECOLOGICO	MOBILIARIO	536427150135	VAN	SIN MODELO	SIN SERIE

ACTIVIDADES:

- 1) REQUIERE PINTURA
- 2) INSPECCIONAR CONDICIONES FÍSICAS DEL MOBILIARIO
- 3) REVISIÓN DE CONTROL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
- 4) VERIFICAR EL ESTADO DE LA COLCHONERA

JOSE ROYER VARGAS SAMANIF
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
UNIDAD DENTAL ELECTRICA COMPLETA	BIOMEDICO	532298200026	PREZ	PZ1026	19062519
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE REPARACION DE VALVULA SWIT 2) EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA 3) VERIFICAR ESTADO DE MANGUERAS Y EMPAQUES EN EL SISTEMA HIDRÁULICO Y NEUMÁTICO 4) VERIFICAR FUGAS DE JERINGA TRIPLE EN BOTONERAS 5) VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE (EYECTOR Y ESCUPIDERA) Y EFECTUAR LIMPIEZA 6) EFECTUAR LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE JERINGA TRIPLE 7) LUBRICAR Y LIMPIAR PIEZA DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD (MICROMOTOR) 8) VERIFICAR LA PRESIÓN DE JERINGA TRIPLE 9) VERIFICAR FUNCIONAMIENTO Y LUBRICAR VÁLVULA PILOTO 10) VERIFICAR PRESIÓN DE SALIDA DE PIEZA DE MANO 11) REVISIÓN Y AJUSTE DE MOVIMIENTOS: SILLÓN: ESPALDAR, BRAZOS 12) REVISIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN 13) VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
CAMILLA DE METAL PEDIATRICA	MOBILIARIO	536425250170	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE
CAMILLA DE METAL PEDIATRICA	MOBILIARIO	536425250125	GBJHAVAL MEDICAL	SIN MODELO	SIN SERIE
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE PINTURA 2) INSPECCIONAR CONDICIONES FÍSICAS DEL MOBILIARIO 3) REVISIÓN DE CONTROL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO 4) VERIFICAR EL ESTADO DE LA COLCHONERA 					



DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
MONITOR FETAL INTRA PARTO PORTATIL	BIOMEDICO	532281880012	BISTOS	BT350	AF680086
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) INSPECCIÓN O REVISIÓN GLOBAL Y ESPECIFICAS DEL EQUIPO. 2) AJUSTES ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y/O MECÁNICOS. 3) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE LOS TRANSDUCTORES 4) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD AL SISTEMA DE IMPRESIÓN 5) MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA 6) REEMPLAZO DE TRASNDUCTOR TOCO 					

JOSE ROYER MARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

- 7) LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, ENGRASE.
- 8) PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.
- 9) VERIFICACIÓN, Y REGULACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO.

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO CAPACIDAD 220 kg	BIOMEDICO	602206520173	SECA	700	5700337167348

ACTIVIDADES:

- 1) REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
- 2) VERIFICACIÓN DE PESOS CON PESAS PATRONES: 1KG, 2 KG, 5 KG.
- 3) AJUSTE DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS SEGÚN MANUAL DE FABRICANTE.
- 4) REPARACIÓN Y AJUSTE DEL MECANISMO DE CONTRAPESO
- 5) ALINEAMIENTO DEL BRAZO VASCULANTE
- 6) PINTADO DE LA ESTRUCTURA METALICA
- 7) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA BASE INTERIOR

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
OXIMETRO	BIOMEDICO	532288080002	EDAN	H100B	360101-M18C11260143

ACTIVIDADES:

- 1) SE REQUIERE SENSOR
- 2) SE VA A USAR MEDIDOR DE PARÁMETRO DE SATURACIÓN DE OXÍGENO.
- 3) INSPECCIÓN O REVISIÓN GLOBAL Y ESPECIFICAS DEL EQUIPO.
- 4) AJUSTES ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y/O MECÁNICOS.
- 5) VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA Y SISTEMA INDICADOR DE SPO2 Y FC
- 6) PRUEBAS Y VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE SPO2.
- 7) LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, ENGRASE.
- 8) PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.
- 9) VERIFICACIÓN, Y REGULACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO.



JOSÉ ROYER VARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
MESA (DIVAN) UNIVERSAL PARA EXAMEN DE GINECOLOGIA Y UROLOGIA	MOBILIARIO	536450000018	S&S MEDICAL		
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE PINTURA 2) INSPECCIÓN MECÁNICA DE LA MESA - CAMILLA. 3) LIMPIEZA, LUBRICAR LAS PARTES MECÁNICAS 4) REVISIÓN DE CONTROL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO 5) VERIFICAR EL ESTADO DE LA COLCHONERA 6) REVISIÓN DEL ESTADO DE LAS RUEDAS 7) PINTADO EN LAS ÁREAS QUE LO REQUIERE 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
LAMPARA INCANDESCENTE	BIOMEDICO	532271820084			
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE LAMPARA 2) INSPECCIÓN MECÁNICA DE LA LÁMPARA 3) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LA LÁMPARA 4) REVISIÓN DEL SISTEMA DE ELÉCTRICO Y AJUSTE DE PIEZAS 5) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO 6) PINTADO EN LAS ÁREAS QUE LO REQUIERAN 7) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD. 					



DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
BALANZA DE PIE	BIOMEDICO	602206520227	TSCALE	M301	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE CARGADOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2) DESMONTAJE DE EQUIPO 3) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO 4) LIMPIEZA DE ACCESORIOS Y VERIFICACIÓN DE CONTACTOS 					

JOSE ROYPER VARGAS SAMABIE
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-3 HUARANGO

EQUIPOS MÉDICOS CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
CAMILLA GINECOLOGICA	MOBILIARIO	536427150048	KL-2C		
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 2) INSPECCIONAR CONDICIONES FÍSICAS DEL MOBILIARIO. 3) REVISIÓN DE CONTROL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO. 4) VERIFICAR EL ESTADO DE LA COLCHONERA. 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
DOPPLER FETAL	BIOMEDICO	532230960114	EDAN	S-D5	M17A05610030
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) APERTURA Y LIMPIEZA INTEGRAL DEL EQUIPO. 2) MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE TRANSDUCTOR. 3) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA. 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
EQUIPO BAÑO MARIA	BIOMEDICO	672243310022	KERT LAB	CDK-S24	13050484
ACTIVIDADES. <ol style="list-style-type: none"> 1) VERIFICACIÓN INTEGRAL DEL EQUIPO. 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO. 3) REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 5) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES. 6) LIMPIEZA DE CÁMARA. 7) VERIFICACIÓN DE TIEMPO DE TRABAJO CON CRONOMETRO EXTERNO. 8) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA CON TERMÓMETRO EXTERNO. 					



DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
CENTRIFUGA DE 24 TUBOS	BIOMEDICO	532220490040	GREETMED	NEXTSPIN	TP209040009
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) DESMONTAJE DEL EQUIPO. 2) EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 3) REVISIÓN Y LIMPIEZA PARA EVITAR FIBRINAS. 4) LIMPIEZA DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y TARJETA ELECTRÓNICA. 5) REVISIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, CONECTORES Y CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO. 					

JOSE ROYCE VARGAS SAMAMIE
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

- 6) VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DEL MECANISMO DE ACOPLE Y AJUSTE DEL ROTOR.
- 7) REVISIÓN DE APERTURA Y BLOQUEO DE TAPA (LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE BISAGRA).
- 8) LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES (RODAMIENTOS Y SISTEMAS MECÁNICOS).
- 9) REVISIÓN Y LIMPIEZA DE EMPAQUETADURA.
- 10) REVISIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL ROTOR DE LA CENTRIFUGA Y MOTOR.
- 11) REVISIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, CAMBIAR SI PRESENTA SIGNOS DE QUEMADURA.
- 12) REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL, SELECTORES DE VELOCIDAD, TIEMPO DE CENTRIFUGADO, ALARMAS Y LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN DE LA CENTRIFUGA
- 13) CAMBIO DE FUSIBLES.

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
CAMILLA GINECOLOGICA	MOBILIARIO	536427150136	BERAMED		
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 2) INSPECCIONAR CONDICIONES FÍSICAS DEL MOBILIARIO. 1) REVISIÓN DE CONTROL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO. 2) VERIFICAR EL ESTADO DE LA COLCHONERA. 					

EQUIPOS MÉDICOS CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
MONITOR FETAL	BIOMEDICO	532281880009	EDAN	F3	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) LECTURA DISTORCIONADA. 2) REQUIERE TRANSDUCTOR. 3) REQUIERE BANDAS ELASTICAS Y MP. 4) INSPECCIÓN O REVISIÓN GLOBAL Y ESPECIFICAS DEL EQUIPO. 5) AJUSTES ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y/O MECÁNICOS. 6) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD. 7) MANTENIMIENTO DE LOS TRANSDUCTORES. 8) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD AL SISTEMA DE IMPRESIÓN, MANTTO DE CELDA TERM. 9) LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, ENGRASE. 10) PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 11) VERIFICACIÓN, Y REGULACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO. 					



DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
AIRE ACONDICIONADO	BIOMEDICO	112236140004	ELECTROLUX		42301468
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE CARGA DE GAS. 2) REQUIERE CAMBIO DE FILTROS. 3) MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 					

JOSE ROYER VARGAS SAMARIE
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

- 4) DESMONTAJE DE LAS PARTES METÁLICAS Y CARCASAS DE LAS UNIDADES EVAPORADORAS Y CONDENSADORAS
- 5) MANTENIMIENTO Y PULVERIZADO CON ADITIVOS QUÍMICOS A LOS SERPENTINES DE LAS UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS.
- 6) LIMPIEZA Y PULVERIZADO DE LOS FILTROS DE AIRE.
- 7) LIMPIEZA Y COMPONENTES ELÉCTRICOS DE LAS UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS CON LIMPIA CONTACTOS S-25 U OTRO SIMILAR NORMADO PARA ESTOS EQUIPOS.
- 8) AJUSTE DE CONTACTOS, TORNILLOS DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS.
- 9) MEDICIÓN DE PRESIÓN DEL GAS REFRIGERANTE.
- 10) VERIFICACIÓN Y/O CAMBIO DE AISLANTES DE LAS TUBERÍAS DE ALTA Y BAJA POR THERMAFLEX
- 11) OTRAS ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS A FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CON LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE AL EQUIPO.
- 12) CAPACITACIÓN EN EL USO, MANEJO Y CUIDADOS DEL EQUIPO AL PERSONAL USUARIO.
- 13) PRUEBAS GENERALES DE OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO.

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650134	EKF	3040-0010-0218	3040-18-1078

ACTIVIDADES:

- 1) ERROR DE LECTURA, ERROR DE TEMPERATURA, TARJETA AVERIADA.
- 2) INSPECCIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO.
- 3) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO.
- 4) REVISIÓN DEL SISTEMA DE ELÉCTRICO Y AJUSTE DE PIEZAS.
- 5) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO.
- 6) CAMBIO DE BATERÍAS CUANDO LO REQUIERA.
- 7) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD.

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
UNIDAD DENTAL ELECTRICA COMPLETA	BIOMEDICO	532298200024	VOVO DENTAL	V-920	1306035

ACTIVIDADES:

- 1) PRESENTA ESCUPIDERA ROTA.
- 2) REQUIERE TAPA DE DISTRIBUCION.
- 3) REQUIERE CAJA DE DRENAJE Y MP.
- 4) EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA.
- 5) VERIFICAR ESTADO DE MANGUERAS Y EMPAQUES EN EL SISTEMA HIDRÁULICO Y NEUMÁTICO.
- 6) VERIFICAR FUGAS DE JERINGA TRIPLE EN BOTONERAS.
- 7) VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE (EYECTOR Y ESCUPIDERA) Y EFECTUAR LIMPIEZA.
- 8) EFECTUAR LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE JERINGA TRIPLE.
- 9) LUBRICAR Y LIMPIAR PIEZA DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD (MICROMOTOR).
- 10) -VERIFICAR LA PRESIÓN DE JERINGA TRIPLE.
- 11) -VERIFICAR FUNCIONAMIENTO Y LUBRICAR VÁLVULA PILOTO.
- 12) VERIFICAR PRESIÓN DE SALIDA DE PIEZA DE MANO.
- 13) REVISIÓN Y AJUSTE DE MOVIMIENTOS: SILLÓN: ESPALDAR, BRAZOS.
- 14) REVISIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN.



JOSE ROYER VARGAS SAMARIF
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

15) VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 105 L	EQUIPO DE REFRIGERACION	112260390058	VESTFROST MI	MK-304	20134849154

ACTIVIDADES:

- 1) REQUIERE BURLETE PARA PUERTA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
- 1) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO.
- 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO.
- 3) REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO.
- 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS.
- 5) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES.
- 6) LIJADO Y PINTADO DE PARTES OXIDADAS.
- 7) SUMINISTRO Y LLENADO DE GAS REFRIGERANTE 404A O SEGÚN FABRICANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
- 8) VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y FUGA DE GAS REFRIGERANTE.
- 9) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA.

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO PORTATIL	BIOMEDICO	532250000057	VINNO	A6	V0672FX004

ACTIVIDADES:

- 1) REQUIERE CALIBRACION DE PARAMETROS EN LA LECTURA DE LOS TRANSDUCTORES.
- 2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
- 3) INSPECCIÓN MECÁNICA EXTERNA DEL EQUIPO.
- 4) MANTENIMIENTO AL PANEL DE CONTROL.
- 5) MANTENIMIENTO A TARJETAS ELECTRÓNICAS DE PROCESAMIENTO, CONTROL, ALIMENTACIÓN.
- 6) EVALUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRANSDUCTOR E IMPRESORA.
- 7) LIMPIEZA DEL EQUIPO.
- 8) PRUEBA DEL EQUIPO.

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
MICROSCOPIO BINOCULAR	BIOMEDICO	532278560079	OPTIKA	B-292PLI	548795

ACTIVIDADES:

- 1) REQUIERE TARJETA POWER DE CONTROL DE LUMINUSIDAD Y MP.
- 2) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO.



JOSE ROYER VARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

- 3) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE OCULARES CON PAPEL LENTE.
- 4) INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE OBJETIVOS CON EL USO DE PAPEL LENTE.
- 5) REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL CONDENSADOR.
- 6) LIMPIEZA DE PLATINA.
- 7) REVISIÓN Y PRUEBA DE AJUSTE MACROMÉTRICO Y MICROMÉTRICO.
- 8) REVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.
- 9) REVISIÓN Y PRUEBA DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN.
- 10) LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO.

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650167	EKF DIAGNOSTIC	3040-0010-0218	3040-19-0238

ACTIVIDADES:

- 1) PRESENTA ERROR DE LECTURA, ERROR DE TEMPERATURA.
- 2) REQUIERE CALIBRACION.
- 3) INSPECCIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO.
- 4) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO.
- 5) REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE PIEZAS.
- 6) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO.
- 7) CAMBIO DE BATERÍAS CUANDO LO REQUIERA.
- 8) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD.

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
NEBULIZADOR	BIOMEDICO	532255710136	ELMASLAR	CN03	2004030131

ACTIVIDADES:

- 1) REQUIERE REPARACION DE VALCULA DE SALIDA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
- 2) VERIFICACIÓN INTEGRAL DEL EQUIPO.
- 3) DESMONTAJE DEL EQUIPO.
- 4) REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO.
- 5) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS.
- 6) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES.
- 7) LUBRICACIÓN DE RODAJES DEL MOTOR.
- 8) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES.



DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL ADULTO/PEDIATRICO	BIOMEDICO	532288390452	ADVANCE	PO.100B	261999-M20308870001

ACTIVIDADES:

- 1) TARJETA PRINCIPAL AVERIADA Y MP.
- 2) SE VA A USAR MEDIDOR DE PARÁMETRO DE SATURACIÓN DE OXÍGENO.
- 3) INSPECCIÓN O REVISIÓN GLOBAL Y ESPECIFICAS DEL EQUIPO.

JOSE ROYER VARGAS SAMANIF
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

- 4) AJUSTES ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y/O MECÁNICOS.
- 5) VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA Y SISTEMA INDICADOR DE SPO2 Y FC.
- 6) PRUEBAS Y VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE SPO2.
- 7) LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, ENGRASE.
- 8) PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.
- 9) -VERIFICACIÓN, Y REGULACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO.

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
PANTOSCOPIO	BIOMEDICO	532289980172	RIESTER	ENT DIAGNOSTIC SET	5925002-11-2020-1697
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) CUERPO DE BATERIAS AVERIADO Y MP. 2) INSPECCIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO. 3) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 4) REVISIÓN DEL SISTEMA DE ELÉCTRICO Y AJUSTE DE PIEZAS. 5) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO. 6) CAMBIO DE BATERÍAS CUANDO LO REQUIERA. 7) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD. 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
CONGELADORA	BIOMEDICO	112260390027	VESTFROST MI	MF314	20131007261
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE BURLETE PARA PUERTA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 2) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO. 3) DESMONTAJE DEL EQUIPO. 4) REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 5) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 6) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES. 7) LIJADO Y PINTADO DE PARTES OXIDADAS. 8) SUMINISTRO Y LLENADO DE GAS REFRIGERANTE 404A O SEGÚN FABRICANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 9) VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y FUGA DE GAS REFRIGERANTE. 10) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA 					



JOSE ROYER VARGAS SAMARIF
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
NEBULIZADOR	BIOMEDICO	532255710122	SILFAB	N32D	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE FUSIBLE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 2) VERIFICACIÓN INTEGRAL DEL EQUIPO. 3) DESMONTAJE DEL EQUIPO. 4) REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 5) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 6) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES. 7) LUBRICACIÓN DE RODAJES DEL MOTOR. 8) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES. 					

ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-2 HUARANDOZA

EQUIPOS MÉDICOS CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL	REFRIGERACIÓN	112220300009	VESFOROST	MF-114	20084838904
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO. 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO. 3) REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 5) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES. 6) LIJADO Y PINTADO DE PARTES OXIDADAS. 7) SUMINISTRO Y LLENADO DE GAS REFRIGERANTE 404A O SEGÚN FABRICANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 8) VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y FUGA DE GAS REFRIGERANTE. 9) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA. 					



DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
REFRIGERADORA PARA VACUNA ICE LINED 75L	BIOMEDICO	1122603900095	VESFOROST	MK-204	20124636131
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO. 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO, REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 					

JOSE ROYER VARGAS SAMANIE
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

- 3) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS.
- 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES.
- 5) LIJADO Y PINTADO DE PARTES OXIDADAS.
- 6) SUMINISTRO Y LLENADO DE GAS REFRIGERANTE 404A O SEGÚN FABRICANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
- 7) VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y FUGA DE GAS REFRIGERANTE.
- 8) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA.

EQUIPOS MÉDICOS CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650022	EKF DIAGNOSTIC	3000-0031-6801	3000-10-3627
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE BATERIA. 2) REQUIERE CALIBRACION. 3) INSPECCIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO. 4) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 5) REVISIÓN DEL SISTEMA DE ELÉCTRICO Y AJUSTE DE PIEZAS. 6) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO. 7) CAMBIO DE BATERÍAS CUANDO LO REQUIERA. 8) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD. 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650164	EKF	3040	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE CALIBRACION. 2) INSPECCIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO. 3) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 4) REVISIÓN DEL SISTEMA DE ELÉCTRICO Y AJUSTE DE PIEZAS. 5) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO. 6) CAMBIO DE BATERÍAS CUANDO LO REQUIERA. 7) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD. 					



ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-1 LA MUSCHA

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
CONGELADORA	BIOMEDICO	112220300016	VESTFROST	MF 114	201003033679
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO. 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO. 					

JOSE ROYPER VARGAS SAMAYO
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

- 3) REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO.
- 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS.
- 5) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES.
- 6) LIJADO Y PINTADO DE PARTES OXIDADAS.
- 7) SUMINISTRO Y LLENADO DE GAS REFRIGERANTE 404A O SEGÚN FABRICANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
- 8) VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y FUGA DE GAS REFRIGERANTE.
- 9) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
REFRIGERADORA	BIOMEDICO	112260390127	VESFOROST	MKS204	20181404503

ACTIVIDADES:

- 1) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO.
- 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO.
- 3) REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO.
- 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS.
- 5) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES.
- 6) LIJADO Y PINTADO DE PARTES OXIDADAS.
- 7) SUMINISTRO Y LLENADO DE GAS REFRIGERANTE 404A O SEGÚN FABRICANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
- 8) VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y FUGA DE GAS REFRIGERANTE.
- 9) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA



DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650157	EKF DIAGNOSTIC	309019	3090-19-190625
HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650206	EKF		

ACTIVIDADES:

- 1) INSPECCIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO.
- 2) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO.
- 3) REVISIÓN DEL SISTEMA DE ELÉCTRICO Y AJUSTE DE PIEZAS.
- 4) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO.
- 5) CAMBIO DE BATERÍAS CUANDO LO REQUIERA.
- 6) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD.

JOSE ROYER VARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
NEBULIZADOR	BIOMEDICO	532255710079	THOMAS	1127	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) VERIFICACIÓN INTEGRAL DEL EQUIPO. 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO, REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 3) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES. 5) LUBRICACIÓN DE RODAJES DEL MOTOR. 6) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES. 					

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
CAMILLA METALICA PARA EXAMEN GINECOLOGICO	BIOMEDICO	536427150148	VENMEDIC		
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) SISTEMA DE ELEVACION AVERIADO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 2) INSPECCIONAR CONDICIONES FÍSICAS DEL MOBILIARIO. 3) REVISIÓN DE CONTROL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO. 4) VERIFICAR EL ESTADO DE LA COLCHONERA. 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
UPS	ELECTROMECHANICO	462200500063	ELISE	AUR VISTA650	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) TARJETA DE CONTROL AVERIADO, BATERIA AVERIADA Y MP. 2) DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 3) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 4) LIMPIEZA DE ACCESORIOS Y VERIFICACIÓN DE CONTACTOS 					



DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	BIOMEDICO	602206520215	SECA		
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 2) VERIFICACIÓN DE PESOS CON PESAS, PATRONES: 1KG, 2 KG, 5 KG. 3) AJUSTE DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS SEGÚN MANUAL DE FABRICANTE. 4) REPARACIÓN Y AJUSTE DEL MECANISMO DE CONTRAPESO. 5) ALINEAMIENTO DEL BRAZO VASCULANTE PINTADO DE LA ESTRUCTURA METALICA 6) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA BASE INTERIOR 					

Dr. J. VARGAS SAMAME
FIRMADO ELECTRONICAMENTE
REG. CIP. 223147

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
ESTABILIZADOR PARA CADENA DE FRIO	BIOMEDICO	462252150420	EVERGIT		
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) TARJETA DE CONTROL DE POTENCIA AVERIADA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 2) INSPECCIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO. 3) DESMONTAJE INTEGRAL DE EQUIPO. 4) MANTENIMIENTO AL MOTOR Y ELEMENTOS MECÁNICOS. 5) AJUSTE DE CONEXIONES INTERNAS. 6) ARMADO DEL EQUIPO. 7) PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA Y FUNCIONAMIENTO. 8) LIMPIEZA DEL EQUIPO 					

ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-2 EL TRIUNFO

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
ANALIZADOR BIOQUIMICO	BIOMEDICO	532202400015	EMPEROR	MP-168	610008116
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) LECTURA DE MUESTRAS VARIADAS. 2) REQUIERE LAMPARA. 3) REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 4) EXAMINAR EL EXTERIOR DEL EQUIPO. 5) EVALUAR SU CONDICIÓN FÍSICA GENERAL. 6) VERIFICAR LA LIMPIEZA DE LAS CUBIERTAS Y EL AJUSTE DE LAS MISMAS. 7) PROBAR EL CABLE DE CONEXIÓN Y SU SISTEMA DE ACOPLES. 8) COMPROBAR QUE SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES Y QUE ESTÁN LIMPIOS. 9) EXAMINAR LOS CONTROLES DEL EQUIPO. 10) VERIFICAR QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y QUE SE PUEDEN ACCIONAR SIN DIFICULTAD. 11) VERIFICAR EL ESTADO DE BRAZO PORTA ELECTRODO. 12) REVISAR LAS BATERÍAS SI APLICA; CAMBIAR SI ES NECESARIO. 13) EFECTUAR UNA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO MIDIENDO UNA SOLUCIÓN CONOCIDA. 					



DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650175	EKF		3000
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE CALIBRACION. 2) INSPECCIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO. 3) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 4) REVISIÓN DEL SISTEMA DE ELÉCTRICO Y AJUSTE DE PIEZAS. 5) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO. 6) CAMBIO DE BATERÍAS CUANDO LO REQUIERA. 					

JOSE ROYER VARGAS SAMANIF
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

7) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD.

ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-3 TAMBORAPA PUEBLO

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
ECOGRAFO	BIOMEDICO	532250000003	SANSUNG	SONOACE R3	M3HD00017A
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) INSPECCIÓN MECÁNICA EXTERNA DEL EQUIPO. 2) MANTENIMIENTO AL PANEL DE CONTROL. 3) MANTENIMIENTO A TARJETAS ELECTRÓNICAS DE PROCESAMIENTO, CONTROL, ALIMENTACIÓN. 4) EVALUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRANSDUCTOR E IMPRESORA. 5) LIMPIEZA DEL EQUIPO. 6) PRUEBA DEL EQUIPO. 					

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
DETECTOR DE LATIDOS	BIOMEDICO	532230960096	EDAN	SONOTRAX	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE BATERIA. 2) REQUIERE CARGADOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 3) APERTURA Y LIMPIEZA INTEGRAL DEL EQUIPO. 4) MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE TRANSDUCTOR. 5) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA 					



DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
BALANZA DE PIE	BIOMEDICO	602206160329	SECA	803	
BALANZA DE PIE	BIOMEDICO	602206160429	SECA		
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) LECTURA INCORREPTA. 2) FALTA CALIBRACION. 3) REQUIERE BATERIAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 4) DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 5) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 6) LIMPIEZA DE ACCESORIOS Y VERIFICACIÓN DE CONTACTOS. 					

JOSE ROYER VARGAS SAMARTE
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-2 PANCHIA

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
CENTRIFUGA DE 8 TUBOS	BIOMEDICO	532220490013	LW SCIENTIFIC		40237
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) INTERRUPTOR CON MECANISMO DE PUERTA AVERIADO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO. 3) EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 4) REVISIÓN Y LIMPIEZA PARA EVITAR FIBRINAS. 5) LIMPIEZA DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y TARJETA ELECTRÓNICA. 6) REVISIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, CONECTORES Y CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO. 7) VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DEL MECANISMO DE ACOUPLE Y AJUSTE DEL ROTOR. 8) REVISIÓN DE APERTURA Y BLOQUEO DE TAPA (LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE BISAGRA). 9) LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES (RODAMIENTOS Y SISTEMAS MECÁNICOS). 10) REVISIÓN Y LIMPIEZA DE EMPAQUETADURA. 11) REVISIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL ROTOR DE LA CENTRIFUGA Y MOTOR. 12) REVISIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO. 13) CAMBIAR SI PRESENTA SIGNOS DE QUEMADURA. 14) REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL, SELECTORES DE VELOCIDAD, TIEMPO DE CENTRIFUGADO, ALARMAS Y LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN DE LA CENTRIFUGA. 15) CAMBIO DE FUSIBLES. 					

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
PANTOSCOPIO	BIOMEDICO	532289980074	RIESTER		
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE LAMPARA. 2) REQUIERE BATERIA TIPO C Y MP. 3) INSPECCIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO. 4) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 5) REVISIÓN DEL SISTEMA DE ELÉCTRICO Y AJUSTE DE PIEZAS. 6) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO. 7) CAMBIO DE BATERÍAS CUANDO LO REQUIERA. 8) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD. 					



JOSE ROYER VARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
ESTERILIZADOR	BIOMEDICO	532260470071	FAETA	45H	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REPARACION DE TARJETA PRINCIPAL. 2) CAMBIAR ETIQUETA DE PANEL. 3) DESMONTAJE DEL EQUIPO. 4) REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 5) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 6) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES. 7) LIMPIEZA DE LA CÁMARA INTERNA. 8) SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE PUERTA. 9) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA CON TERMÓMETRO EXTERNO. 10) PRUEBA CON TIRAS INDICADORA DE ESTERILIZACIÓN. 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650061	EKF		
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE BATERIA. 2) INSPECCIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO. 3) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 4) REVISIÓN DEL SISTEMA DE ELÉCTRICO Y AJUSTE DE PIEZAS. 5) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO. 6) CAMBIO DE BATERÍAS CUANDO LO REQUIERA. 7) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD. 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
MICROSCOPIO	BIOMEDICO	532278560082	OPTIKA		
MICROSCOPIO	BIOMEDICO	532278560041	ZEISS	PRIMO STAR	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE OBJETIVOS 10, 40 Y 100 Y MP. 2) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO. 3) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE OCULARES CON PAPEL LENTE. 4) INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE OBJETIVOS CON EL USO DE PAPEL LENTE. 5) REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL CONDENSADOR. 6) LIMPIEZA DE PLATINA. 7) REVISIÓN Y PRUEBA DE AJUSTE. 8) MACROMÉTRICO Y MICROMÉTRICO. 9) REVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN. 10) REVISIÓN Y PRUEBA DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN. 11) LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 					



JOSÉ ROYER VARGAS SAMARCA
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
TERMOMETRO INFLAROJO	BIOMEDICO	602292810044	CONTEC	TP500	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) LECTURA DE TEMPERATURA DEFECTUADO. 2) TARJETA PRINCIPAL AVERIADA Y MP. 3) DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 4) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 5) LIMPIEZA DE ACCESORIOS Y VERIFICACIÓN DE CONTACTOS. 					

ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-2 CHURUYACU

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
MICROSCOPIO BINOCULAR	BIOMEDICO	532278560057	CARL-ZEISS	PRIMO STAR	3116028872
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO. 2) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE OCULARES CON PAPEL LENTE. 3) INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE OBJETIVOS CON EL USO DE PAPEL LENTE. 4) REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL CONDENSADOR. 5) LIMPIEZA DE PLATINA. 6) REVISIÓN Y PRUEBA DE AJUSTE MACROMÉTRICO Y MICROMÉTRICO. 7) REVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN. 8) REVISIÓN Y PRUEBA DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN. 9) LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 					



DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650173	EKF DIAGNOSTIC	3040-0010-0218	3040-20-0358
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) INSPECCIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO. 2) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 3) REVISIÓN DEL SISTEMA DE ELÉCTRICO Y AJUSTE DE PIEZAS. 4) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO. 5) CAMBIO DE BATERÍAS CUANDO LO REQUIERA. 6) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD. 					

JOSE ROYPER VARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	BIOMEDICO	112236140014	AESX12C6ALN	ELECTROLUX	40301269
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) DESMONTAJE DE LAS PARTES METÁLICAS Y CARCASAS DE LAS UNIDADES EVAPORADORAS Y CONDENSADORAS. 2) MANTENIMIENTO Y PULVERIZADO CON ADITIVOS QUÍMICOS A LOS SERPENTINES DE LAS UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS. 3) LIMPIEZA Y PULVERIZADO DE LOS FILTROS DE AIRE. 4) LIMPIEZA Y COMPONENTES ELÉCTRICOS DE LAS UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS CON LIMPIA CONTACTOS S-25 U OTRO SIMILAR NORMADO PARA ESTOS EQUIPOS. 5) AJUSTE DE CONTACTOS, TORNILLOS DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS 6) MEDICIÓN DE PRESIÓN DEL GAS REFRIGERANTE. 7) VERIFICACIÓN Y/O CAMBIO DE AISLANTES DE LAS TUBERÍAS DE ALTA Y BAJA POR THERMAFLEX 8) OTRAS ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS A FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CON LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE AL EQUIPO. 9) CAPACITACIÓN EN EL USO, MANEJO Y CUIDADOS DEL EQUIPO AL PERSONAL USUARIO. 10) PRUEBAS GENERALES DE OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO. 					

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
MICROCENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO	BIOMEDICO	532220690002	MPW	MPW-215	10215039114
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE REPARACION DE INTERRUPTOR DE PUERTA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO. 3) EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 4) REVISIÓN Y LIMPIEZA PARA EVITAR FIBRINAS. 5) LIMPIEZA DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y TARJETA ELECTRÓNICA. 6) REVISIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, CONECTORES Y CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO. 7) VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DEL MECANISMO DE ACOPLÉ Y AJUSTE DEL ROTOR. 8) REVISIÓN DE APERTURA Y BLOQUEO DE TAPA (LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE BISAGRA). 9) LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES (RODAMIENTOS Y SISTEMAS MECÁNICOS). 10) REVISIÓN Y LIMPIEZA DE EMPAQUETADURA. 11) REVISIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL ROTOR DE LA CENTRIFUGA Y MOTOR. 12) REVISIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, CAMBIAR SI PRESENTA SIGNOS DE QUEMADURA. 13) REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL, SELECTORES DE VELOCIDAD, TIEMPO DE CENTRIFUGADO, ALARMAS Y LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN DE LA CENTRIFUGA. 14) CAMBIO DE FUSIBLES. 					



JOSE ROYER MARGAS SAMANIF
INGENIERO ELECTRONICO
D.E.S. CIP. 223147

*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
CONTADOR HEMATOLOGICO	BIOMEDICO	532223110003	GEMMY	DBC-8E	1408873
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE TARJETA PRINCIPAL, SE REINICIO SOLO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 2) REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INSPECCIÓN INTEGRAL DEL EQUIPO). 3) REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA (TECLADO, PERILLAS Y BOTONES, DISPLAY). 4) VERIFICACIÓN DE LA BATERÍA DEL EQUIPO. 5) LIMPIEZA DE LAS TARJETAS DEL EQUIPO. 6) OPERATIVIDAD DEL EQUIPO. 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
CENTRIFUGA PARA TUBOS	BIOMEDICO	532220490006	HETTICH	206	0025595-03
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE REPARACION DE INTERRUPTOR DE PUERTA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO. 3) EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 4) REVISIÓN Y LIMPIEZA PARA EVITAR FIBRINAS. 5) LIMPIEZA DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y TARJETA ELECTRÓNICA. 6) REVISIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, CONECTORES Y CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO. 7) VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DEL MECANISMO DE ACOPLA Y AJUSTE DEL ROTOR. 8) REVISIÓN DE APERTURA Y BLOQUEO DE TAPA (LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE BISAGRA). 9) LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES (RODAMIENTOS Y SISTEMAS MECÁNICOS). 10) REVISIÓN Y LIMPIEZA DE EMPAQUETADURA. 11) REVISIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL ROTOR DE LA CENTRIFUGA Y MOTOR. 12) REVISIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, CAMBIAR SI PRESENTA SIGNOS DE QUEMADURA. 13) REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL, SELECTORES DE VELOCIDAD, TIEMPO DE CENTRIFUGADO, ALARMAS Y LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN DE LA CENTRIFUGA. 14) CAMBIO DE FUSIBLES. 					



DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
MONITOR FETAL	BIOMEDICO	532281880010	EDAN		
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE CAMBIO DE TRANSDUCTOR. 2) REQUIERE PULSADOR Y MP. 3) INSPECCIÓN O REVISIÓN GLOBAL Y ESPECIFICAS DEL EQUIPO. 4) AJUSTES ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y/O MECÁNICOS. 5) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE LOS TRANSDUCTORES. 6) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD AL SISTEMA DE IMPRESIÓN, MANTTO DE CELDA TERM. 7) LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, ENGRASE. 8) PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 9) VERIFICACIÓN, Y REGULACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO. 					

JOSE PABLO VARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
CIP. 223147

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
ANALIZADOR BIOQUIMICO	BIOMEDICO	532202400014	EMPEROR	EMP-168	610008117
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE CAMBIO DE LAMPARA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 2) EXAMINAR EL EXTERIOR DEL EQUIPO Y EVALUAR SU CONDICIÓN FÍSICA GENERAL. 3) VERIFICAR LA LIMPIEZA DE LAS CUBIERTAS Y EL AJUSTE DE LAS MISMAS. 4) PROBAR EL CABLE DE CONEXIÓN Y SU SISTEMA DE ACOPLES. 5) COMPROBAR QUE SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES Y QUE ESTÁN LIMPIOS. 6) EXAMINAR LOS CONTROLES DEL EQUIPO. 7) VERIFICAR QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y QUE SE PUEDEN ACCIONAR SIN DIFICULTAD. 8) VERIFICAR EL ESTADO DE BRAZO PORTA ELECTRODO. 9) REVISAR LAS BATERÍAS SI APLICA, CAMBIAR SI ES NECESARIO. 10) EFECTUAR UNA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO MIDIENDO UNA SOLUCIÓN CONOCIDA. 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
PULSOXIMETRO	BIOMEDICO	532288390103	CE	M0300C23	201965306311
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) LECTURA INCORRECTA, TAJETA AVERIADA Y MP. 2) DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 3) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 4) LIMPIEZA DE ACCESORIOS Y VERIFICACIÓN DE CONTACTOS. 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
CUNA DE CALOR RADIANTE	MOBILIARIO	532227630003	FANEM	MULTISYSTEM	FAJ-11927
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE SENSOR DE TEMPERATURA (REF092.059.600) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO - VERIFICACIÓN DEL EQUIPO. 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO Y LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES INTERNAS, EXTERNA Y CÚPULA. 3) LIMPIEZA DE LOS COMPONENTES INTERNOS. 4) LIMPIEZA Y REVISIÓN DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS (LIMPIA CONTACTOS DE RESIDUO CERO). 5) LUBRICACIÓN DEL VENTILADOR DEL MÓDULO DE CALEFACCIÓN. 6) LIMPIEZA DE RUEDAS Y FRENOS DE LA BASE. 7) VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS PARTES MECÁNICAS. 8) REEMPLAZO DE 01 SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL. 9) MONTAJE DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERACIÓN, Y FUNCIONAMIENTO DENTRO DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS. 					



JOSE LUIS VARGAS SAMAME
SERVIDOR ELECTRONICO
Nº O. CIP. 223147

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
COMPRESORA DE AIRE	ELECTROMECHANICO	532222870005	AIR DENT		2013-10012
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 2) DESMONTAJE INTEGRAL E INSPECCIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO. 3) VERIFICACIÓN Y CAMBIO DEL PRESOSTATO. 4) REVISION DE CONEXIONES INTERNAS. 5) AJUSTES DE LAS CONEXIONES Y LIMPIEZA DE LOS CONTACTOS. 6) VERIFICACION Y MANTENIMIENTO DEL ESTADO DEL MOTOR (CAMBIO DE FAJA SI LO REQUIERE). 7) ARMADO DEL EQUIPO. 8) VERIFICACION DE PARÁMETROS DE DESEMPEÑO. 9) PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA Y FUNCIONAMIENTO. 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
ECOGRAFO	BIOMEDICO	532250000012	UNITD-IMAGING	IVSTAR160	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) PROBLEMAS CON EL SOFTWARE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 2) INSPECCIÓN MECÁNICA EXTERNA DEL EQUIPO, MANTENIMIENTO AL PANEL DE CONTROL 3) MANTENIMIENTO A TARJETAS ELECTRÓNICAS DE PROCESAMIENTO, CONTROL, ALIMENTACIÓN. 4) EVALUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRANSDUCTOR E IMPRESORA. 5) LIMPIEZA DEL EQUIPO. 6) PRUEBA DEL EQUIPO. 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
DETECTOR DE LATIDOS FETALES DOOPLER	BIOMEDICO	532250000019	EDAN	SONOTRAX	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE TRANSDUCTOR. 2) REQUIERE BATERIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 3) APERTURA Y LIMPIEZA INTEGRAL DEL EQUIPO. 4) MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE TRANSDUCTOR. 5) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA. 					



JOSE ROYER VARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
F.M.E.G. CIP: 223147

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
REFRIGERADORA DOMESTICA	BIOMEDICO	112263860057	INRESA		
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE CALIBRACION DE TEMPERATURA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 2) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO. 3) DESMONTAJE DEL EQUIPO. 4) REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 5) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 6) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES. 7) LIJADO Y PINTADO DE PARTES OXIDADAS. 8) SUMINISTRO Y LLENADO DE GAS REFRIGERANTE 404A O SEGÚN FABRICANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 9) VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y FUGA DE GAS REFRIGERANTE. 10) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA. 					

ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-2 LA BERMEJA

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
EQUIPO NEBULIZADOR ELECTROCO PORTATIL	BIOMEDICO	532255710094	INALAMAX	N5	OCP 0016
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE CONECTOR DE SALIDA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 2) VERIFICACIÓN INTEGRAL DEL EQUIPO. 3) DESMONTAJE DEL EQUIPO, REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 5) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES. 6) LUBRICACIÓN DE RODAJES DEL MOTOR. 7) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES. 					



DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	532266650066	EKF	3000-0031-6801	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE CALIBRACION, REQUIERE BATERIA INTERNA. 2) INSPECCIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO. 3) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 					

JOSE ROYER VARGAS SAMAN...
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

- 4) REVISIÓN DEL SISTEMA DE ELÉCTRICO Y AJUSTE DE PIEZAS.
- 5) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO.
- 6) CAMBIO DE BATERÍAS CUANDO LO REQUIERA.
- 7) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD.

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	BIOMEDICO	602206520027	SECA	354	5.70013E+12
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO VERIFICACIÓN DE PESOS CON PESAS PATRONES: 1KG, 2 KG, 5 KG. 2) AJUSTE DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS SEGÚN MANUAL DE FABRICANTE. 3) REPARACIÓN Y AJUSTE DEL MECANISMO DE CONTRAPESO. 4) ALINEAMIENTO DEL BRAZO VASCULANTE PINTADO DE LA ESTRUCTURA METALICA. 5) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA BASE INTERIOR 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
TENSIOMETRO	BIOMEDICO	602287620735	RIESTER	1350	
TENSIOMETRO	BIOMEDICO	602287620900	RIESTER	1350	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) VALVULA OBSTRUIDA, MANGA DETERIODADA Y MP. 2) DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 3) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 4) LIMPIEZA DE ACCESORIOS Y VERIFICACIÓN MDE CONTACTOS 					

ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-1 GUAYABAL

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
OXIMETRO DE PULSOS PORTATIL ADULTO	BIOMEDICO	532288390062	EDAN	H100B	360101-M18A06
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) TARJETA PRINCIPAL AVERIADA, BATERIA AVERIADA. 2) SE VA A USAR MEDIDOR DE PARÁMETRO DE SATURACIÓN DE OXÍGENO. 3) INSPECCIÓN O REVISIÓN GLOBAL Y ESPECIFICAS DEL EQUIPO. 4) AJUSTES ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y/O MECÁNICOS. 5) VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA Y SISTEMA INDICADOR DE SPO2 Y FC. 6) PRUEBAS Y VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE SPO2. 7) LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, ENGRASE. 8) PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 9) VERIFICACIÓN Y REGULACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO. 					



JOSÉ ROYER VARGAS SAMARIE
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
EQUIPO NEBULIZADOR	BIOMEDICO	532255710066	THOMAS	1147-230VC	41400001659
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REEMPLAZO DE REGULADOR DE PRESION. 2) REEMPLAZO DE FILTRO AIRE. 3) REEMPLAZO DE SALIDA PACIENTE(PIN) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 4) VERIFICACIÓN INTEGRAL DEL EQUIPO. 5) DESMONTAJE DEL EQUIPO. 6) REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 7) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 8) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES. 9) LUBRICACIÓN DE RODAJES DEL MOTOR. 10) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES. 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTATIL	BIOMEDICO	532230960112	EDAN	SD5	M17A5610060
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) TARJETA PRINCIPAL AVERIADA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 2) APERTURA Y LIMPIEZA INTEGRAL DEL EQUIPO. 3) MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE TRANSDUCTOR. 4) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
BALANZA	BIOMEDICO	602208560227	GUERSA	B6	
BALANZA	BIOMEDICO	602206520023	SECA		
BALANZA	BIOMEDICO	602206520275	GREEDMED		
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 2) DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 3) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 4) LIMPIEZA DE ACCESORIOS Y VERIFICACIÓN DE CONTACTOS. 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650176	EKF		
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE CALIBRACION. 2) INSPECCIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO. 					



JOSE ROYPER VARGAS SAMARIE
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

- 3) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO.
- 4) REVISIÓN DEL SISTEMA DE ELÉCTRICO Y AJUSTE DE PIEZAS.
- 5) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO.
- 6) CAMBIO DE BATERÍAS CUANDO LO REQUIERA.
- 7) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD.

ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-1 CHARAPE

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650064	EKF DIAGNOSTIC	300-0810-6801	300-10-3664
HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650177	EKF DIAGNOSTIC	3040-0010-0218	3040-20-0360
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE CALIBRACION. 2) INSPECCIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO. 3) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 4) REVISIÓN DEL SISTEMA DE ELÉCTRICO Y AJUSTE DE PIEZAS. 5) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO. 6) CAMBIO DE BATERÍAS CUANDO LO REQUIERA. 7) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD. 					



JOSE ROYER VARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-3 LA COIPA

EQUIPOS MÉDICOS CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
MICROSCOPIO TRINOCULAR	BIOMEDICO	532278560075	EUROMEX	BSCOPE	1960326
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO 2) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE OCULARES CON PAPEL LENTE 3) INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE OBJETIVOS CON EL USO DE PAPEL LENTE 4) REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL CONDENSADOR 5) LIMPIEZA DE PLATINA 6) REVISIÓN Y PRUEBA DE AJUSTE MACROMÉTRICO Y MICROMÉTRICO 7) REVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN 8) REVISIÓN Y PRUEBA DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN 9) LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO PORTATIL	BIOMEDICO	532250000015	SAMSUNG MEDISON	SONOACER3	SOSMM3HK900013K
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) INSPECCIÓN MECÁNICA EXTERNA DEL EQUIPO, MANTENIMIENTO AL PANEL DE CONTROL 2) MANTENIMIENTO A TARJETAS ELECTRÓNICAS DE PROCESAMIENTO, CONTROL, ALIMENTACIÓN. 3) EVALUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRANSDUCTOR E IMPRESORA. 4) LIMPIEZA DEL EQUIPO. 5) PRUEBA DEL EQUIPO. 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
CAMILLA METALICA PARA EXAMEN GINECOLOGICO	MOBILIARIO	536427150181	SIN MARCA		
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 2) INSPECCIONAR CONDICIONES FÍSICAS DEL MOBILIARIO. 3) REVISIÓN DE CONTROL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO. 4) VERIFICAR EL ESTADO DE LA COLCHONERA. 					



JOSE ROYER VARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REC. CIP. 223147

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
UNIDAD DENTAL ELECTRICA COMPLETA	BIOMEDICO	532298200022	WOODPECKER	OLF750	407

ACTIVIDADES:

- 1) EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA.
- 2) VERIFICAR ESTADO DE MANGUERAS Y EMPAQUES EN EL SISTEMA HIDRÁULICO Y NEUMÁTICO.
- 3) VERIFICAR FUGAS DE JERINGA TRIPLE EN BOTONERAS.
- 4) VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE (EYECTOR Y ESCUPIDERA) Y EFECTUAR LIMPIEZA.
- 5) EFECTUAR LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE JERINGA TRIPLE.
- 6) LUBRICAR Y LIMPIAR PIEZA DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD (MICROMOTOR).
- 7) VERIFICAR LA PRESIÓN DE JERINGA TRIPLE.
- 8) VERIFICAR FUNCIONAMIENTO Y LUBRICAR VÁLVULA PILOTO.
- 9) VERIFICAR PRESIÓN DE SALIDA DE PIEZA DE MANO.
- 10) REVISIÓN Y AJUSTE DE MOVIMIENTOS: SILLÓN: ESPALDAR, BRAZOS.
- 11) REVISIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN.
- 12) VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
ROTADOR SEROLOGICO	BIOMEDICO	532293140011	DIGESYSTEM	DSR-2800D-N	1

ACTIVIDADES:

- 1) DESMONTAJE DEL EQUIPO, REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO.
- 2) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS.
- 3) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES.
- 4) AJUSTE Y VERIFICACIÓN DE EJE DE MOTOR.
- 5) LIMPIEZA DE CÁMARA DE ROTOR.
- 6) CALIBRACIÓN DE RPM CON TACÓMETRO.
- 7) VERIFICACIÓN DE TIEMPO DE PROGRAMACIÓN.

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
CONTADOR DIGITAL HEMATOLOGICO DE CELULAS	BIOMEDICO	532223110007	GEMMY		

ACTIVIDADES:

- 1) REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INSPECCIÓN INTEGRAL DEL EQUIPO)
- 2) REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA (TECLADO, PERILLAS Y BOTONES, DISPLAY)
- 3) VERIFICACIÓN DE LA BATERÍA DEL EQUIPO.
- 4) LIMPIEZA DE LAS TARJETAS DEL EQUIPO.
- 5) OPERATIVIDAD DEL EQUIPO.



JOSE ROYFERRARDO SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
CAMILLA METALICA PARA EXAMEN GINECOLOGICO	MOBILIARIO	536450000015	S&S MEDICAL		
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 2) INSPECCIONAR CONDICIONES FÍSICAS DEL MOBILIARIO. 3) REVISIÓN DE CONTROL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO. 4) VERIFICAR EL ESTADO DE LA COLCHONERA. 					

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
ANALIZADOR BIOQUIMICO	BIOMEDICO	602239530005	EMP	EMP-168	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE REEMPLAZO DE LAMPARA, REQUIERE RESISTENCIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 2) EXAMINAR EL EXTERIOR DEL EQUIPO Y EVALUAR SU CONDICIÓN FÍSICA GENERAL. 3) VERIFICAR LA LIMPIEZA DE LAS CUBIERTAS Y EL AJUSTE DE LAS MISMAS. 4) PROBAR EL CABLE DE CONEXIÓN Y SU SISTEMA DE ACOPLES. 5) COMPROBAR QUE SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES Y QUE ESTÁN LIMPIOS. 6) EXAMINAR LOS CONTROLES DEL EQUIPO. 7) VERIFICAR QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y QUE SE PUEDEN ACCIONAR SIN DIFICULTAD. 8) VERIFICAR EL ESTADO DE BRAZO PORTA ELECTRODO. 9) REVISAR LAS BATERÍAS SI APLICA; CAMBIAR SI ES NECESARIO. 10) EFECTUAR UNA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO MIDIENDO UNA SOLUCIÓN CONOCIDA. 					



DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650146	EKF DIAGNOSTIC	3040-19-0218	240
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) ERROR DE LECTURA, REQUIERE CALIBRACIÓN. 2) INSPECCIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO. 3) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 4) REVISIÓN DEL SISTEMA DE ELÉCTRICO Y AJUSTE DE PIEZAS. 5) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO. 6) CAMBIO DE BATERÍAS CUANDO LO REQUIERA. 7) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD. 					

JOSE ROYER VARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-1 LA LIMA DE LA COIPA

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	532266650040	EKF-DIAGNOSTIC	3000-00316801	3000-10-3667
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE BATERIA, REQUIERE CALIBRACION. 2) NSPECCIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO. 3) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 4) REVISIÓN DEL SISTEMA DE ELÉCTRICO Y AJUSTE DE PIEZAS. 5) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO. 6) CAMBIO DE BATERÍAS CUANDO LO REQUIERA. 7) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD. 					

ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-1 LLANO GRANDE

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
ESTERILIZADOR DE CALOR SECO 35-40L	BIOMEDICO	532260470081	JP SELECTA	DIGITEHEAT	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) TARJETA PRINCIPAL AVERIADA, TECLADO NO RESPONDE. 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO, REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 3) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES. 5) LIMPIEZA DE LA CÁMARA INTERNA. 6) SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE PUERTA 7) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA CON TERMÓMETRO EXTERNO. 8) PRUEBA CON TIRAS INDICADORA DE ESTERILIZACIÓN. 					



JOSE LUIS VARGAS SAMAME
FOTOCOPIADO ELECTRONICO
CIP. 223147

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	BIOMEDICO	602206520247	GREETMED	GT131-200	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO VERIFICACIÓN DE PESOS CON PESAS 2) PATRONES: 1KG, 2 KG, 5 KG. 3) AJUSTE DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS SEGÚN MANUAL DE FABRICANTE. REPARACIÓN Y AJUSTE DEL MECANISMO DE CONTRAPESO. 4) ALINEAMIENTO DEL BRAZO VASCULANTE PINTADO DE LA ESTRUCTURA METALICA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA BASE INTERIOR 					

ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-1 PACAYPITE

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
CAMILLA	MOBILIARIO	536427150015			
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE PINTADO, PIERNERA AVERIADA Y REQUIERE RETIRAR MUEBLE DE PIES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 2) INSPECCIONAR CONDICIONES FÍSICAS DEL MOBILIARIO. 3) REVISIÓN DE CONTROL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO 4) VERIFICAR EL ESTADO DE LA COLCHONERA. 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
LAMPARA INCANDESCENTE	BIOMEDICO	532271820059			
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE LAMPARA, REQUIERE INTERRUPTOR, REQUIERE PINTURA Y MP. 2) INSPECCIÓN MECÁNICA DE LA LÁMPARA. 3) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LA LÁMPARA. 4) REVISIÓN DEL SISTEMA DE ELÉCTRICO Y AJUSTE DE PIEZAS. 5) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO. 6) PINTADO EN LAS ÁREAS QUE LO REQUIERAN. 7) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD. 					

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650159	EKF DIAGNOSTIC	3000-0031-6801	3000-10-3679
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) LECTURA INCORRECTA, REQUIERE CALIBRACION. 2) INSPECCIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO. 3) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 4) REVISIÓN DEL SISTEMA DE ELÉCTRICO Y AJUSTE DE PIEZAS. 5) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO. 6) CAMBIO DE BATERÍAS CUANDO LO REQUIERA. 7) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD. 					



DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
BALANZA DE PIE 150 KG CON TALLIMETRO	BIOMEDICO	602206520213	SECA	803	8803060192228
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO VERIFICACIÓN DE PESOS CON PESAS PATRONES: 1KG, 2 KG, 5 KG. 					

JOSE ROYER VARGAS SATHIAJIF
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

- 2) AJUSTE DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS SEGÚN MANUAL DE FABRICANTE.
- 3) REPARACIÓN Y AJUSTE DEL MECANISMO DE CONTRAPESO.
- 4) ALINEAMIENTO DEL BRAZO VASCULANTE.
- 5) PINTADO DE LA ESTRUCTURA METALICA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA BASE INTERIOR.

ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-1 HUACORA

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
NEBULIZADOR	BIOMEDICO	532255710102	THOMAS		
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE REGULACION DE PRESION. 2) REQUIERE FILTRO DE ENTRADA DE AIRE. 3) REQUIERE MANOMETRO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 4) VERIFICACIÓN INTEGRAL DEL EQUIPO. 5) DESMONTAJE DEL EQUIPO, REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 6) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 7) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES. 8) LUBRICACIÓN DE RODAJES DEL MOTOR. 9) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES. 					



DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
GLUCOMETRO	BIOMEDICO	602246040173	ACCU-CHEK		
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) TARJETA PRINCIPAL AVERIADA. 2) DESMONTAJE INTEGRAL E INSPECCIÓN DEL EQUIPO. 3) REALIZAR LA LIMPIEZA DEL EQUIPO. 4) VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS Y CONEXIONES INTERNAS. 5) LIMPIEZA DEL EQUIPO. 6) OPERATIVIDAD DEL EQUIPO. 					

JOSE ROFFER YARGAS SAMARIE
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-1 BUENOS AIRES

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
LAMPARA CUELLO DE GANZO	BIOMEDICO	462269370001	S/M		
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE LAMPARA. 2) REQUIERE NUEVA INSTALACION ELECTRICA Y MP. 					

- 3) INSPECCIÓN MECÁNICA DE LA LÁMPARA.
- 4) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LA LÁMPARA.
- 5) REVISIÓN DEL SISTEMA DE ELÉCTRICO Y AJUSTE DE PIEZAS.
- 6) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO.
- 7) PINTADO EN LAS ÁREAS QUE LO REQUIERAN.
- 8) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD.

ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-1 SAN FRANCISCO DE LA COIPA

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
ASPIRADORA DE SECRECIONES	BIOMEDICO	532208120018	THOMAS	MEDICAL	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) INSPECCIÓN VISUAL. 2) MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EQUIPO. 3) DESMONTAJE INTEGRAL DEL EQUIPO. 4) LIMPIEZA EL INTERIOR Y EXTERNA DEL CHASIS. 5) MANTENIMIENTO DE MOTOR (ENGRASADO DE RODAMIENTO Y BARNIZADO DEL ESTATOR). 6) LIMPIEZA DEL SISTEMA DE DIAFRAGMA Y VÁLVULA DEL COMPRESOR. 7) LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ENCENDIDO. Y APAGADO DEL EQUIPO. 8) MONTAJE INTEGRAL DEL EQUIPO. 9) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS BACTERIOLÓGICO Y CAMBIO DE MANGUERAS SILICONADAS. 10) VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 					

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
CONGELADORA	BIOMEDICO	112260390037	VESTFROST	MK114	
CONGELADORA	BIOMEDICO	112260390071	VESTFROST	MK144	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE REEMPLAZO DE BURLETE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 2) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO. 3) DESMONTAJE DEL EQUIPO, REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 5) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES. 6) LIJADO Y PINTADO DE PARTES OXIDADAS. 7) SUMINISTRO Y LLENADO DE GAS REFRIGERANTE 404A O SEGÚN FABRICANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 8) VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y FUGA DE GAS REFRIGERANTE. 9) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA. 					



JOSE PETER VARGAS SAMANIE
IDENTIFICADOR ELECTRONICO
F.E. 16. CIP. 223147

ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-1 VIRA VIRA

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
CONGELADORA	REFRIGERACIÓN	112260390046	VESTFROST	MF-114	20125161837

ACTIVIDADES:

- 1) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO.
- 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO, REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO.
- 3) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS.
- 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES.
- 5) LIJADO Y PINTADO DE PARTES OXIDADAS.
- 6) SUMINISTRO Y LLENADO DE GAS REFRIGERANTE 404A O SEGÚN FABRICANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
- 7) VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y FUGA DE GAS REFRIGERANTE.
- 8) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA.

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
REFRIGERADORA	BIOMEDICO	112260390125	VESTFROST	MKS240	20181404494

ACTIVIDADES:

- 1) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO.
- 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO, REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO.
- 3) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS.
- 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES.
- 5) LIJADO Y PINTADO DE PARTES OXIDADAS.
- 6) SUMINISTRO Y LLENADO DE GAS REFRIGERANTE 404A O SEGÚN FABRICANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
- 7) VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y FUGA DE GAS REFRIGERANTE.
- 8) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA.



JOSE RIVERA VARGAS SAMANIF
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650079	EKF DIAGNOSTIC	300-0031-6801	3000140952

ACTIVIDADES:

- 1) INSPECCIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO.
- 2) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO.
- 3) REVISIÓN DEL SISTEMA DE ELÉCTRICO Y AJUSTE DE PIEZAS.
- 4) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO.

- 5) CAMBIO DE BATERÍAS CUANDO LO REQUIERA.
- 6) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD.

ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-1 VISTA FLORIDA

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS 98 L	REFRIGERACIÓN	112260390045	VESTFROST	MF-114	20125161910
REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 75 L	BIOMEDICO	112260390101	VESTFROST	MK204	20144330295

ACTIVIDADES:

- 1) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO.
- 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO, REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO.
- 3) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS.
- 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES.
- 5) LIJADO Y PINTADO DE PARTES OXIDADAS.
- 6) SUMINISTRO Y LLENADO DE GAS REFRIGERANTE 404A O SEGÚN FABRICANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
- 7) VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y FUGA DE GAS REFRIGERANTE.
- 8) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA



DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
DETECTOR DE LATIDOS	BIOMEDICO	532230960148	EDAN	SONOTRAX	560042M20609170167

ACTIVIDADES:

- 1) APERTURA Y LIMPIEZA INTEGRAL DEL EQUIPO.
- 2) MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE TRANSDUCTOR.
- 3) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA

ROSE ROYER VARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
FRIGOBAR 80L	BIOMEDICO	112252140019	INDURAMA		

ACTIVIDADES:

- 1) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO.
- 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO, REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO.
- 3) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS.

- 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES.
- 5) LIJADO Y PINTADO DE PARTES OXIDADAS.
- 6) SUMINISTRO Y LLENADO DE GAS REFRIGERANTE 404A O SEGÚN FABRICANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
- 7) VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y FUGA DE GAS REFRIGERANTE.
- 8) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA.

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
HEMOGLÓBINOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	532266650115	EKF DIAGNOSTIC	3000-0031-6801	300-13-0332

ACTIVIDADES:

- 1) REQUIERE CALIBRACION, LECTURA DEFECTUOSA.
- 2) INSPECCIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO.
- 3) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO.
- 4) REVISIÓN DEL SISTEMA DE ELÉCTRICO Y AJUSTE DE PIEZAS.
- 5) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO.
- 6) CAMBIO DE BATERÍAS CUANDO LO REQUIERA.
- 7) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD.

ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-1 LOMA LARGA

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
CONGELADORA PARA VACUNAS	REFRIGERACIÓN	112260390019	VETFROST	MF314	
REFRIGERADORA PARA VACUNAS	BIOMEDICO	112260390090	VETFROST	MK144	

ACTIVIDADES:

- 1) VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO.
- 2) DESMONTAJE DEL EQUIPO, REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO.
- 3) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS.
- 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES.
- 5) LIJADO Y PINTADO DE PARTES OXIDADAS.
- 6) SUMINISTRO Y LLENADO DE GAS REFRIGERANTE 404A O SEGÚN FABRICANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
- 7) VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y FUGA DE GAS REFRIGERANTE.
- 8) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA.



JOSE ROYER VARGAS SAMAMIF
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-1 LA CAPILLA

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
ESTERILIZADOR DE CALOR SECO 35-40L	BIOMEDICO	532260470045	EFISA		
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE CAMBIO DE TERMOSTATO. 2) REQUIERE CAMBIO DE TIMER. 3) DESMONTAJE DEL EQUIPO, REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 4) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, CABLES DE CONEXIÓN, PANTALLA, SLOT DE CONEXIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 5) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLE PODER, PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES. 6) LIMPIEZA DE LA CÁMARA INTERNA. 7) SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE PUERTA. 8) VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA CON TERMÓMETRO EXTERNO. 9) PRUEBA CON TIRAS INDICADORA DE ESTERILIZACIÓN. 					

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650074	EKF		
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) LECTURA DEFECTUOSA, REQUIERE CALIBRACION. 2) INSPECCIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO. 3) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 4) REVISIÓN DEL SISTEMA DE ELÉCTRICO Y AJUSTE DE PIEZAS. 5) PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO. 6) CAMBIO DE BATERÍAS CUANDO LO REQUIERA. 7) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD. 					



JOSE ROYER YARGAS SAMAMIF
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
BALANZA DE PIE	BIOMEDICO	602206520241	GREETMED		
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none"> 1) REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 2) DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 3) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 4) LIMPIEZA DE ACCESORIOS Y VERIFICACIÓN DE CONTACTOS. 					

ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-1 TAMBOA

EQUIPO MÉDICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE
DETECTOR DE LATIDOS FETALES	BIOMEDICO	532230960033	EDAN	SONO TRAX BASIC	
ACTIVIDADES: 1) TRANSDUCTOR AVERIADO, TARJETA PRINCIPAL DEFECTUOSA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 2) APERTURA Y LIMPIEZA INTEGRAL DEL EQUIPO. 3) MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE TRANSDUCTOR. 4) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA.					

NOTA: EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR UNA VISITA AL LUGAR DEL SERVICIO PARA UNA MEJOR PRESENTACION DE SU COTIZACIÓN, ASIMISMO, DETALLAR LAS BONDADDES DE SU OFERTA.

5.3. PLAN DE TRABAJO / CRONOGRAMA

El Establecimiento de Salud, planteará un Plan de Trabajo y de cronograma de ejecución el cual será coordinado con la empresa contratista.

5.4. PLAN DE CONTINGENCIAS

El Establecimiento de Salud, planteará un Plan de Contingencias el cual será perfeccionado por la empresa contratista, pero será asumido por el Establecimiento de Salud (de ser necesario).

5.5. PROCEDIMIENTO

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES

El contratista deberá coordinar con el jefe de la Oficina de Servicios de Salud y Mantenimiento o quien haga sus veces, los aspectos necesarios para la adecuada prestación del servicio de mantenimiento.

El mantenimiento realizado por el contratista incluye una garantía mínima de 06 meses. Durante todo este tiempo de vigencia de garantía el contratista asumirá todos los costos por fallas originadas por el equipo.

SUPERVISIÓN DEL SERVICIO

La Oficina de Servicios de salud (Ingeniero electrónico) y jefe de IPRESS del EE.SS o quien haga sus veces es la responsable de supervisar la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo, verificando:

- El remplazo de repuestos de acuerdo a lo indicado en las actividades del servicio.
- La fecha de inicio y de culminación de la actividad de mantenimiento.



JOSE ROYER VARGAS SAMAHIF
INGENIERO ELECTRONICO
R.E.S. CIP. 223147

SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES

El contratista está obligado a cumplir la actividad de mantenimiento observadas como deficientes, caso contrario el jefe de la Oficina de Servicios de salud a través del especialista en ingeniería electrónica y jefe del EE.SS o quien haga sus veces no dará la conformidad correspondiente.

Así mismo, el jefe de la Oficina de Servicios de salud a través del especialista en ingeniería electrónica o quien haga sus veces, solicitará al contratista que cumpla, complemente o subsane la actividad de mantenimiento y/u Orden de Trabajo de Mantenimiento, si observa que:

- La mano de obra, recursos materiales y/o medios físicos del mantenimiento no se ajustan a las condiciones contratadas.
- El funcionamiento del equipo, en caso no sea el adecuado.

CONFORMIDAD

El jefe de la Oficina de Servicios de Salud y jefe del EE.SS o quien haga sus veces dará por concluida la intervención de mantenimiento si el servicio se ha desarrollado conforme los TDR y Orden de Servicio y además del informe emitido por el ingeniero especialista supervisor.

El jefe del EE.SS o quien haga sus veces, en coordinación con el área usuaria dará conformidad al informe de actividades de mantenimiento, teniendo en cuenta las sanciones contempladas dentro de la prestación del Servicio, emitiendo el informe de conformidad respectiva.

5.6. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

EQUIPAMIENTO MINIMO

EQUIPO	CANTIDAD
Sonómetro	01
Analizador de intensidad Luminosa (Luxómetro)	01
Termohigrómetro	01
Radiómetro	01
Anemómetro	01

- El contratista debe dotar a su personal técnico con maletines de herramientas, que permitan la ejecución oportuna del servicio de mantenimiento y sin causar daños parciales o totales a los equipos; asimismo debe dotar a su personal de equipos de protección personal (indicados en los manuales del fabricante), los cuales obligatoriamente deben ser usados durante la prestación del servicio, para evitar el contacto con agentes contaminantes que podrían afectar su integridad física.
- Los repuestos, componentes, partes y/o software, que instale el contratista en el equipo, deben contar con garantía durante la vigencia de la garantía por el servicio efectuado.
- Concluidas las actividades de mantenimiento, el contratista debe comunicar al jefe de la Oficina de Servicios de Salud y jefe del EE.SS o quien haga sus veces, cuáles fueron los repuestos, componentes, partes y/o software, antes reemplazados, los cuales



JOSE RIVERA VARGAS SAMANIF
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

deben figurar en el informe y entregados mediante un acta, para su resguardo correspondiente.

5.7. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD

El Establecimiento de Salud facilitará los ambientes e instalaciones en donde se encuentren los equipos que están incluidos dentro de los Término de Referencia, para su mantenimiento y realización de actividades correspondientes, además de:

- 5.7.1 Dar facilidades de acceso al área o - áreas a intervenir (de ser el caso).
- 5.7.2 Desocupar los ambientes durante el periodo de ejecución del servicio.
- 5.7.3 Contar con un ambiente de contingencia para reubicar el equipo y/o los equipos o repuestos que se retiren de los ambientes a intervenir.
- 5.7.4 Dar facilidades de ambiente para el almacenamiento de herramientas y materiales.
- 5.7.5 Dar facilidades de lugar para acopio de residuos o elementos desmontados.

5.8. REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS NACIONALES

Para la contratación del servicio de mantenimiento de los equipos y sus componentes, estos deben de cumplir con lo establecido en los siguientes documentos dependiendo del tipo de equipamiento y del nivel resolutivo del EE.SS.

- Listado de Normas Metroológicas Peruanas (NMP) aprobadas por la Dirección de Metrología del INACAL.
- DECRETO SUPREMO N° 009-97-EM: Reglamento de Seguridad Radiológica.
- IR.002.2012: Requisitos de Protección Radiológica y Seguridad en Medicina Nuclear – IPEN.
- El Equipo debe estar apto para obtener el Certificado de Control de Calidad exigido por la OTAN / IPEN.
- NTS N° 114-MINSA/2018/DIGESA: Gestión integral y manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo y centros de investigación.
- Proyecto de Ley de Desechos Radiactivos realizado por el Instituto Peruano de Energía Nuclear – IPEN
- Artículo 73° del Reglamento de la Ley N° 28028, Ley de Regulación del Uso de Fuentes de Radiación Ionizante.
- D.S. N° 011-2006-VIVIENDA, aprueba el R.N.E y sus Modificatorias con D.S. N° 010-2009-Vivienda, D.S. N° 011-2012-Vivienda, D.S. N° 017-2012-Vivienda. Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú (vigente) año 2006, A.050 RNE Norma de Salud.
- Código Nacional de Electricidad, aprobado mediante R.M. N° 037-20016-MEM, el 17.01.2006
- R.M. N° 045-2015/MINSA de fecha 27.01.2015, que aprueba la Norma Técnica de Salud NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V.01 "Infraestructura y Equipamiento de los establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención".
- R.M. N° 660-2014/MINSA de fecha 01.09.2014, que aprueba la Norma Técnica de Salud NTS N° 110-MINSA/DGIEM-V.01 "Infraestructura y Equipamiento de los establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atención".
- R.M. N° 862-2015/MINSA de fecha 29.12.2015, que aprueba la Norma Técnica de Salud NTS N° 119-MINSA/DGIEM-V.01 "Infraestructura y Equipamiento de los establecimientos de Salud del Tercer Nivel de Atención".



JOSE ROYER VARGAS SAMARIF
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

- R.M N° 533-2016/MINSA, que aprueba los “Lineamientos para la Elaboración del Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud”.
- Directiva Administrativa N° 08- DGIEM/MINSA, que regula la Identificación y Señalización de los establecimientos de salud, aprobada con R. M. N°015-2015 DGIEM, el 19.03.2015.
- Directiva Administrativa N° 211- DGIEM/MINSA, que regula el pintado Externo e Interno de EE.SS. en el ámbito del MINSA, aprobada con R. M. N° 832-2015/MINSA, el 23.12.2015.
- Guía Técnica para Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Agua para Sistemas de Vapor, aprobada con R.M. N° 939-2011/MINSA, el 22.12.2011.
- Guía Técnica para el Mantenimiento del Pozo de Puesta a Tierra en los Establecimientos de Salud, aprobada con R.M. N° 051-2015/MINSA, el 30.01.2015.
- Guía Técnica para el Mantenimiento Preventivo de Esterilizadores a Vapor, aprobada con R.M. N° 064-2015/MINSA, el 06.02.2015.
- Guía Técnica para el Mantenimiento Preventivo del Capnógrafo, aprobada con R.M. N° 504-2011/MINSA, el 04.07.2011.
- Guía Técnica para el Mantenimiento Preventivo de Equipo de Cirugía Laparoscópica de Uso General, aprobada con R.M. N° 505-2011/MINSA, el 04.07.2011.
- Guía Técnica para el Mantenimiento Preventivo de Equipo de Incubadora Neonatal Estándar, aprobada con R.M. N° 506-2011/MINSA, el 04.07.2011.
- Guía Técnica para el Mantenimiento Preventivo de Equipo de Electrocirugía, aprobada con R.M. N° 507-2011/MINSA, el 04.07.2011.
- Otras según se requiera especificar.

5.9. IMPACTO AMBIENTAL

El Establecimiento de Salud, planteará un listado de acciones a fin de mitigar los impactos ambientales.

5.10. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL (de ser necesaria para garantizar la continuidad del servicio efectuado).

La prestación principal es el servicio que se presta, ya sea este el mantenimiento preventivo o correctivo, el cual es establecido en los Términos de Referencia.

La prestación accesoria, es el servicio complementario a la prestación principal, y que se determina mediante actividades menores que garantizan la prestación principal. Esta prestación accesoria tiene una frecuencia que debe ser indicada en los términos de referencia y que se programara su pago de forma periódica luego de culminarse satisfactoriamente las actividades desarrolladas.

5.11. REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR Y DE SU PERSONAL

REQUISITOS DEL PROVEEDOR.

Deberá de ser una empresa inscrita en el Registro Nacional de Proveedores de la OSCE (Proveedor de Servicios), con experiencia en servicios de servicios de acondicionamiento y/o reparación y/o mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos biomédicos y/o electromecánicos en general, y/o acondicionamiento y/o reparación y/o mantenimiento y/o instalación de equipos de laboratorio, y/o acondicionamiento y/o reparación y/o mantenimiento de Sistemas eléctricos y/o plantas generadoras de Oxígeno y/o planta de oxígeno medicinal, en entidades públicas y privadas



JOSE ROYER VARGAS SAMANIF
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

PERFIL DEL PROVEEDOR.

Deberá encontrarse activo y habido, por lo que deberá adjuntar su FICHA RUC.
No deberá encontrarse impedido, sancionado, inhabilitado para contratar con el estado.
El contratista deberá acreditar como mínimo un monto facturado acumulado equivalente a S/ 800,000.00 (ocho cientos mil y 00/100 soles) en la actividad, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

PERFIL DEL PERSONAL

El contratista deberá acreditar al inicio del cumplimiento del contrato que su personal cuenta con seguro contra accidentes de trabajo (SCTR) y enfermedades profesionales. No se permitirá el ingreso a los Establecimientos de Salud, al personal del contratista que no cuente con el referido seguro y certificación, considerándose este hecho como inasistencia del personal, la misma que será de entera responsabilidad del contratista.

RESPONSABLE DEL SERVICIO – PERSONA CLAVE

El contratista designará un responsable del servicio, quién se hará cargo de coordinar la ejecución y cumplimiento del Mantenimiento, la elaboración del informe de ejecución del mantenimiento, la solución de las situaciones imprevistas que se presenten con el equipo de su cobertura.

CONDICIONES DE CONSORCIO.

El número máximo de consorciados es de tres (03). El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 20% de participación, el porcentaje mínimo de participación para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de superior al 20% de participación.

PERFIL DEL PERSONAL CLAVE RESPONSABLE DEL SERVICIO

a) Formación académica:

Personal	Cant.	Profesión admitida	Grado académico mínimo
Ingeniero responsable del servicio biomédico	1	Ingeniero electrónico o biomédico o mecatrónico	Ingeniero titulado, colegiado y habilitado
Ingeniero responsable del servicio electromecánico	1	Ingeniero mecánico o mecánico eléctrico o industrial	Ingeniero titulado, colegiado y habilitado
Técnico biomédico	1	Técnico electrónico o técnico mecatrónico o controlista de maquinarias o procesos industriales o electrónica industrial o bachiller en ingeniería electrónica o bachiller en ingeniería industrial o ingeniero	Título técnico a nombre de la nación y/o constancia de técnico y/o grado de bachiller o título según corresponda



JOSE ROYER VARGAS SAMANF
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

**"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"**

Técnico electromecánico	1	Técnico eléctrico o electricidad industrial o electromecánico o mecánico de mantenimiento o industrial o control de máquinas industriales o mecatrónico o bachiller eléctrico o bachiller eléctrico mecánico o bachiller industrial o ingeniero	Título técnico a nombre de la nación y/o constancia de técnico y/o grado de bachiller o título según corresponda
-------------------------	---	---	--

b) Capacitaciones:

El personal clave deberá acreditar capacitaciones en temas relacionados a: mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos biomédicos en general y/o tecnología hospitalaria y/o gestión de mantenimiento de equipos en general con una duración mínima de 80 horas lectivas.

Acreditación: se acreditará con copia simple de CERTIFICADO Y/O DIPLOMA, con no mayor a los 5 años de antigüedad contados a partir de la fecha de emisión.

c) Experiencia del personal

Personal	Cant.	Profesión admitida	Grado académico mínimo
Ingeniero responsable del servicio biomédico	1	Ingeniero electrónico o biomédico o mecatrónico	Deberá contar con experiencia de 12 meses en mantenimiento de equipamiento médico y/o residente y/o biomédico hospitalario y/o servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, reparación de equipos médicos y/o supervisión de mantenimiento de equipos, en entidades públicas o privadas.
Ingeniero responsable del servicio electromecánico	1	Ingeniero mecánico o mecánico eléctrico o industrial	Deberá contar con experiencia de 12 meses en mantenimiento de equipamiento electromecánico y/o residente y/o servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, reparación de equipos electromecánicos y/o supervisión de mantenimiento de equipos, en entidades públicas o privadas.
Técnico biomédico	2	Técnico mecatrónico o controlista de maquinarias o procesos industriales o electrónica industrial o bachiller en ingeniería	Deberá contar con experiencia de 12 meses en mantenimiento de equipamiento médico y/o técnico especialista y/o



ING. ROYER VARGAS SAMAME
INGENIERO ELECTRONICO
R.E.G. CIP. 223147

		electrónica o bachiller en ingeniería industrial o ingeniero electrónico o ingeniero industrial	biomédico hospitalario y/o servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, reparación de equipos médicos y/o supervisión de mantenimiento de equipos, en entidades públicas o privadas.
Técnico electromecánico	1	Técnico eléctrico o electricidad industrial o electromecánico o mecánico o mecánica de mantenimiento o industrial o control de máquinas industriales o técnico mecatrónico o bachiller eléctrico o bachiller eléctrico mecánico o bachiller industrial o ingeniero eléctrico o ingeniero mecánico eléctrico o ingeniero industrial	Deberá contar con experiencia de 12 meses en mantenimiento de equipamiento electromecánico y/o servicio y/o técnico y/o electromecánico hospitalario y/o servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, reparación de equipos electromecánicos y/o supervisión de mantenimiento de equipos electromecánicos, en entidades públicas o privadas.

5.12. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

LUGAR

El servicio se realizará en ambientes de los Establecimientos de salud de acuerdo a lo indicado en el cuadro de relación de equipos (lugar donde se realizará el mantenimiento).

PLAZO

En aplicación de lo dispuesto en Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el plazo del inicio del contrato u orden de servicio tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene o, en su caso, desde la recepción de la orden de servicio.

El plazo de ejecución del presente contrato es: 90 días calendarios.

5.13. RESULTADOS ESPERADOS

- Que el equipo y sus componentes se mantengan funcionalmente operativos durante todo el Periodo de Garantía.

5.14. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista está obligado a cumplir, entre las demás prestaciones establecidas en el contrato u orden de servicio, con la ejecución de las actividades de mantenimiento en su integridad y/o subsanar los Informes Técnicos y/o las OTM's observadas por deficiencias,



JOSE ROYTER VARGAS SAMARCA
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

***"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"***

caso contrario, el jefe de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento o quien haga sus veces del EE.SS. no otorgará la conformidad correspondiente.

RESPONSABILIDADES

- El contratista es responsable de los daños, pérdidas y/o sustracciones que sufriera el EE.SS. por acción, desconocimiento o negligencia de su personal, debiendo reparar los daños causados o reemplazar los bienes a satisfacción de la Entidad, si en el término de siete (07) días calendario, el contratista no realiza la reparación o reemplazo, el EE.SS. descostará automáticamente el valor de la reparación o reemplazo de los importes pendientes de cancelación. El valor de reparación o reemplazo del bien es el de vigencia en el mercado y es puesto en conocimiento del contratista.
- La reparación o reemplazo por sustracción, se cumple sin perjuicio de las acciones administrativas y/o legales que el caso obligue.
- El contratista es responsable directo del personal técnico designado para la prestación del servicio contratado, no existiendo ningún vínculo de dependencia laboral con el EE.SS.
- El contratista es responsable del pago oportuno de las remuneraciones de su personal técnico, así como de todos los importes, que por el pago de tales remuneraciones pudieran devengarse por conceptos de leyes, beneficios sociales, seguro social, indemnización por tiempo de servicios, tributos creados o por crearse, etc. Por tanto, el EE.SS. no será responsable por incumplimiento del contratista de las obligaciones antes indicadas ante su personal destacado, la misma que pudiera ser observado por el ente supervisor (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo) o de control según normas vigentes.
- Al EE.SS. no le corresponderá ninguna responsabilidad en caso de accidentes, daños, mutilaciones, invalidez o muerte de los trabajadores del contratista o terceras personas, que pudieran ocurrir como consecuencia de la ejecución del contrato.
- El contratista es responsable de dotar de los implementos de seguridad a su personal; al EE.SS. no le corresponderá ninguna responsabilidad en caso de accidentes, daños, mutilaciones, invalidez o muerte de los trabajadores del contratista o terceras personas, que pudieran ocurrir como consecuencia de la ejecución del contrato, con ocasión o como consecuencia del mismo.



PERSONAL DESTACADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

- El contratista presentará al jefe de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento del EE.SS. o quien haga sus veces, los **curricular documentados** del personal destacado a las instalaciones del EE.SS. para la ejecución del servicio contratado, dicha presentación deberá efectuarse como máximo al primer día calendario de suscrito el contrato o recepcionada la orden de servicio, constituyendo un requisito obligatorio para el inicio del servicio, caso contrario se considerará como una demora en el inicio del contrato y se procederá a la aplicación de la penalidad de acuerdo a lo establecido en la normativa de contrataciones.
- El contratista proporcionará, de su propio peculio, uniformes y fotocheck a su personal destacado en las instalaciones del EE.SS.
- El jefe de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento del EE.SS. o quien haga sus veces, podrá solicitar la sanción y/o cambio de personal, cuando éste demuestre negligencia y/o incapacidad en el cumplimiento de sus actividades.
- El CONTRATISTA no podrá efectuar cambio del personal sin previa autorización del jefe de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento del EE.SS. o quien haga sus veces.


JOSE ROYTER VARGAS SAMANIE
INGENIERO ELECTRONICO
N°E.G. CIP: 223147

HORARIOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo programado deberán ser ejecutadas dentro del horario regular establecido por el EE.SS. en coordinación con el responsable de mantenimiento y el jefe de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento o quien haga sus veces indicado en el presente TDR. Los horarios podrán ser modificados a requerimiento de EE.SS.

RECURSOS ECONÓMICOS / MATERIALES E INSUMOS

El contratista está obligado a suministrar los repuestos, materiales e insumos, los cuales deberán ser indicados en la OTM.

Los repuestos, materiales y/o insumos que suministre el contratista en el marco del contrato u orden de servicio, serán nuevos y sin uso.

SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DE MANTENIMIENTO

El contratista está obligado a subsanar las actividades de mantenimiento y/o las OTM's observadas por deficiencias, caso contrario el Ingeniero o encargado de mantenimiento del Establecimiento de Salud o jefe de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento o quien haga sus veces no dará la conformidad correspondiente, dando lugar a penalidad y de ser el caso a la resolución del contrato / orden de servicio.

Conforme lo establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista está obligado a subsanar las deficiencias identificadas en un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del equipo. Dicho plazo no puede ser menor de dos (02) ni mayor de diez (10) días calendarios, dicho plazo será definido y otorgado por escrito por el jefe de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento del EE. SS o quien haga sus veces.



5.15. SUBCONTRATACIÓN

El contratista no podrá realizar ningún tipo de subcontratación para las actividades indicadas en el presente Término de Referencia.

5.16. CONFIDENCIALIDAD

El contratista deberá mantener la confidencialidad y reserva absoluta de la información a la que tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha información a terceros.

JOSE ROYTER VARGAS SAMARIFE
INGENIERO ELECTRONICO
REG. CIP. 223147

5.17. MEDIDAS DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Durante la ejecución del servicio, el EE.SS. deberá tomar medidas de control de calidad que tienen por finalidad verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.

El jefe de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento o quien haga sus veces controlara el proceso de ejecución de las actividades de mantenimiento respectivo, verificando para ello como mínimo lo siguiente:

- a) El reemplazo y uso de repuestos, accesorios e insumos, de acuerdo a los presentes Términos de Referencia.
- b) La calidad de los materiales.
- c) Se establecerán pruebas y protocolos (ante posibilidades de falla que afecten a terceros).
- d) La fecha de inicio y de culminación de la actividad de mantenimiento.
- e) La información registrada en la Orden de Trabajo de Mantenimiento.

El jefe o encargado de mantenimiento del Establecimiento de Salud, solicitará al contratista cumpla, completamente o subsane, la actividad de mantenimiento y/u Orden de Trabajo de Mantenimiento, si observa que:

- a) EE.SS. no ha recibido los repuestos reemplazados.
- b) La mano de obra, recursos materiales y/o medios físicos del mantenimiento no se ajusta a las condiciones contratadas.
- c) El funcionamiento del servicio no es adecuado.
- d) La descripción descrita en la OTM no es completa, carece de cantidad o no se sujeta a la verdad.
- e) La OTM no está debidamente firmada por el jefe del área usuaria y/o el contratista responsable del mantenimiento.



5.18. FORMA DE PAGO / CONFORMIDAD

El contratista, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes al término de la orden de servicio de la prestación del servicio, presentará al jefe de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento del EE.SS o quien haga sus veces, el Informe de culminación de las actividades realizadas, conteniendo lo siguiente:

- a) Copia de la Orden de Servicio
- b) Los Informes Técnicos y las Órdenes de Trabajo de Mantenimiento (OTM) preventivas y correctivas ejecutadas. Las Órdenes de Trabajo de Mantenimiento deben estar concluidas y contar con todas las firmas de conformidad respectiva, así como también deben estar debidamente numeradas.
- c) Lista de repuestos, componentes, partes y/o softwares cambiados durante la ejecución del Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, al Equipo y a sus componentes, en el periodo correspondiente, con indicación obligatoria de la descripción del nombre (según manual del fabricante), número de parte, código, N° de Serie, para el equipo de alta tecnología al que corresponde, etc.
- d) Pruebas y Protocolos efectuados


JOSE VARGAS SAMARIF
CIP. 223147

e) Fotos (Antes, durante y después) de haberse efectuado el servicio.

Los informes deben ser entregados impresos y en medio magnéticos

El jefe de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento o quien haga sus veces, emite conformidad del Servicio mediante un Informe Técnico de Conformidad, de acuerdo a la normatividad interna del Establecimiento de salud; este Informe es el único documento que permite el pago del Servicio de mantenimiento y es elevado a la Oficina de Logística y/o Adquisiciones del EE.SS. En el informe técnico se especificará los días de incumplimiento (de ser el caso) y las ampliaciones de plazo, de ser necesario debidamente sustentado, otorgados por el área correspondiente.

5.19. FÓRMULA DE APLICACIÓN DE PENALIDADES

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, en concordancia con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que debió ejecutarse, estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contratado vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a las siguientes fórmulas:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 * \text{monto}}{F * \text{Plazo en días}}$$

Donde F tendrá los siguientes valores:

- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, F= 0.40.
- Para plazos mayores a sesenta (60) días, F= 0.25.

5.20. OTRAS PENALIDADES APLICABLES

Las penalidades serán aplicadas de acuerdo a lo establecido en Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La entidad podrá aplicar al contratista una penalidad por cada día de atraso en la prestación del servicio, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contratado vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, o si fuera necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento o por el monto diferencial de propuesta.

5.21. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El plazo máximo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado, será de un (01) año contando a partir de la conformidad otorgada.



JOSE ROYER VARGAS SAMANIEGO
AGENTE ELECTRONICO
REG. CIP. 223147