

ORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1. DATOS GENERALES

1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	01/09/2023
1.2 ÁREA USUARIA	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DEL BANCO NACIONAL DE TUMORES
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO TRINOCULAR CON CAMARA – BANCO NACIONAL DE TUMORES
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0046 GESTION ADMINISTRATIVA
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	82
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código - Documento que declaró la viabilidad -

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE COMPRA N° 3701-2023 // PEDIDO DE SERVICIO N° 2119 y 3038-2023		Fecha de recepción	23/03/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	27/04/2023	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la tercera versión	31/08/2023	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						



Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	-	-	-	1	Memo N° 756-2023-UF-ADQ-OL-OGA/INEN	19/04/2023

Evaluar las siguientes observaciones:

Observación N° 01

Característica: Condensador tipo ABBE con NA (número de apertura) 1.25
Se solicita: **Ampliar rango de NA para observación con objetivo de 2X.**

1	7	-	-	-	7	Informe N° 2899-2023-UF-ADQ-OL-OGA/INEN	26/07/2023
---	---	---	---	---	---	---	------------

Evaluar las siguientes observaciones:

Observación N° 01

El material del estativo depende de cada fabricante, lo importante es que sea metálico y estable. La altura ajustable de los mandos de enfoque es una especificativa exclusiva de la marca Leica y nadie más la cumple. La precisión del enfoque manual de 1 um es imposible de regular, es sólo marketing. Un desplazamiento de pasos de 4 um proporciona un ajuste fino
Aceptar: estativo metálico con mandos de niveles macro y micrométricos coaxiales de altura FIJA ESTABLE, pasos de 4 micras.

Observación N° 02

El campo de hasta 25 mm es exclusivo de solamente una marca (Leica) y restringe la participación de otras ofertas, no brindando ninguna ventaja práctica respecto a otros sistemas de 23 mm por ejemplo
Aceptar: Campos de hasta 23 mm

Observación N° 03

El revestimiento de la platina depende de cada fabricante, siendo igualmente resistente a rasguños y sustancias químicas. El mando a ambos lados es una especificativa exclusiva de la marca Leica restringiendo la participación de otras ofertas. Cambiar el mando de izquierda a derecha es engorroso y polidroso para el equipo pues puede caerse, golpearse o se pueden perder piezas pequeñas como pernos.

Aceptar: platina portaobjetos mecánica de revestimiento ANODIZADO para 2 láminas, resistente a rasguños y sustancias químicas. Mandos de enfoque macro y micrométrico a la derecha o a la izquierda, sin cremallera

Observación N° 04

Esta especificativa es exclusiva de la marca LEICA y restringe la participación de otras ofertas. Sugerimos cambiarla o retirarla

Aceptar: Mando telescópico de platina de manejo intercambiable o FIJO A LA DERECHA

Observación N° 05

No se entiende a qué se refieren con "estación". Tal vez quieren decir para caja objetivo

Aceptar: Excelente color y balance de intensidad de luz para cada objetivo

Observación N° 06

La orientación es relativa porque puede modificarse de forma digital con el software. La mayoría de marcas ofrecen indistintamente la orientación real o invertida lo cual no afecta la observación en absoluto

Aceptar: orientación de imagen real o invertida

Observación N° 07

La ubicación de la fuente de poder depende de cada fabricante, es una cuestión de diseño

Aceptar: Sistema de iluminación LED. Co fuente de poder externa o interna 90-250V



2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	-	-	-	1	Informe N° 059-2023-UF-GBNT-DP-DISAD/INEN	27/04/2023



Según especificaciones técnicas en su 2da Versión							
1	7	-	-	-	7	Informe N° 174-2023-UF- GBNT-DP- DISAD/NEN	31/08/2023
Según especificaciones técnicas en su 3ra Versión							

2.1	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
0	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento					
		Según especificación técnicas en su 3ra Versión					

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	04/04/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	01/09/2023
-----	---	------------	--	------------

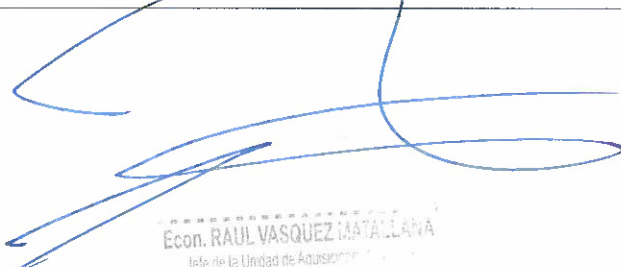
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	HW KESSEL S.A.C. y BAIRE S.A.C.			

3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	LEICA y CARL ZEISS			

3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.				

3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	<ul style="list-style-type: none"> Precio Plazo de Entrega 				

3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.				

4	 <p>Econ. RAUL VASQUEZ MATA LLANA Jefe de la Unidad de Adquisición Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas</p>				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

