

**ACTA**  
**ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 060-2023-HEVES-MINSA**  
**PRIMERA CONVOCATORIA**

**REQUERIMIENTO ANUAL DE PAPEL CREPADO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR**

En el distrito de Villa El Salvador, siendo las 8:30 horas del día 08 de marzo de 2024, se reúnen en la sala de reunión de la Unidad de Logística, del Hospital de Emergencias Villa El Salvador, los miembros del comité de selección para efectos de dar cumplimiento a la evaluación y calificación de las ofertas.

Que, con fecha 14 de enero de 2024, según cronograma publicado en la Ficha del Procedimiento de Selección en el SEACE, terminó el Registro de Participantes (Electrónica), según el siguiente detalle:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	Proveedor con RUC	20122963714	IMPLANTES EXTERNOS PERUANOS S.A.C.	21/12/2023	Válido
2	Proveedor con RUC	20393025868	CORPORACION DISE EIRL	22/12/2023	Válido
3	Proveedor con RUC	20501549801	FERCO MEDICAL S.A.C.	21/12/2023	Válido
4	Proveedor con RUC	20504905137	MEDICAL FULL IMPORT S.A.	09/01/2024	Válido
5	Proveedor con RUC	20535632287	MASUFI S.A.C.	10/01/2024	Válido
6	Proveedor con RUC	20546950396	GRUPO D Y S S.R.L.	21/12/2023	Válido
7	Proveedor con RUC	20547614900	T & R DISTRIBUIDORES S.A.C.	11/01/2024	Válido
8	Proveedor con RUC	20547969783	PROCESAMIENTO ECOLÓGICO SAC - PROECOLO SAC	02/01/2024	Válido
9	Proveedor con RUC	20555143487	CORPORACION ABANTO ´S S.A.C. DIVISION LABORATORIO	22/12/2023	Válido
10	Proveedor con RUC	20600420063	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DESCARTABLES S.A.C.	03/01/2024	Válido

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
11	Proveedor con RUC	20600754069	IMPORT MEDISA S.A.C.	10/01/2024	Válido
12	Proveedor con RUC	20601785324	STBIOMEDICAL S.A.C.	29/12/2023	Válido
13	Proveedor con RUC	20607779695	CHAPOMEDIC S.A.C.	27/12/2023	Válido
14	Proveedor con RUC	20608450123	DADOS PROVEEDORES E.I.R.L.	05/01/2024	Válido
15	Proveedor con RUC	20610225595	DISTRIBUIDORA INFARLAB S.A.C.	05/01/2024	Válido

15 registros encontrados, mostrando 5 registro(s), de 11 a 15. Página 2 / 2.

Que, con fecha 15 de enero de 2024, según cronograma publicado en la Ficha del Procedimiento de Selección en el SEACE, se llevó a cabo el acto de Presentación de ofertas (Electrónica), contando con la presentación de las siguientes ofertas y su respectivo detalle:

#### PAPEL CREPADO.

Nro. ítem	Descripción del ítem			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	PAPEL CREPADO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA			
20122963714	IMPLANTES EXTERNOS PERUANOS S.A.C.	15/01/2024	11:17:14	Electronico
20501549801	FERCO MEDICAL S.A.C.	15/01/2024	18:43:34	Electronico
20546950396	GRUPO D Y S S.R.L.	15/01/2024	19:01:15	Electronico
20535632287	CONSORCIO HEVES	15/01/2024	21:16:51	Electronico
20600420063	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DESCARTABLES S.A.C.	15/01/2024	23:29:08	Electronico

Fuente: Registro del SEACE.

En ese sentido, las ofertas mencionadas se consideran presentadas, el Comité de Selección verificó que éstas deban encontrarse debidamente foliadas correlativamente empezando por el número uno y debidamente visadas en cada una de sus hojas.

*[Handwritten signature]*



## Documentos para la admisión de la oferta

El Comité de Selección, procedió a determinar, si las ofertas presentadas cumplen con presentar la documentación requerida en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las bases del procedimiento de selección conforme lo señalado en el artículo 52° del Reglamento, así como si estas responden a las características y condiciones de los Especificaciones Técnicas establecidos en las bases conforme lo señala en el artículo 73° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; con lo que a continuación se procede a la evaluación de la documentación para la admisión de la oferta:

De acuerdo al **Acta de Evaluación de Muestras** realizado por el Órgano encargado para Evaluación de Muestra del ítem, el cual concluyó en lo siguiente:

N°	ÍTEM	EVALUACIÓN				
		CONSORCIO HEVES	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DESCARTABLES S.A.C.	FERCO MEDICAL S.A.C.	GRUPO D Y S S.R.L.	IMPLANTES EXTERNOS PERUANOS S.A.C.
01	PAPEL CREPADO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	APTO	NO APTO	NO APTO	NO APTO	APTO

Por tanto, el Comité de selección toma conocimiento del **Acta de Evaluación de Muestras suscrito debidamente por el Órgano encargado** para Evaluación de Muestra del *ítem N°1*, el cual hace suyo en todos sus extremos y se adjunta al presente acta; con lo que a continuación se procede a la evaluación de la documentación para la admisión de la oferta:

N°	POSTOR	a) DJ de datos del postor. (Anexo N 1)	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta...	c) DJ de acuerdo al literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N 2)	d) DJ de cumplimiento de las EETT... (Anexo N 3)	e) Copia del Protocolo o Certificado de Análisis	f) Copia de Certificado vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)	g) Declaración jurada de plazo de entrega (Anexo N°04)	h) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso... (Anexo N° 05)	i) El precio de la oferta en SOLES... (Anexo N° 06)	ESTADO
		Cumple / No cumple	Cumple / No cumple	Cumple / No cumple	Cumple / No cumple	Cumple / No cumple	Cumple / No cumple	Cumple / No cumple	Cumple / No cumple	Cumple / No cumple	ADMITIDA / NO ADMITIDA
1	CONSORCIO HEVES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDA <sup>1</sup>
2	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DESCARTABLES S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA <sup>2</sup>
3	FERCO MEDICAL S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA <sup>3</sup>
4	GRUPO D Y S S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA <sup>4</sup>
5	IMPLANTES EXTERNOS PERUANOS S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	ADMITIDA



<sup>1</sup>Es preciso señalar que, la oferta del CONSORCIO HEVES es NO ADMITIDA, dado que no presentó en su oferta lo solicitado en el inciso f) de los documentos obligatorios para la admisión de la oferta de las bases integradas, el cual solicita “Copia de Certificado vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)...”, de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones técnicas, no presentó el Contrato de la prestación de almacenamiento de acuerdo a los CBPA N° 131-2023, CBPA N° 485-2022 presentados en los Folios 60 y 61 de su oferta, lo cual no es subsanable por ser documento emitido por una entidad privada, y no corresponde a documentos emitidos por una entidad pública según lo señalado en el artículo 60 del Reglamento.

<sup>2</sup>Es preciso señalar que, la oferta de la empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DESCARTABLES S.A.C. es NO ADMITIDA, dado que mediante ACTA DE EVALUACIÓN DE MUESTRAS de fecha 23.01.2024, el representante de Central de Esterilización y la Unidad de Farmacia, luego de evaluar las muestras llegan a la conclusión de que la empresa en mención no cumple con la característica de las Especificaciones Técnicas, puesto que no presenta repelencia al agua en seco ya que se moja al tener contacto. Se verificó que no cuenta con resistencia a tracción ya que no cuenta con la porosidad adecuada de tal forma que disminuye la fuerza tensil de papel.

<sup>3</sup>Es preciso señalar que la oferta de la empresa FERCO MEDICAL S.A.C. es NO ADMITIDA, dado que mediante ACTA DE EVALUACIÓN DE MUESTRAS de fecha 23.01.2024, el representante de Central de Esterilización y la Unidad de Farmacia, luego de evaluar las muestras llegan a la conclusión de que la empresa en mención no cumple con la característica de las Especificaciones Técnicas, puesto que no cuenta con la resistencia mecánica adecuada. Se verifico que los poros tardan en dilatarse y disminuye la fuerza tensil del papel.

<sup>4</sup>Es preciso señalar que la oferta de la empresa GRUPO DyS S.R.L. es NO ADMITIDA, dado que mediante ACTA DE EVALUACIÓN DE MUESTRAS de fecha 23.01.2024, el representante de Central de Esterilización y la Unidad de Farmacia, luego de evaluar las muestras llegan a la conclusión de que la empresa en mención no cumple con la característica de las Especificaciones Técnicas, puesto que no presenta repelencia al agua en seco ya que se moja al tener contacto. Se verificó que no cuenta con resistencia a tracción ya que no cuenta con la porosidad adecuada de tal forma disminuye la fuerza tensil del papel.

**FACTORES DE EVALUACION:**

A continuación, se indica que el postor ADMITIDO pasa a la etapa de evaluación, al haber cumplido con acreditar fehaciente y objetivamente el cumplimiento de los documentos solicitados en el numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la Sección Específica de las bases del procedimiento de selección, procediendo a determinar el puntaje de las ofertas presentadas, según los factores de evaluación enunciados en el capítulo IV de las bases, conforme el siguiente detalle:

N°	POSTOR	FACTORES DE EVALUACION	PUNTAJE (100 PUNTOS)	BONIFICACIÓN 5%	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
		OFERTA ECONOMICA				
1	IMPLANTES EXTERNOS PERUANOS S.A.C.	S/ 92,480.00	100.00	5.00	105.00	1°

En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 75° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 75.1 Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

## REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

Luego de culminada la evaluación, el Comité de Selección determinó si el postor que obtuvo el primer lugar, según orden de prelación, cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:

En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 75° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, numeral 75.2. Si alguno de los dos (02) postores no cumple con los requisitos de calificación, el Comité de Selección verifica los requisitos de calificación de los postores admitido, según orden de prelación obtenido en la evaluación, hasta identificar dos (02) postores que cumplan con los requisitos de calificación; salvo que de la revisión de las ofertas, solo se pueda identificar una (01) que cumple con tales requisitos.

Postor: IMPLANTES EXTERNOS PERUANOS S.A.C.	DETALLE	
	CUMPLE	NO CUMPLE
REQUISITOS DE CALIFICACION		
CAPACIDAD LEGAL	X	
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X	
SITUACION	CALIFICADO	

En ese sentido, habiéndose verificado al postor que obtuvo el primer lugar, y este se encuentra CALIFICADO, corresponde otorgar la buena pro, al postor según orden de prelación.

## ACUERDO TOMADO POR UNANIMIDAD:

Concluidas las etapas de admisión, evaluación y calificación de acuerdo a los resultados obtenidos, el comité acuerda por UNANIMIDAD, lo siguiente:  
Se tomaron los siguientes acuerdos:

- Otorgar la Buena Pro del ítem 01 del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 060-2023-HEVES-MINSA – Primera convocatoria, correspondiente al REQUERIMIENTO ANUAL DE PAPEL CREPADO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR VADOR, al postor que ocupa el 1° lugar y que resultó calificado de la siguiente manera:

POSTOR	MONTO ADJUDICADO (S/)
IMPLANTES EXTERNOS PERUANOS S.A.C.	S/ 92,480.00

- Publicar este resultado en el sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, conforme a lo señalado en el reglamento de la ley de Contrataciones del Estado.

Siendo las 11:00 horas del mismo día y en señal de conformidad el Comité de Selección, suscribe la presente acta:

  
CARMEN ROSARIO SALVADOR VASQUEZ  
PRIMER MIEMBRO.

  
PATRICIA GUILIANA MERCADO TORRES  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN.

  
JOSÉ LUIS ANDRADE BABILONIA.  
SEGUNDO MIEMBRO.



## ACTA DE EVALUACIÓN DE MUESTRAS

Siendo las 12:00 horas del día 23/01/2023 en los ambientes del Servicio de Enfermería, se reúne al Órgano encargado para Evaluación de Muestras del procedimiento de selección EVALUACION DE MUESTRA — AS-60-2023-HEVES-MINSA-1 correspondiente a la ADQUISICION DE PAPEL CREPADO PARA EL HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR — HEVES, el cual es representado por:

1. Lic. Patricia Mercado - Representante del Central de Esterilización
2. Q.F. Carmen Salvador Vásquez- Representante de la Unidad de Farmacia

Finalidad

Comprobar el cumplimiento del Decreto Supremo N° 016-2011-SA para todos los ítems y sus modificatorias y condiciones mínimas de los envases, rotulados y seguridad.

ÍTEM PAQUETE	SUB ÍTEMs	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	1.1	PAPEL CREPADO 50 cm X 50 cm X 500	10
	1.2	PAPEL CREPADO 75 cm X 75 cm (CORTADO)	10
	1.3	PAPEL CREPADO 90 cm X 90 cm X 250	10
	1.4	PAPEL CREPADO 1.20 m X 1.20 m X 125	10

Aspectos a verificar

Cumplimiento a las especificaciones técnicas

Cumplimiento de la normatividad vigente (Decreto Supremo N° 016-2011-SA y sus modificatorias. Funcionalidad, capacidad y ergonomía en concordancia con la documentación presentada en la oferta. Condiciones mínimas de los envases, rotulados y seguridad del envase.

## Metodología:

POR CADA SUB ÍTEM	EETT	PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN	METODOLOGIA	IMPLANTES EXTERNOS PERUANOS S.A.C. RUC: 20122963714									
				SUB ÍTEM 1.1		SUB ÍTEM 1.2		SUB ÍTEM 1.3		SUB ÍTEM 1.4			
				SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE		
PAPEL CREPADO	1. Alta repelencia al agua en seco.	Se verificará la prueba de repelencia, se pondrá en prueba las muestras, luego se procederá a verter agua, finalmente se verificará el tiempo de repelencia con un máximo de 15 segundos.	Verificación visual y táctil.	x		x		x		x			
	2. Alta resistencia a tracción.	Se revisará la textura de la muestra, a fin de evaluar que sea flexible a la manipulación y no se rompa.	Verificación visual y táctil.	x		x		x		x			
	3. Compatible para los procesos de esterilización a vapor saturado.	Se evalúa la muestra llevando al proceso de esterilización a vapor saturado, en el cual se utilizará para empaquetar un instrumental quirúrgico, en el área de preparación y empaque de la Central de Esterilización (área azul), del cual se debe obtener un instrumental estéril.	Verificación visual y táctil.	x		x		x		x			

POR CADA SUB ÍTEM	EETT	PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN	METODOLOGIA	GRUPO DYS S.R.L RUC: 2060122462							
				SUB ÍTEM 1.1		SUB ÍTEM 1.2		SUB ÍTEM 1.3		SUB ÍTEM 1.4	
				SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
PAPEL CREPADO	1. Alta repelencia al agua en seco.	Se verificará la prueba de repelencia, se pondrá en prueba las muestras, luego se procederá a verter agua, finalmente se verificará el tiempo de repelencia con un máximo de 15 segundos.	Verificación visual y táctil.		x		x		x		x
	2. Alta resistencia a tracción.	Se revisará la textura de la muestra, a fin de evaluar que sea flexible a la manipulación y no se rompa.	Verificación visual y táctil.		x		x		x		x
	3. Compatible para los procesos de esterilización a vapor saturado.	Se evalúa la muestra llevando al proceso de esterilización a vapor saturado, en el cual se utilizará para empaquetar un instrumental quirúrgico, en el área de preparación y empaque de la Central de Esterilización (área azul), del cual se debe obtener un instrumental estéril.	Verificación visual y táctil.	x		x		x		x	



POR CADA SUB ÍTEM	EETT	PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN	METODOLOGIA	CONSORCIO HEVES RUC: 20535632287							
				SUB ÍTEM 1.1		SUB ÍTEM 1.2		SUB ÍTEM 1.3		SUB ÍTEM 1.4	
				SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
PAPEL CREPADO	1. Alta repelencia al agua en seco.	Se verificará la prueba de repelencia, se pondrá en prueba las muestras, luego se procederá a verter agua, finalmente se verificará el tiempo de repelencia con un máximo de 15 segundos.	Verificación visual y táctil.	x		x		x		x	
	2. Alta resistencia a tracción.	Se revisará la textura de la muestra, a fin de evaluar que sea flexible a la manipulación y no se rompa.	Verificación visual y táctil.	x		x		x		x	
	3. Compatible para los procesos de esterilización a vapor saturado.	Se evalúa la muestra llevando al proceso de esterilización a vapor saturado, en el cual se utilizará para empaquetar un instrumental quirúrgico, en el área de preparación y empaque de la Central de Esterilización (área azul), del cual se debe obtener un instrumental estéril.	Verificación visual y táctil.	x		x		x		x	

8



PERÚ

Ministerio  
de SaludHospital de Emergencias  
Villa El Salvador

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y  
de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

POR CADA SUB ÍTEM	EETT	PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN	METODOLOGIA	FERCO MEDICAL RUC: 20501549801							
				SUB ÍTEM 1.1		SUB ÍTEM 1.2		SUB ÍTEM 1.3		SUB ÍTEM 1.4	
				SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
PAPEL CREPADO	1. Alta repelencia al agua en seco.	Se verificará la prueba de repelencia, se pondrá en prueba las muestras, luego se procederá a verter agua, finalmente se verificará el tiempo de repelencia con un máximo de 15 segundos.	Verificación visual y táctil.		x		x		x		x
	2. Alta resistencia a tracción.	Se revisará la textura de la muestra, a fin de evaluar que sea flexible a la manipulación y no se rompa.	Verificación visual y táctil.	x		x		x		x	
	3. Compatible para los procesos de esterilización a vapor saturado.	Se evalúa la muestra llevando al proceso de esterilización a vapor saturado, en el cual se utilizará para empaquetar un instrumental quirúrgico, en el área de preparación y empaque de la Central de Esterilización (área azul), del cual se debe obtener un instrumental estéril.	Verificación visual y táctil.	x		x		x		x	

POR CADA SUB ÍTEM	EETT	PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN	METODOLOGIA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTORS DESCARTABLES S.A.C. RUC: 20600420063							
				SUB ÍTEM 1.1		SUB ÍTEM 1.2		SUB ÍTEM 1.3		SUB ÍTEM 1.4	
				SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
PAPEL CREPADO	1. Alta repelencia al agua en seco.	Se verificará la prueba de repelencia, se pondrá en prueba las muestras, luego se procederá a verter agua, finalmente se verificará el tiempo de repelencia con un máximo de 15 segundos.	Verificación visual y táctil.		X		X		X		X
	2. Alta resistencia a tracción.	Se revisará la textura de la muestra, a fin de evaluar que sea flexible a la manipulación y no se rompa.	Verificación visual y táctil.		X		X		X		X
	3. Compatible para los procesos de esterilización a vapor saturado.	Se evalúa la muestra llevando al proceso de esterilización a vapor saturado, en el cual se utilizará para empaquetar un instrumental quirúrgico, en el área de preparación y empaque de la Central de Esterilización (área azul), del cual se debe obtener un instrumental estéril.	Verificación visual y táctil.	X		X		X		X	





PERÚ

Ministerio  
de Salud

Hospital de Emergencias  
Villa El Salvador



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y  
de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

## ACUERDOS:

**IMPLANTES EXTERNOS PERUANOS:** Si cumple con la Característica de La EETT, tiene una excelente repelencia al agua en seco no traspasa el papel y con alta resistencia a tracción. Se verificó que compatible para los procesos de esterilización a vapor saturado.

**GRUPO DYS S.R.L.:** No cumple con la Característica de La EETT, no presenta repelencia al agua en seco ya que se moja al tener contacto, Se verificó que no cuenta con resistencia a tracción ya que no cuenta con la porosidad adecuada de tal forma disminuye la fuerza tensil del papel.

**CONSORCIO HEVES:** Si cumple con la Característica de La EETT, tiene una excelente repelencia al agua en seco no traspasa el papel y con alta resistencia a tracción. Se verificó que compatible para los procesos de esterilización a vapor saturado.

**FERCO MEDICAL:** No cumple con la Característica de La EETT, no cuenta con la resistencia mecánica adecuada, Se verificó que lo poros tardan el dilatarse y disminuye la fuerza tensil del papel.

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTORS DESCARTABLES S.A.C.:** No cumple con la Característica de La EETT, no presenta repelencia al agua en seco ya que se moja al tener contacto, Se verificó que no cuenta con resistencia a tracción ya que no cuenta con la porosidad adecuada de tal forma disminuye la fuerza tensil del papel.

Siendo las 12: 00 horas del mismo día y en señal de conformidad el Órgano encargado para Evaluación de Muestra del ítem, suscribe la presente acta:

Representante del Central de Esterilización

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR  
  
Lc. Patricia G. Mercado Torres  
Coordinadora en Enfermería - Central Esterilización  
G.E.P. 70029 / R.E.E. 21992

Representante de la Unidad de Farmacia

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR  
  
Cf. CARMEN ROSARIO SALVADOR VASQUEZ  
DIRECTOR TÉCNICO DE LA UNIDAD DE FARMACIA  
C.O.F.P. 17473





PERU

Ministerio  
de Salud

Hospita de Emergencias  
Villa El Salvador

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## IMPLANTES EXTERNOS PERUANOS

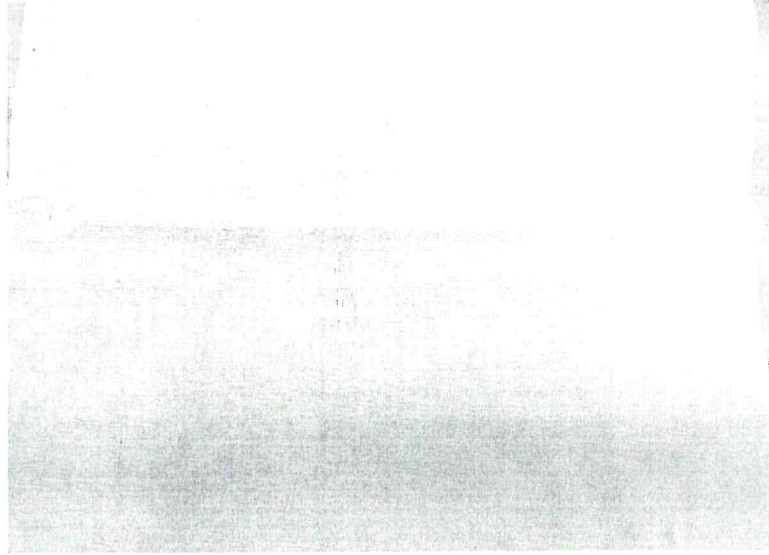

Av. 200 millas S/N cruce con Av.  
Pastor Sevilla - Villa El Salvador  
T: (01) 640-9875 Anexo: 2147



BICENTENARIO  
PERU  
2024






PERÚ

Ministerio  
de Salud

Hospital de Emergencias  
Villa El Salvador

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

GRUPO DYS S.R.L.:

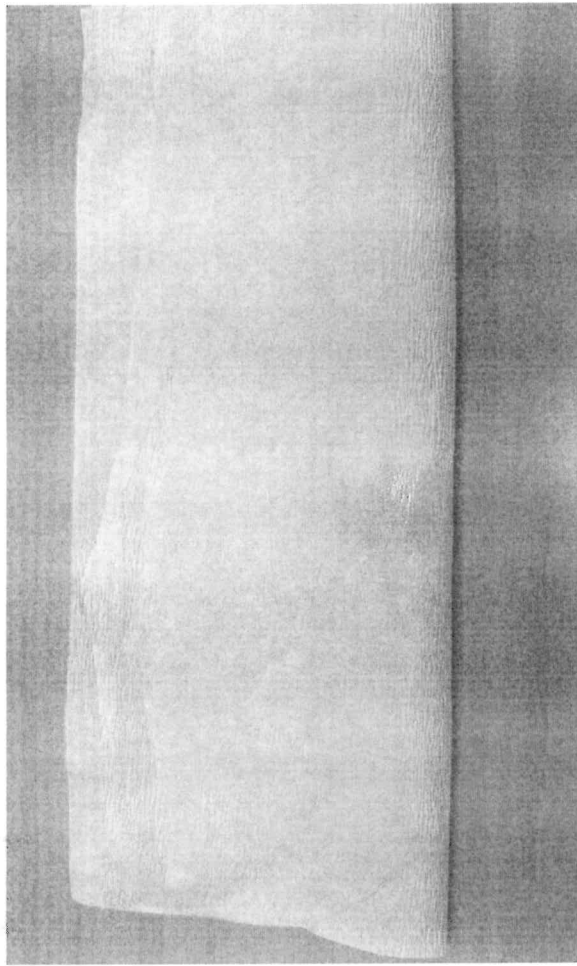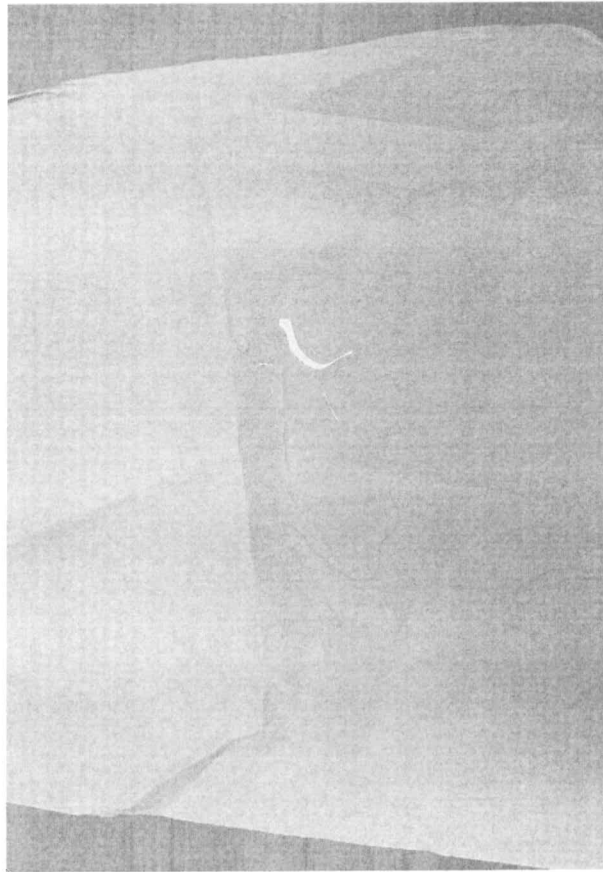


Av. 200 millas S/N cruce con Av.  
Pastor Sevilla - Villa El Salvador  
T: (01) 640-9875 Anexo: 2147





CONSORCIO HEVES:



Av. 200 millas S/N cruce con Av.  
Pastor Sevilla - Villa El Salvador  
T:(01)640-9875 Anexo: 2147








PERÚ

Ministerio  
de Salud

Hospital de Emergencias  
Villa El Salvador

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## FERCO MEDICAL:

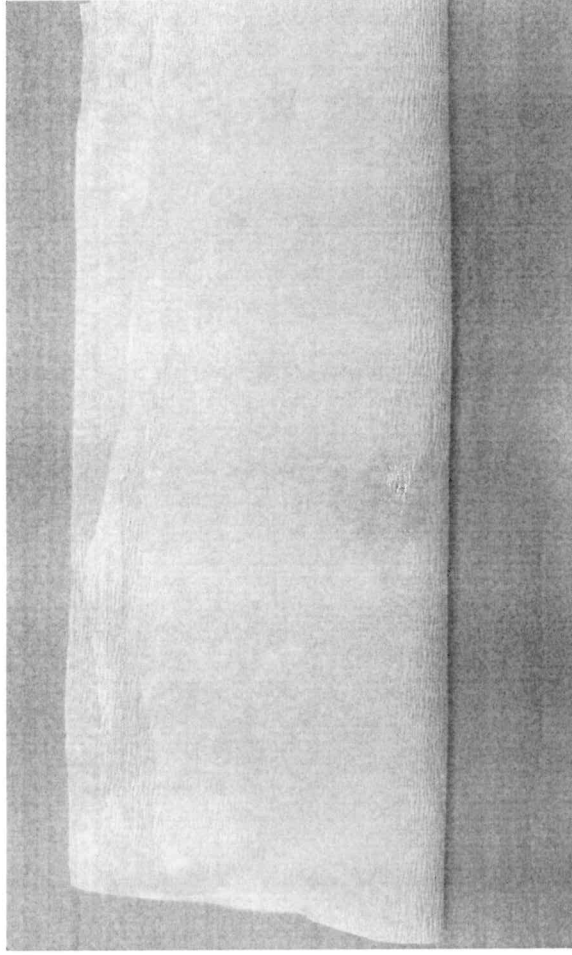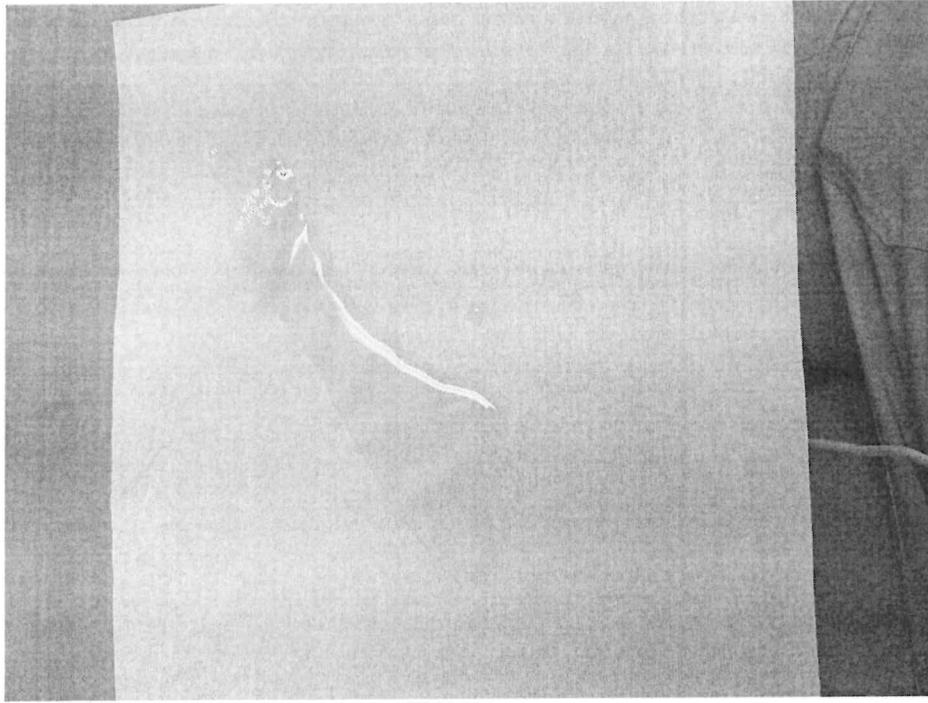

Av. 200 millas S/N cruce con Av.  
Pastor Sevilla - Villa El Salvador  
T:(01)640-9875 Anexo: 2147



BICENTENARIO  
PERÚ  
2024




PERÚ


Ministerio  
de Salud

Hospital de Emergencias  
Villa El Salvador


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTORS DESCARTABLES S.A.C.:

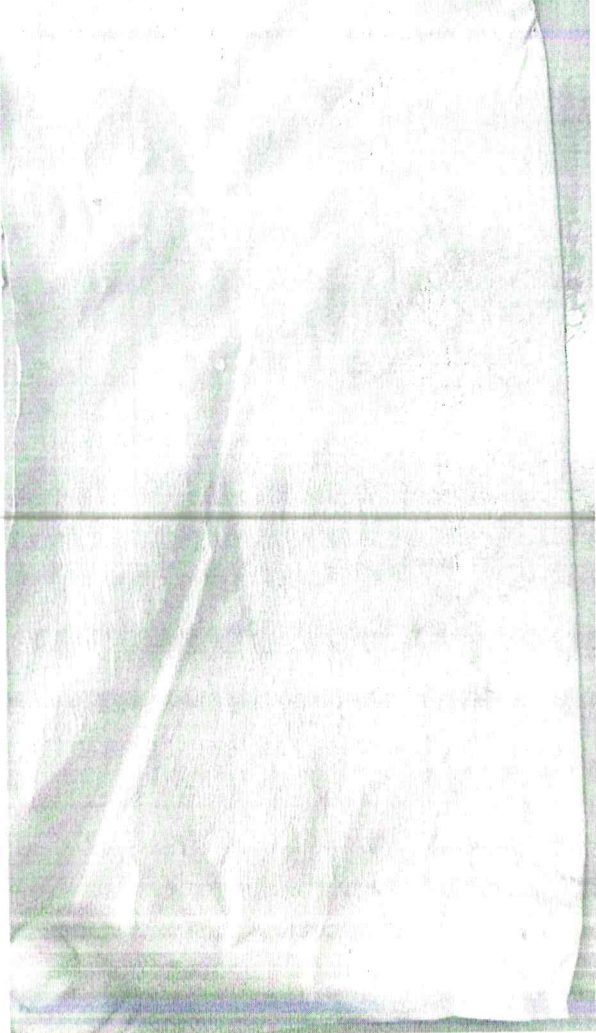

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Av. 200 millas S/N cruce con Av.  
Pastor Sevilla - Villa El Salvador  
T: (01) 640-9875 Anexo: 2147



BICENTENARIO  
PERÚ  
2024