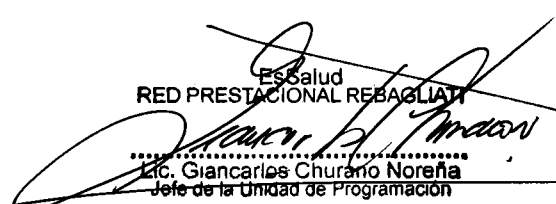
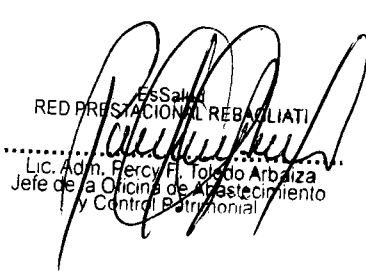


391

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14.07.2023					
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES - UNIDAD DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL MAMÓGRAFO DEL POLICLÍNICO PABLO BERMUDEZ DE LA RED PRESTACIONAL REBAGLIATI - RPR"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	BRINDAR A LOS ASEGURADOS ACCESO OPORTUNO A PRESTACIONES INTEGRALES Y DE CALIDAD ACORDE A SUS NECESIDADES					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	2215					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-				
		Documento que declaró la viabilidad	-				
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	NOTA N° 956 -OFIHySG-OFA-GRPR-ESSALUD-2023	Fecha de recepción	02.03.2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	21.03.2023	De oficio	-	Con motivo de observaciones	x
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	x
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI	X	NO	-		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>						
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	4	-	-	-	4	Correo electrónico	09.03.2023
<p>1.- Mencionan que en el mercado a los monitores de 23.8" le denominan de 24", por lo tanto, consultan si sería correcto solicitar Monitor LED o LCD tamaño 23.8" o Mayor.</p> <p>2.- Aclarar si la Estación de Lectura se refiere a Estación de Diagnóstico. Así mismo, refieren que no se está considerando las herramientas para el diagnóstico de imágenes mamográficas, para lo cual deben considerar un Mini PACS con software y herramientas necesarias.</p> <p>3.- Los componentes para esta estación lo están solicitando con marca, de acuerdo a Ley de Contrataciones solo se debe mencionar las especificaciones mínimas de cada uno.</p> <p>4.- Están solicitando un monitor de 30" o mayor con resolución de 8Mp o mayor, en este tipo de trabajo se requiere para poder manejar 2 imágenes, pero en este caso faltaría poder visualizar las imágenes, por lo que recomiendan usar 2 monitores de 5Mp cada uno (Total 10Mp) con tamaño de 21.2" (Total tamaño 42.4") o mayor.</p>							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	4	-	-	-	4	NOTA N° 1269-OFIHySG-OFA-GRPR-ESSALUD-2023	21.03.2023
1.- Se modifica la característica técnica B03 para aceptar monitores a partir de 23". 2.- En la Estación de lectura (literal C) se está incluyendo la característica: Software para adquisición y procesamiento de imágenes medicas de mamografía. 3.- En la Estación de lectura (literal C) se está omitiendo lo referente a la marca de la tarjeta de video. 4.- Se requiere que el monitor de la estación de lectura sea de al menos 30", por lo que, se mantiene la referida característica.							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	Modifican las características técnicas B03 por monitor de 23" o mayor.						
2	Se Incluye en la Estación de lectura (literal C) la característica: Software para adquisición y procesamiento de imágenes medicas de mamografía.						
3	En la Estación de lectura (literal C) se está omitiendo lo referente a la marca de la tarjeta de video.						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	08.03.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23.06.2023			
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
DIGITAL 'X' RAY S.A.C., TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A. y BLE SOLUCIONES S.A.C.							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X		
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.							
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.							
4	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">             RED PRESTACIONAL REBAGLIATI            .....            Lic. Giancarlo Churano Noreña            Jefe de la Unidad de Programación         </div> <div style="text-align: center;">             RED PRESTACIONAL REBAGLIATI            .....            Lic. Adm. Percy H. Toledo Arbaliza            Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial         </div> </div>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							