

## ACTA DE ADMISIBILIDAD DE OFERTAS

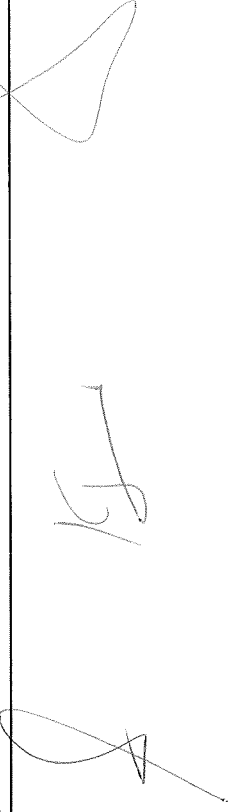
LICITACION PUBLICA N° 34-2024-ESSALUD/CEABE-1

"ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO CUNAS DE CALOR RADIANTE PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE INVERSION "CREACION DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGION PUNO - ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO" CON CODIGO UNICO DE INVERSION 2300016"

ADMISIÓN DE LA OFERTA												
N° de Ítem	Descripción del Ítem	Cant.	Nombre o Razón Social	Documentación de presentación obligatoria								Resultado (Admitida / No admitida)
				a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	e) Documentación adicional que sirva para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas  - Hoja de Presentación del Producto - Registro Sanitario o Certificado del Registro Sanitario - Certificado de Seguridad Eléctrica	f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N° 5)	h) El precio de la oferta en SOLES (Anexo N° 6)	
1	CUNA DE CALOR RADIANTE - SALA DE PARTO	2	ALBUJAR MEDICA S.A.C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA
			CPB MEDICAL S.A.C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (*)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDA
			DRAEGER PERU S.A.C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA
			J.C. MEDICAL SUPPLIES S.A.C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA
			MEDELCO S.R.L	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (*)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDA
2	CUNA DE CALOR RADIANTE - UCI NEONATAL	3	ALBUJAR MEDICA S.A.C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA
			CPB MEDICAL S.A.C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (*)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDA
			DRAEGER PERU S.A.C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA
			J.C. MEDICAL SUPPLIES S.A.C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA
			MEDELCO S.R.L	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (*)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDA

## ITEM 1:

(\*) LA EMPRESA CPB MEDICAL S.A.C NO ACREDITA EL PUNTO E01 (220 VAC/60 HZ (CON TOLERANCIA SEGÚN EL CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)) DE LA HOJA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO. EN LOS DOCUMENTOS DE ACREDITACION INDICA: 100 - 127V y 220 V - 240 V (NO ACREDITA LA TOLERANCIA ADMITIDA DE - 7.5% DE LA TENSION NOMINAL SEGÚN EL CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)




(\*) LA EMPRESA MEDELCO S.R.L. NO ACREDITA EL PUNTO E01 (220 VAC/60 HZ (CON TOLERANCIA SEGUN EL CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)) DE LA HOJA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO. EN LOS DOCUMENTOS DE ACREDITACION INDICA:  
INDICA: 127 / 220V (NO ACREDITA LA TOLERANCIA ADMITIDA DE + - 7.5% DE LA TENSION NOMINAL SEGUN EL CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)  
(\*) LA EMPRESA MEDELCO S.R.L. NO ACREDITA EL PUNTO B01 (UNA (01) UNIDAD DE RESUSCITACION Y/O REANIMACION (CON MEZCLADOR DE AIRE/O2 (BLENDER) Y MANOMETRO) INTEGRADOS EN EL EQUIPO Y), EN LOS DOCUMENTOS DE ACREDITACION SE EVIDENCIA: NO SUSTENTA QUE EL BLENDER, ESTE INTEGRADO EN EL EQUIPO; ADEMAS EL RESUSCITADOR SEGUN LA PAGINA DE AMVISA (AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA) REFERENTE AL RESUSCITADOR INFANTIL ES "INTEGRADO", MENCIONAL QUE EL EQUIPO "FACILITA LA ENTREGA DE PRESION".

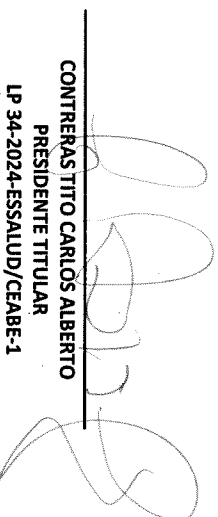
ITEM 2:

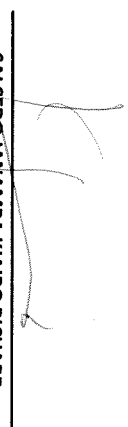
(\*) LA EMPRESA CPB MEDICAL S.A.C NO ACREDITA EL PUNTO E01 (220 VAC/60 HZ (CON TOLERANCIA SEGUN EL CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)) DE LA HOJA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO. EN LOS DOCUMENTOS DE ACREDITACION INDICA: 100 - 127V y 220 V - 240 V (NO ACREDITA LA TOLERANCIA ADMITIDA DE - 7.5% DE LA TENSION NOMINAL SEGUN EL CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD )

(\*) LA EMPRESA MEDELCO S.R.L. NO ACREDITA EL PUNTO E01 (220 VAC/60 HZ (CON TOLERANCIA SEGUN EL CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)) DE LA HOJA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO. EN LOS DOCUMENTOS DE ACREDITACION INDICA:  
INDICA: 127 / 220V (NO ACREDITA LA TOLERANCIA ADMITIDA DE + - 7.5% DE LA TENSION NOMINAL SEGUN EL CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)

(\*) LA EMPRESA MEDELCO S.R.L. NO ACREDITA EL PUNTO B01 (UNA (01) UNIDAD DE RESUSCITACION Y/O REANIMACION (CON MEZCLADOR DE AIRE/O2 (BLENDER) Y MANOMETRO) INTEGRADOS EN EL EQUIPO Y), EN LOS DOCUMENTOS DE ACREDITACION SE EVIDENCIA: NO SUSTENTA QUE EL BLENDER, ESTE INTEGRADO EN EL EQUIPO; ADEMAS EL RESUSCITADOR SEGUN LA PAGINA DE AMVISA (AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA) REFERENTE AL RESUSCITADOR INFANTIL ES "INTEGRADO", MENCIONAL QUE EL EQUIPO "FACILITA LA ENTREGA DE PRESION".

  
SILVA CARDENAS ROBER FERMIN  
PRIMER MIEMBRO TITULAR  
LP 34-2024-ESSALUD/CEABE-1

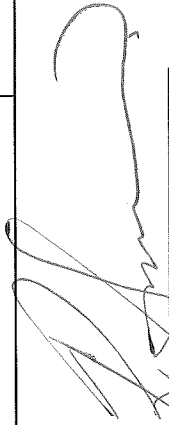
  
CONTRERAS TITO CARLOS ALBERTO  
PRESIDENTE TITULAR  
LP 34-2024-ESSALUD/CEABE-1

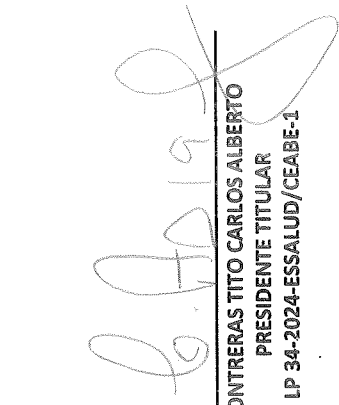
  
SALCEDO JANAMPA KJAURO RICHARD  
SEGUNDO MIEMBRO SUPLENTE  
LP 34-2024-ESSALUD/CEABE-1

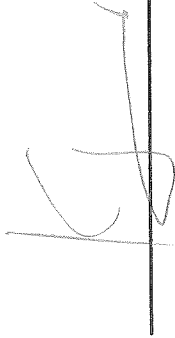
LICITACION PUBLICA N° 34-2024-ESSALUD/CEABE-1

“ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO CUNAS DE CALOR RADIANTE PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE INVERSION "CREACION DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGION PUNO - ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO" CON CODIGO UNICO DE INVERSION 2300016"

N° de ITEM	Descripción del ITEM	Cantidad	Orden de Prelación	Nombre de Razon Social	REQUISITOS DE CALIFICACION			ESTADO DE LA OFERTA
					CAPACIDAD LEGAL - HABILITACION (AUTORIZACION SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO)	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
1	CUNA DE CALOR RADIANTE - SALA DE PARTO	2	2	ALBUJAR MEDICA S.A.C	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA	
			3	DRAEGER PERU S.A.C	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA	
			1	J.C. MEDICAL SUPPLIES S.A.C	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA	
2	CUNA DE CALOR RADIANTE - UCI NEONATAL	3	1	ALBUJAR MEDICA S.A.C	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA	
			3	DRAEGER PERU S.A.C	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA	
			2	J.C. MEDICAL SUPPLIES S.A.C	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA	

  
SILVA CARDENAS ROBER FERMIN  
PRIMER MIEMBRO TITULAR  
LP 34-2024-ESSALUD/CEABE-1

  
CONTRERAS TITO CARLOS ALBERTO  
PRESIDENTE TITULAR  
LP 34-2024-ESSALUD/CEABE-1

  
SALCEDO JANAMPA KJAIRO RICHARD  
SEGUNDO MIEMBRO SUPLENTE

ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA N° 34-2024-ESSALUD/CEABE-1

"ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO CUNAS DE CALOR RADIANTE PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE INVERSION "CREACION DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGION PUNO - ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO" CON CODIGO UNICO DE INVERSION 2300016"

N° de ITEM	Descripción del ITEM	Cant.	Nombre de Razon Social	Valor Estimado (S/)	Precio Ofertado (S/)	Factores de Evaluación			Orden de Prelación
						Precio (Puntaje máx 100 puntos)	Bonificación MYPE (5%)	PUNTAJE TOTAL	
1	CUNA DE CALOR RADIANTE - SALA DE PARTO	2	ALBUJAR MEDICA S.A.C	S/ 240,000.00	S/ 149,200.00	99.73	4.99	104.72	2
			DRAEGER PERU S.A.C		S/ 174,252.96	85.39	0.00	85.39	3
			J.C. MEDICAL SUPPLIES S.A.C		S/ 148,800.00	100.00	5.00	105.00	1
2	CUNA DE CALOR RADIANTE - UCI NEONATAL	3	ALBUJAR MEDICA S.A.C	S/ 390,000.00	S/ 236,700.00	100.00	5.00	105.00	1
			DRAEGER PERU S.A.C		S/ 341,972.16	69.22	0.00	69.22	3
			J.C. MEDICAL SUPPLIES S.A.C		S/ 308,172.00	76.81	3.84	80.65	2

SILVA CARDENAS ROBER FERMIN  
PRIMER MIEMBRO TITULAR  
LP 34-2024-ESSALUD/CEABE-1

CONTRERAS TITO CARLOS ALBERTO  
PRESIDENTE TITULAR  
LP 34-2024-ESSALUD/CEABE-1

SALCEDO JANAMPA KJAIRO RICHARD  
SEGUNDO MIEMBRO SUPLENTE  
LP 34-2024-ESSALUD/CEABE-1