

**ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:
BIENES, SERVICIOS EN GENERAL Y OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PÚBLICO O PRIVADO)**

1	NÚMERO DE ACTA	001-2023-CS- AS-HOMOLOGACIÓN N° 40-2023-GERESA/LL
---	----------------	---

2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL	<p>En, la ciudad de trujillo, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre del año 2023, en el local de la GERESALL, a las 03:30 pm horas, se reunieron los integrantes del COMITE DE SELECCION designados mediante Formato N° 04-2023-GERESA/LL , encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de AS-HOMOLOGACIÓN N° 40-2023 GERESA/LL , cuyo objeto de convocatoria es "IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO (18) INCUBADORA NEONATAL AVANZADA PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD". ITEM 1 - IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO (18) INCUBADORA NEONATAL AVANZADA PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD</p>
---	------------------------------	--

3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)					
	El quorum necesario que exige la normativa de contratación del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
	Presidente	ECON. ANGEL DANIEL TEJADA NUÑEZ	Titular	X	Dependencia:	UTF-ABASTECIMIENTO
			Suplente			
	Primer Miembro	ING.OSCAR IVAN DIAZ ARANA	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION
			Suplente			
	Segundo Miembro	ING. DAVID LUNA GRANDEZ	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION
			Suplente			

4	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	
	De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:	
	Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado
	NOVAMED PERU S.A.C.	S/ 2,790,000.00

5	BASE LEGAL	<p>Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "Luego de la calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE".</p>
---	------------	---

6	ACUERDO ADOPTADO	<p>Los integrantes del COMITÉ DE SELECCION , por UNANIMIDAD, otorgan la buena pro al postor mencionado en el numeral 4.</p>
---	------------------	---

7	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Econ. Angel Daniel Tejada Nuñez Presidente Titular </div> <div style="text-align: center;">  ING.OSCAR IVAN DIAZ ARANA Primer Miembro </div> <div style="text-align: center;">  ING. DAVID LUNA GRANDEZ Segundo Miembro </div> </div>	<p style="text-align: center;">NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS</p>
---	---	--

**ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:
BIENES, SERVICIOS EN GENERAL Y OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PÚBLICO O PRIVADO)**

1	NÚMERO DE ACTA	001-2023-CS- AS-HOMOLOGACIÓN N° 40-2023-GERESA/LL
---	----------------	---

2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL
En, la ciudad de trujillo, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre del año 2023, en el local de la GERESALL, a las 03:30 pm horas, se reunieron los integrantes del COMITE DE SELECCION designados mediante Formato N° 04-2023-GERESA/LL , encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de AS-HOMOLOGACIÓN N° 40-2023 GERESA/LL , cuyo objeto de convocatoria es "IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO (18) INCUBADORA NEONATAL AVANZADA PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD". ITEM 2 IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE UNA (01) INCUBADORA NEONATAL DE TRANSPORTE PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	

3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)					
	El quorum necesario que exige la normativa de contratación del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
	Presidente	ECON. ANGEL DANIEL TEJADA NUÑEZ	Titular	X	Dependencia:	UTF-ABASTECIMIENTO
			Suplente			
	Primer Miembro	ING.OSCAR IVAN DIAZ ARANA	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION
			Suplente			
	Segundo Miembro	ING. DAVID LUNA GRANDEZ	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION
			Suplente			

4	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	
	De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:	
	Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado
	NIMAT MEDICAL S.A.C	S/ 77,500.00

5	BASE LEGAL
Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "Luego de la calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE".	

6	ACUERDO ADOPTADO
Los integrantes del COMITÉ DE SELECCION , por UNANIMIDAD, otorgan la buena pro al postor mencionado en el numeral 4.	

7					
Econ. Angel Daniel Tejada Nuñez Presidente Titular		ING. OSCAR IVAN DIAZ ARANA Primer Miembro		ING. DAVID LUNA GRANDEZ Segundo Miembro	
NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					

**ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:
BIENES, SERVICIOS EN GENERAL Y OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PÚBLICO O PRIVADO)**

1	NÚMERO DE ACTA	001-2023-CS- AS-HOMOLOGACIÓN N° 40-2023-GERESA/LL- ITEM3
---	----------------	---



2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En, la ciudad de trujillo, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre del año 2023, en el local de la GERESALL, a las 03:30 pm horas, se reunieron los integrantes del COMITE DE SELECCION designados mediante Formato N° 04-2023-GERESA/LL , encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de AS-HOMOLOGACIÓN N° 40-2023 GERESA/LL , cuyo objeto de convocatoria es "IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO (18) INCUBADORA NEONATAL AVANZADA PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD". ITEM 3 IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE UNA (01) INCUBADORA NEONATAL DE TRANSPORTE CON VENTILADOR DE TRASLADO PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
---	---

3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)					
	El quorum necesario que exige la normativa de contratación del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
	Presidente	ECON. ANGEL DANIEL TEJADA NUÑEZ	Titular	X	Dependencia:	UTF-ABASTECIMIENTO
			Suplente			
	Primer Miembro	ING.OSCAR IVAN DIAZ ARANA	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION
			Suplente			
	Segundo Miembro	ING. DAVID LUNA GRANDEZ	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION
			Suplente			




4	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	
	De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:	
	Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado
	NOVAMED PERU S.A.C.	S/ 240,000.00

5	BASE LEGAL Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "Luego de la calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE".
---	---

6	ACUERDO ADOPTADO Los integrantes del COMITÉ DE SELECCION , por UNANIMIDAD, otorgan la buena pro al postor mencionado en el numeral 4.
---	---

7	   Econ. Angel Daniel Tejada Nuñez Presidente Titular ING.OSCAR IVAN DIAZ ARANA Primer Miembro ING. DAVID LUNA GRANDEZ Segundo Miembro NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS
---	---

ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

1	NÚMERO DE ACTA	001-2023-CS- AS-HOMOLOGACIÓN N° 40-2023-GERESA/LL																														
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL <p>En, la ciudad de trujillo, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del año 2023, en el local de la GERESALL, a las 03:30 pm horas, se reunieron los integrantes del COMITÉ DE SELECCION designados mediante Formato N° 04-2023-GERESA/LL, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de AS-HOMOLOGACIÓN N° 40-2023 GERESA/LL, cuyo objeto de convocatoria es "IOARR 2801427: ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO (18) INCUBADORA NEONATAL AVANZADA PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD". ITEM 4 IOARR 2801427: ADQUISICIÓN DE DOCE (12) MONITOR DE FUNCIONES VITALES ADULTO/PEDIATRICO, TIPO FIJO DE 8 PARAMETROS PARA USO INTRAHOSPITALARIO PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD.</p>																															
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER) <p>El quorum necesario que exige la normativa de contratación del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:</p> <table border="1"> <tr> <td>Presidente</td> <td>ECON. ANGEL DANIEL TEJADA NUÑEZ</td> <td>Titular X</td> <td>Dependencia:</td> <td>UTF-ABASTECIMIENTO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Suplente</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer Miembro</td> <td>ING.OSCAR IVAN DIAZ ARANA</td> <td>Titular X</td> <td>Dependencia:</td> <td>OFICINA DE PLANIFICACION</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Suplente</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Miembro</td> <td>ING. DAVID LUNA GRANDEZ</td> <td>Titular X</td> <td>Dependencia:</td> <td>OFICINA DE PLANIFICACION</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Suplente</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Presidente	ECON. ANGEL DANIEL TEJADA NUÑEZ	Titular X	Dependencia:	UTF-ABASTECIMIENTO			Suplente			Primer Miembro	ING.OSCAR IVAN DIAZ ARANA	Titular X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION			Suplente			Segundo Miembro	ING. DAVID LUNA GRANDEZ	Titular X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION			Suplente		
Presidente	ECON. ANGEL DANIEL TEJADA NUÑEZ	Titular X	Dependencia:	UTF-ABASTECIMIENTO																												
		Suplente																														
Primer Miembro	ING.OSCAR IVAN DIAZ ARANA	Titular X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION																												
		Suplente																														
Segundo Miembro	ING. DAVID LUNA GRANDEZ	Titular X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION																												
		Suplente																														
4	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO <p>De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:</p> <table border="1"> <tr> <td>Nombre o razón social del postor ganador</td> <td>Monto adjudicado</td> </tr> <tr> <td>NOVAMED PERU SAC</td> <td>S/ 1'301, 000.00</td> </tr> </table>		Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado	NOVAMED PERU SAC	S/ 1'301, 000.00																										
Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado																															
NOVAMED PERU SAC	S/ 1'301, 000.00																															
5	BASE LEGAL <p>Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "Luego de la calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE".</p>																															
6	ACUERDO ADOPTADO <p>Los integrantes del COMITÉ DE SELECCION, por UNANIMIDAD, otorgan la buena pro al postor mencionado en el numeral 4.</p>																															
7	 Econ. Angel Daniel Tejada Nuñez Presidente Titular  ING.OSCAR IVAN DIAZ ARANA Primer Miembro  ING. DAVID LUNA GRANDEZ Segundo Miembro NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS																															

FORMATO N° 11
ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:

1 NÚMERO DE ACTA 001-2023-CS- AS-HOMOLOGACIÓN N°40-2023-GERESA/LL

2 **SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL**
En las instalaciones de la oficina de UTF -ABASTECIMIENTO, a los veintiocho(28) días del mes de noviembre del año 2023, en el local del Gerencia Regional de Salud de la Libertad, a las 03:30 pm. horas, se reunieron los integrantes del comité designados mediante formato N° 004 AS-HOMOLOGACIÓN N°40-2023 GERESA/LL, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección AS HOMOLOGACIÓN N° 40-2023 GERESA/LL, cuyo objeto de convocatoria es "IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO (18) INCUBADORA NEONATAL AVANZADA PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", ÍTEM 4 IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DOCE (12) MONITOR DE FUNCIONES VITALES ADULTO/PEDIÁTRICO, TIPO FIJO DE 8 PARÁMETROS PARA USO INTRAHOSPITALARIO PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, a fin de efectuar la APERTURA DE LAS OFERTAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.

3 **SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)**
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	ECON. ANGEL DANIEL TEJADA NUÑEZ	Titular <input checked="" type="checkbox"/>	Dependencia:	UTF-ABASTECIMIENTO
Primer Miembro	ING. OSCAR IVAN DIAZ ARANA	Suplente <input checked="" type="checkbox"/>	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION
Segundo Miembro	ING. DAVID LUNA GRANDEZ	Titular <input checked="" type="checkbox"/>	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION
		Suplente <input checked="" type="checkbox"/>		

4 **DETALLE DE LOS PARTICIPANTES**
De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU	20100162238
2	ALBUJAR MEDICA S.A.C.	20130329471
3	MEDELCO SRL	20208310730
4	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	20340116055
5	BIOLOGIAS MEDICAS ANDINAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20454094221
6	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	20494151503
7	ABAMEDIC S.R.L.	20502626931
8	HEMOCARE S.A.C.	20505463146
9	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20512709088
10	CARDIOMED DEL PERU SAC	20520987186
11	CORPORACION DACMAR S.A.C.	20529457554
12	DRAEGER PERU S.A.C.	20538597121
13	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C.	20545804795
14	ASECO PERU S.A.C.	20565911920
15	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	20565935861
16	VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.	20601325153
17	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -	20601571065
18	ADVANCED MEDICAL INC E.I.R.L.	20602703003
19	VPM PROVEEDORES S.R.L.	20602922597
20	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	20603355289
21	NOVAMED PERU S.A.C.	20604537372
22	GAESA MEDIC E.I.R.L.	20606094834
23	NIMAT MEDICAL S.A.C.	20608071521
24	MEDICALDIST S.A.C.	20608573373
25	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	20610815341

5 **DETALLE DE LOS POSTORES**
En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron sus ofertas en la plataforma digital del SEACE:

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	15/11/2023	21:50:04
2	NOVAMED	15/11/2023	21:41:55
3	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	15/11/2023	18:42:54
4	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	15/11/2023	21:18:53
5	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C.	15/11/2023	21:26:15

6 **Acto seguido, se procede con la apertura de las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.**

7 **DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS**
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Corresponde las razones para su no admisión
1	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	NO CUMPLE CON EETT SEGÚN INFORME ANEXO DE ING. ESPECIALISTA
2	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	NO CUMPLE CON EETT SEGÚN INFORME ANEXO DE ING. ESPECIALISTA

3	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	NO CUMPLE CON EETT SEGÚN INFORME ANEXO DE ING. ESPECIALISTA
4	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	NO CUMPLE CON EETT SEGÚN INFORME ANEXO DE ING. ESPECIALISTA

8	DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN De acuerdo con la revisión efectuada por el comité, así como el cumplimiento de las especificaciones del ingeniero equipador parte de este colegiado y validando su cumplimiento, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:	
	Nº	Nombre o razón social del postor
	1	NOVAMED PERU SAC
	2	
		Item(s) a los que postula
		ITEM 4 IOARR 2801427: ADQUISICIÓN DE DOCE (12) MONITOR DE FUNCIONES VITALES ADULTO/PEDIATRICO, TIPO FIJO DE 8 PARAMETROS PARA USO INTRAHOSPITALARIO PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

9	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS			
	9.1	DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA		
		Nº	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta
		1	NOVAMED PERU SAC	S/ 1,416,000.00
				% del valor referencial
				108.68%
	9.2	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		
		La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo 01 que forma parte de la presente Acta.		

10	PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR			
	10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1	NOVAMED PERU SAC	
		FACTORES		PUNTAJES
		PRECIO		70
		PLAZO DE ENTREGA		20
		MEJORAS		10
		BONIFICACION MYPE		-
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		100 PUNTOS

11	CALIFICACIÓN Luego de culminada la evaluación, el Comité de selección determinó si el postor que obtuvo el primer lugar según los requisitos de calificación detallados en las bases:			
	12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1	NOVAMED PERU SAC	
		REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
		A EXPERIENCIA	X	
		B CAPACIDAD LEGAL	X	
		C CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL	X	
		RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN	CUMPLE	

12	RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN		
De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo la buena pro, cumple con los requisitos de calificación establecidos en las bases:			
Nº		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR	
1		NOVAMED PERU SAC	
DE SER EL CASO INCLUIR:			
Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases:			
Nº		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN
1		XXXXXXXX	XXXXXXXXXX

13	ACUERDO ADOPTADO Los integrantes del comité de selección por UNANIMIDAD, remitir carta N° 02-2023-CS, a través de correo electrónico a postor NOVAMED PERU SAC, con la finalidad que acepte la solicitud de reducción de oferta y posterior otorgamiento de buena pro, en razón al art 68° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.			
----	---	--	--	--

14	 Escribano, Angel Daniel Tejeda Núñez Presidente Titular			
	 ING. OSCAR IVAN DÍAZ ARANA Primer Miembro			
	 ING. DAVID LUNA GRANDEZ Segundo Miembro			
	NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:

1	NÚMERO DE ACTA	001-2023-CS- AS-HOMOLOGACIÓN N°40-2023-GERESA/LL				
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En, las instalaciones de la oficina de UTF -ABASTECIMIENTO, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del año 2023, en el local del Gerencia Regional de Salud de la Libertad , a las 02:30 pm horas, se reunieron los integrantes del comité designados mediante formato N° 004 AS-HOMOLOGACIÓN N°40-2023 GERESA/LL, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección AS HOMOLOGACIÓN N° 40-2023 GERESA/LL , cuyo objeto de convocatoria es "IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO (18) INCUBADORA NEONATAL AVANZADA PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", ITEM 4 IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DOCE (12) MONITOR DE FUNCIONES VITALES ADULTO/PEDIATRICO, TIPO FIJO DE 8 PARAMETROS PARA USO INTRAHOSPITALARIO PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, a fin de efectuar la APERTURA DE LAS OFERTAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.					
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER) El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
	Presidente	ECON. ANGEL DANIEL TEJADA NUÑEZ	Titular	X	Dependencia:	UTF-ABASTECIMIENTO
			Suplente			
	Primer Miembro	ING. OSCAR IVAN DIAZ ARANA	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION
			Suplente			
	Segundo Miembro	ING. DAVID LUNA GRANDEZ	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION
			Suplente			
4	DETALLE DE LOS PARTICIPANTES De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:					
	N°	Nombre o razón social del participante	RUC			
	1	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU	20100162238			
	2	ALBUJAR MEDICA S.A.C.	20130329471			
	3	MEDELCO SRL	20208310730			
	4	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	20340116055			
	5	BIOLOGIAS MEDICAS ANDINAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20454094221			
	6	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	20494151503			
	7	ABAMEDIC S.R.L.	20502626931			
	8	HEMOCARE S.A.C.	20505463146			
	9	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20512709088			
	10	CARDIOMED DEL PERU SAC	20520987186			
	11	CORPORACION DACMAR S.A.C.	20529457554			
	12	DRAEGER PERU S.A.C.	20538597121			
	13	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	20545804795			
	14	ASECO PERU S.A.C.	20565911920			
	15	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	20565935861			
	16	VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.	20601325153			
	17	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -	20601571065			
	18	ADVANCED MEDICAL INC E.I.R.L.	20602703003			
	19	VPM PROVEEDORES S.R.L.	20602922597			
	20	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	20603355289			
	21	NOVAMED PERU S.A.C.	20604537372			
	22	GAESA MEDIC E.I.R.L.	20606094834			
	23	NIMAT MEDICAL S.A.C.	20608071521			
	24	MEDICALDIST S.A.C.	20608573373			
	25	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	20610815341			
5	DETALLE DE LOS POSTORES En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron sus ofertas en la plataforma digital del SEACE :					
	N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación		
	1	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	15/11/2023	21:50:04		
	2	NOVAMED	15/11/2023	21:41:55		
	3	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	15/11/2023	18:42:54		
	4	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	15/11/2023	21:18:53		
	5	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	15/11/2023	21:26:15		
6	Acto seguido, se procede con la apertura de las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.					

7	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS		
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:		
	Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
	1	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	NO CUMPLE CON EETT SEGÚN INFORME ANEXO DE ING. ESPECIALISTA
	2	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	NO CUMPLE CON EETT SEGÚN INFORME ANEXO DE ING. ESPECIALISTA
	3	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	NO CUMPLE CON EETT SEGÚN INFORME ANEXO DE ING. ESPECIALISTA
	4	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	NO CUMPLE CON EETT SEGUN INFORME ANEXO DE ING. ESPECIALISTA

8	DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN		
	De acuerdo con la revisión efectuada por el comité, así como el cumplimiento de las especificaciones del ingeniero equipador parte de este colegiado y validando su cumplimiento, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:		
	Nº	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
	1	NOVAMED PERU SAC	ITEM 4 IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DOCE (12) MONITOR DE FUNCIONES VITALES ADULTO/PEDIATRICO, TIPO FIJO DE 8 PARAMETROS PARA USO INTRAHOSPITALARIO PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

9	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS			
	9.1	DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA		
	Nº	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
	1	NOVAMED PERU SAC	S/ 1'301, 000.00	99.85%
	9.2	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		
	La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo 01 que forma parte de la presente Acta.			

10	PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES			
	COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR			
	10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1	NOVAMED PERU SAC	
		FACTORES		PUNTAJES
		PRECIO		70
		PLAZO DE ENTREGA		20
		MEJORAS		10
		BONIFICACION MYPE		
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		100 PUNTOS

11	CALIFICACIÓN			
	Luego de culminada la evaluación, el Comité de selección determinó si el postor que obtuvo el primer lugar según los requisitos de calificación detallados en las bases:			
	12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1	NOVAMED PERU SAC	
		REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
	A	EXPERIENCIA	X	
	B	CAPACIDAD LEGAL	X	
	C	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL	X	
		RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN	CUMPLE	

12	RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN	
	De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo la buena pro, cumple con los requisitos de calificación establecidos en las bases:	
	Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
	1	NOVAMED PERU SAC
DE SER EL CASO INCLUIR:		

Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases:		
Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN
1	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Que, mediante carta NOVAMED-COR-266/2023 de fecha 29 de noviembre de 2023, señala que "(...) debemos indicar que haciendo una evaluación de los costos a incurrir en el bien a contratar hemos considerado por esta ocasión hacer un reajuste en el precio de la oferta económica (...) PRECIO TOTAL REDUCIDO S/ 1'301, 000.00"		
13	REDUCCIÓN DEL PRECIO DE LA OFERTA	
	Nº	Nombre o razón social del postor
	1	NOVAMED PERU S.A.C.
		Aceptó reducción de su oferta
		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
14	ACUERDO ADOPTADO	
	Los integrantes del comité de selección por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.	
15	 Econ. Angel Daniel Tejeda Nuñez Presidente Titular	
	 ING. OSCAR IVAN DIAZ ARANA Primer Miembro	
	 ING. SANDO LUNA GRANDEZ Segundo Miembro	
NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS		

ITEM 4 IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DOCE (12) MONITOR DE FUNCIONES VITALES ADULTO/PEDIATRICO, TIPO FIJO DE 8 PARAMETROS PARA USO INTRAHOSPITALARIO PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		12 UNIDAD				
MONTO DISPONIBLE		S/1,302,847.29 Soles				
POSTORES	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	NOVAMED PERU S.A.C.	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	CARDIOPULMONA RY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	
RUC	20340116055	20604537372	20603355289	20512709088	20545804795	
DOCUMENTOS PARA ADMISION DE OFERTAS ITEM 04						
DECLARACION JURADA DEL POSTOR ANEXO 01	ANEXO 01	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
COPIA CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL COPIA DE DNI	VIGENCIA PODER	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
DECLARACION JURADA ANEXO 2	ANEXO 02	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 01	ANEXO 03	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
ACREDITACION DE ESPECIFICACIONES		NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELECTRICA		CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
COPIA DEL CERTIFICADO ISO 13485		CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
REGISTRO SANITARIO		CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE ENTREGA	ANEXO 04	CONFORME 23 DIAS	CONFORME 23 DIAS	CONFORME 29 DIAS	CONFORME 22 DIAS	NO CUMPLE CON PRESENTAR ANEXO DE ACUERDO A LA FICHA
PROMESA DE CONSORCIO	ANEXO 05	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
PRECIO OFERTA	ANEXO 06	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
DOCUMENTACION DE PRESENTACION FACULTATIVA						
BONIFICACION DE MYPE	5%	CORRESPONDE	CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	CORRESPONDE
PUNTAJES						
VALOR OFERTA		S/ 1,152,000.00	S/ 1,416,000.00	S/ 960,000.00	S/ 876,000.00	S/ 2,314,800.00
% DEL VALOR DE OFERTA			108.68%			
PRECIO			70			
PLAZO DE ENTREGA			20			
MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS			10			
BONIFICACION MYPE			-			
PUNTAJE TOTAL			100			
EXPERIENCIA DEL POSTOR						
CAPACIDAD LEGAL		CUMPLE				
CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL		CUMPLE				

NOVAMED-COR-266/2023

Lima, 29 de Noviembre del 2023

Señores
GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD
Presente.-

Atte.: Lic. Angel Daniel Teleda Nuñez
Presidente de Comité de Selección

Ref.: Reducción de la Oferta Económica

Estimados Señores:

Por la presente, en respuesta a vuestra solicitud con carta N° 02-2023-CS sobre REDUCCION DE OFERTA ECONOMICA, en el proceso Adjudicación Simplificada Homologación N° 40-2023-GERESALL ITEM N° 4, debemos indicar que haciendo una evaluación de los costos a incurrir en el bien a contratar hemos considerado por esta ocasión hacer un reajuste en el precio de la oferta económica de la siguiente manera:

PRECIO REAJUSTADO

ITEM N°	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL OFERTADO S/	PRECIO TOTAL REDUCIDO S/
04	IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DOCE (12) MONITOR DE FUNCIONES VITALES ADULTO/PEDIATRICO, TIPO FIJO DE 8 PARAMETROS PARA USO INTRAHOSPITALARIO PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	12	1'416,000.00	1'301,000.00

Adjunto al presente, remitimos el **Anexo N° 6** debidamente firmada por nuestra Representante Legal.

Sin otro particular, quedamos como siempre atentos a sus gratas órdenes.

Atentamente,

NOVAMED PERÚ S.A.C.


Valeria Geraldine Valdivezo Shoplana
GERENTE GENERAL

ANEXO N° 06**ITEM 5****PRECIO DE LA OFERTA**

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA HOMOLOGACIÓN N° 040-2023-GERESALL
Presente.-


De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

PRESTACION	DESCRIPCION	PRECIO TOTAL S/
PRINCIPAL	IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DOCE (12) MONITOR DE FUNCIONES VITALES ADULTO/PEDIATRICO, TIPO FIJO DE 8 PARAMETROS PARA USO INTRAHOSPITALARIO PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	1'297,000.00
	CAPACITACION	
ACCESORIAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	4,000.00
TOTAL S/		1'301,000.00

El precio de la oferta en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos

NOVAMED PERÚ S.A.C.


Valeria Geraldine Valdiviezo Shapiama
GERENTE GENERAL

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

**AS N° 040-2023-GERESALL
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS**

ITEM 4	MONITOR DE FUNCIONES VITALES ADULTO/PEDIATRICO, TIPO FLO DE 8 PARAMETROS PARA USO INTRAHOSPITALARIO									
POSTOR 1	TECNIMED SYSTEM S. A.									
POSTOR 2	GOLDEN MEDICAL TECH SAS									
POSTOR 3	CPB MEDICAL SAC									
POSTOR 4	NOVAMED PERU SAC									
POSTOR 5	CARDIOPULMONARY CARE SAC									
ESPECIFICACIONES TECNICAS										
Nº	CARACTERISTICAS/CONDICIONES	ESPECIFICACIONES	POSTOR 1	POSTOR 2	POSTOR 3	POSTOR 4	POSTOR 5			
GENERALES										
1.1	BASE	EQUIPO MODULAR, MONITOR Y MODULOS DE LA MISMA MARCA	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET			
1.2	PARAMETROS	ELECTROCARDIOGRAMA (ECG), FRECUENCIA RESPIRATORIA (RR), SATURACION DE OXIGENO (SPO2), PRESION ARTERIAL (NO INVASIVA (PANI), TEMPERATURA (O2 CANALES) CAPNOGRAFIA (CO2), PRESION INVASIVA (PI) Y GASTO CARDIACO (CO)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET			
1.3	TENDENCIAS	HASTA 24 HORAS O MAS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET			
1.4	CONECTIVIDAD CON OTROS EQUIPO	VENTILADOR O MAQUINA DE ANESTESIA O ANALIZADOR DE GASES SANGUINEOS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET			
1.5	CONEXION A SISTEMA DE INFORMACION HOSPITALARIA	MEDIANTE PROTOCOLO HL7	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	NO ACREDITA, NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS. "Cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de tal manera que el Comité de Selección pueda evidenciar lo que el postor se encuentra ofreciendo sin recurrir a interpretaciones" (Véase Resolución N° 750-2021-TC-51; Resolución N° 235-2022-TC-54; Resolución N° 1169-2022-TC-54; Resolución N° 2595-2021-TC-55).						
1.6	PROTECCION	CONTRA DESCARGAS DE DESFIBRILADOR	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET			
1.7	CAPACIDAD PARA CONECTARSE A LA ENTRADA DE MONITOREO	MEDIANTE RED LAN ALAMBICA E INALAMBICA WIFI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET			
1.8	CALCULO DE FARMACOS O DRUGAS	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET			
1.9	SILENCIADOR DE ALARMAS	FUNCION DE SUSPENDER O SILENCIAR ALARMAS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET			
1.10	INTERFAZ DE ENTRADA	MEDIANTE PANTALLA TÁCTIL (TOUCH SCREEN) Y/O PERIFERIA SERVIDORA	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET			
2	COMPONENTES									

2.1 ALARMAS (SONORAS Y VISUALES)					
2.1.1	DE SELECCIÓN PARA LÍMITE SUPERIOR E INFERIOR DE LA FRECUENCIA CARDÍACA	SI	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT
2.1.2	DE APNEA	SI	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT
2.1.3	DE SELECCIÓN PARA LÍMITE SUPERIOR E INFERIOR DE LA FRECUENCIA RESPIRATORIA	SI	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT
2.1.4	DE SELECCIÓN PARA LÍMITE INTERIOR DE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO	SI	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT
2.1.5	DE SELECCIÓN PARA LÍMITE SUPERIOR E INFERIOR DE LA PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA	SI	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT
2.1.6	DE SELECCIÓN PARA LÍMITE SUPERIOR E INFERIOR DE LA TEMPERATURA	SI	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT
2.1.7	DE SELECCIÓN PARA LÍMITE SUPERIOR E INFERIOR DEL CO2 ESPIRADO LETCO2	SI	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT
2.1.8	DE SELECCIÓN PARA LÍMITE SUPERIOR E INFERIOR DE LA PRESIÓN INVASIVA	SI	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT
2.2 PANTALLA					
2.2.1	TIPO	LCD O TFT, A COLOR PARA VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT
2.2.2	TAMAÑO	15" DIAGONAL O MAYOR	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT
2.2.3	RESOLUCIÓN	1024 X 768 PÍXELES O MAYOR	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT
2.2.4	GRÁFICAS	OCHO (08) ONDAS SIMULTÁNEAS O MÁS	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT
2.3 REGISTRADOR					
2.3.1	TIPO	REGISTRO POR ARREGLO TÉRMICO, INCORPORADO O INTEGRADO EN EL MONITOR	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT
2.3.2	CAPACIDAD PARA PAPEL DE 50 MM DE ANCHO	SI	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT
2.3.3	NÚMERO DE CAUALES DE IMPRESIÓN	TRES (03) CAUALES DE ONDA DE MANERA SIMULTÁNEA O MÁS	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT
3 PARÁMETROS					
3.1 ELECTROCARDIOGRAMA (ECG)					
3.1.1 VISUALIZACIÓN EN PANTALLA					
	DOS (02) ONDAS O MÁS Y UN (01) VALOR NUMÉRICO MEDIDO		CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT
3.1.2 RANGO DE MEDICIÓN DE LA FRECUENCIA CARDÍACA (BPM O LPM)					
	DE 30 A 250 BPM O RANGO MÁS AMPLIO		CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT
3.1.3 SELECCIÓN DE DERIVADAS					
	DOCE (12) DERIVADAS I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6		CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT
3.1.4 DETECCIÓN O RECHAZO DEL PULSO DEL MARCAPASOS					
	SI		CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SISTEMA CUMPLIMIENTO DE EETT

NO ACREDITA, NO CUMPLE
ESPECIFICACIONES
TEÓRICAS. Cada profesor debe
ser diligente y presentar
ofertas claras y comprensibles
de tal manera que el Comité
de Selección pueda evidenciar
la que al profesor se encuentra
afectando sin recurrir a
interpretaciones. (Véase
Resolución Nº 750-2021-TCF-
S1; Resolución Nº 235-2022-
TCF-S4; Resolución Nº 1169-
2022-TCF-S4; Resolución Nº
2595-2021-TCF-S5).

3.1.5	DETECCION DE ARITMIAS	DOCE (12) TIPOS O MAS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
3.1.6	ANALISIS DE DERIVADO ST	EN DOCE (12) DERIVACIONES	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
3.2	FRECUENCIA RESPIRATORIA (FR)						
3.2.1	VISUALIZACION EN PANTALLA	UNA (01) ONDA O MAS Y UN (01) VALOR NUMERICO MEDIDO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
3.2.2	METODO	MEDICION A TRAVES DE CABLE ECG (METODO DE IMPEDANCIAS) Y A TRAVES DE LAS VIBS AEREAS MEDIANTE LA CAPNOGRAFIA	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	NO ACREREDITA, NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS. "Cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de tal manera que el Comité de Selección pueda evidenciar lo que el postor se encuentra ofertando sin recurrir a interpretaciones" (Véase Resolución No 750-2021-TC-E-S1; Resolución No 235-2022-TC-E-S4; Resolución No 1169-2022-TC-E-S4; Resolución No 2595-2021-TC-E-S5).	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
3.2.3	RANGO	5 A 120 RESPIRACIONES POR MINUTO O RANGO MAS AMPLIO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
3.3	SATURACION DE OXIGENO (SPO2)						
3.3.1	METODO DE MEDICION EN CONDICIONES DE BAJA PERLUSION Y/O MOVIMIENTO	TECNOLOGIA DE EXTRACCION DE SEÑALES, O ALGORITMO DE PROCESAMIENTO DE SEÑALES CARDIACAS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	NO ACREREDITA, NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS. "Cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de tal manera que el Comité de Selección pueda evidenciar lo que el postor se encuentra ofertando sin recurrir a interpretaciones" (Véase Resolución No 750-2021-TC-E-S1; Resolución No 235-2022-TC-E-S4; Resolución No 1169-2022-TC-E-S4; Resolución No 2595-2021-TC-E-S5).	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
3.3.2	VISUALIZACION EN PANTALLA	UNA (01) ONDA PLETISIOGRAFICA Y UN (01) VALOR NUMERICO MEDIDO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
3.3.3	METODO DE MEDICION	ASOCIACION DE LUZ DE LONGITUD DE ONDA	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
3.3.4	RANGO DE LA SATURACION DE OXIGENO	70% A 100% O RANGO MAS AMPLIO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
3.3.5	PRECISION	$\pm 3\%$ (%), 3 DIGITOS) O MENOR, EN EL RANGO DE 70% A 100%	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
3.3.6	RANGO DEL PULSO CARDIACO MEDIANTE PULSIOXIMETRIA (BPM O LPM)	30 A 240 BPM O RANGO MAS AMPLIO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET

3.3.7	INDICADOR EN PANTALLA	POTENCIA DE LA SEÑAL O PERFUSION O INTENSIDAD DE SEÑAL	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
3.4	PREISION ARTERIAL NO INVASIVA (PANI)						
3.4.1	VISUALIZACION EN PANTALLA	VALOR NUMERICO MEDIDO: SISTOLICA, DIASTOLICA Y MEDIA	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
3.4.2	METODO DE MEDICION	OSCILOMETRICO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
3.4.3	TIPO DE PACIENTE	ADULTOS Y NIÑOS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
3.4.4	MODO PARA TOMA DE PRECISION	MANUAL Y AUTOMATICO (A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO O PERIODICOS)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
3.5	TEMPERATURA (TEMP)						
3.5.1	VISUALIZACION EN PANTALLA	DOS (02) VALORES NUMERICOS MEDIDOS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
3.5.2	RANGO DE MEDICION	0° C A 45°C O MAS AMPLIO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
3.5.3	NUMERO DE CANALES	DOS (02) O MAS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
3.6	CAPNOGRAFIA						
3.6.1	VISUALIZACION EN PANTALLA	UNA (01) ONDA O MAS Y UN (01) VALOR NUMERICO MEDIDO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
3.6.2	METODO DE MEDICION	MAINSTREAM O SIDESTREAM O MICROSTREAM	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
3.6.3	RANGO DE MEDICION	DE 0 MMHG A 99 MMHG O RANGO MAS AMPLIO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
3.7	PREISION INVASIVA (PI)						
3.7.1	VISUALIZACION EN PANTALLA	UNA (01) ONDA O MAS Y UN (01) VALOR NUMERICO MEDIDO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
3.7.2	RANGO DE MEDICION	DE 30 MMHG A 300 MMHG O RANGO MAS AMPLIO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
3.7.3	NUMERO DE CANALES	DOS (02) CANALES O MAYOR	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
3.7.4	CALIBRACION	BALANCE, AJUSTE A CERO DE LA PREISION INVASIVA	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
3.8	GASTO CARDIACO (GC)						
3.8.1	VISUALIZACION EN PANTALLA	UN (01) VALOR NUMERICO MEDIDO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
3.8.2	METODO DE MEDICION	TERMODILUACION O TERMODILUACION TRANSPULMONAR	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
4	ACCESORIOS (VER NOTA 2)						
4.1	RACK DE PARED, DE ALTRA GRATUABLE E INCLINACION PARA EL MONITOR	UNO (01)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
4.2	CABLE DE ALIMENTACION	UNO (01)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
4.3	ESTABILIZADOR EXTERNO						
4.3.1	TIPO	ESTADO SOLIDO (SIN RELE), FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO, CON LINEA A TIERRA	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
4.3.2	VARIACION DEL VOLTAJE DE SALIDA	MEJOR O IGUAL A +/- 5%	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
4.3.3	POTENCIA	SUPERIOR EN 25% O MAYOR DE LA POTENCIA NOMINAL DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
4.3.4	CANTIDAD	UNO (01)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
4.4	ECG PARA 3 DERIVADAS						
4.4.1	CABLE TRONCAL DE ECG PARA 3 DERIVADAS DE 1.50 M O MAYOR	DOS (02)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT

[Handwritten signature]

4.4.2	CABLE RAMAL DE ECG PARA 3 DERIVADAS	OCHO (08)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
4.5	ECG PARA 5 O 6 DERIVADAS							
4.5.1	CABLE TRONCAL DE ECG PARA 5 O 6 DERIVADAS, DE 1,50 M O MAYOR	DOS (02)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
4.5.2	CABLE RAMAL DE ECG PARA 5 O 6 DERIVADAS	OCHO (08)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
4.6	ECG PARA 12 DERIVADAS							
4.6.1	CABLE TRONCAL DE ECG PARA 12 DERIVADAS, DE 1,50 M O MAYOR	DOS (02)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
4.6.2	CABLE RAMAL DE ECG PARA 12 DERIVADAS	DOS (02)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
4.7	SATURACION DE OXIGENO (SP02)							
4.7.1	SENSOR REUSABLE PARA MEDIR SATURACION DE OXIGENO, PARA ADULTO	SEIS (06)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
4.7.2	SENSOR REUSABLE PARA MEDIR SATURACION DE OXIGENO, PARA PEDIATRICO	DOS (02)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
4.7.3	CABLE EXTENSOR	UNO (01)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
4.8	PRESION ARTERIAL NO INVASIVA (PANI)							
4.8.1	BRAZALETE REUSABLE PARA MEDICION DE LA PRESION NO INVASIVA, PARA ADULTO	DOS (02)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
4.8.2	BRAZALETE REUSABLE PARA MEDICION DE LA PRESION NO INVASIVA, PARA PEDIATRICO	DOS (02)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
4.8.3	BRAZALETE REUSABLE PARA MEDICION DE LA PRESION NO INVASIVA, PARA ADULTO GRANDE	DOS (02)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
4.8.4	BRAZALETE REUSABLE PARA MEDICION DE LA PRESION NO INVASIVA, PARA PEDIATRICO PEQUEÑO	DOS (02)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
4.8.5	MANIGUERA CON CONECTOR PARA LOS BRAZALETES ADULTO/PEDIATRICO	DOS (02)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
4.9	TEMPERATURA (TEMP)							
4.9.1	SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA (DE PIEL O SUPERFICIE) PARA ADULTO	DOS (02)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
4.9.2	SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA (ESOFAGICO O RECTAL) PARA ADULTO	DOS (02)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
4.9.3	SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA (DE PIEL O SUPERFICIE) PARA PEDIATRICO	DOS (02)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
4.9.4	SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA (ESOFAGICO O RECTAL) PARA PEDIATRICO	DOS (02)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
4.10	CAPNOGRAFIA (CO2)							

[Handwritten signature]

4.10.1	SENSOR DE CAPNOGRAFIA	EN CASO DE SER MAINSTREAM: DOS (02) SENSORES REUSABLES, CON CABLE CONECTOR AL EQUIPO, CON DOS ADAPTADORES REUSABLES DE VIAS AEREAS O CUARENTA (40) ADAPTADORES DESCARTABLES DE VIAS AEREAS, CON SET DE CALIBRACION SI EL EQUIPO LO REQUIERE.	NO ACREDITA, NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS. "Cada posterior debe ser diligencia y presentar ofertas claras y congruentes de tal manera que el Comité de Selección pueda evidenciar lo que el postor ha encontrado efectuando sin recurrir a interpretaciones (Vase Resolución N° 750-2021-ITE-SI; Resolución N° 235-2022-ITE-SI; Resolución N° 1169-2022-ITE-SI; Resolución N° 2595-2021-ITE-SI).	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
4.11	PRESION INVASIVA (PI)							
4.11.1	KIT COMPLETO PARA PRESION ARTERIAL INVASIVA, DESCARTABLE, PARA USO ADULTO/PEDIATRICO (TRANSDUCTOR, CABLES Y JUEGO DE INYECTOR)	VEINTE (20) (INCLUYE 2 CABLES PARA CONEXION)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
4.12	GASTOCARDIACO (GC)							
4.12.1	KIT COMPLETO PARA GASTO CARDIACO (CABLES, SENSORES, CATETERES Y SONDAS)	VEINTE (20) (INCLUYE 2 CABLES PARA CONEXION)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
4.13	PAPEL TERMOSENSIBLE							
4.13.1	CANTIDAD	CINCO (05) ROLLOS O PAQUETES	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
4.14	ELECTRODOS PARA ECG							
4.14.1	TIPO	BROCHE PARA PIEL	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
4.14.2	CANTIDAD	CIENTO (100) ELECTRODOS DESCARTABLES	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
4.15	BATERIA							
4.15.1	TIPO	RECARGABLE, INCORPORADA AL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
4.15.2	AUTONOMIA	DE SESENTA (60) MINUTOS O MAYOR	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
5	REQUERIMIENTO DE ENERGIA							
5.1	VOLTAJE	220 VAC (NOMINAL)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
5.2	FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO	60 HZ	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
6	CUMPLIMIENTO NORMATIVO							
6.1	CERTIFICACION REGLAMENTARIA	REGISTRO SANITARIO						
MEJORA A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS								
1	DETECCION DE 23 TIPOS DE ARITMIAS Y MEDICION AUTOMATICA QUE ACTIVE LA MEDICION DE LA PRESION ARTERIAL NO INVASIVA CADA VEZ QUE DETECTE UN CAMBIO DE LA PRESION SANGUINEA EN EL PACIENTE INDEPENDIENTE DE LA MEDICION PERIODICA	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FUNDAMENTAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO Y DE LA ABSOLUCION DE CONSULTA Y OBSERVACIONES	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FUNDAMENTAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO Y DE LA ABSOLUCION DE CONSULTA Y OBSERVACIONES	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FUNDAMENTAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO Y DE LA ABSOLUCION DE CONSULTA Y OBSERVACIONES	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FUNDAMENTAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO Y DE LA ABSOLUCION DE CONSULTA Y OBSERVACIONES	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FUNDAMENTAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO Y DE LA ABSOLUCION DE CONSULTA Y OBSERVACIONES

2	MEDICION AUTOMATICA QUE ACTIVE LA MEDICION DE LA PRESION ARTERIAL NO INVASIVA CADA VEZ QUE DETECTE UN CAMBIO DE LA PRESION SANGUINEA EN EL PACIENTE INDEPENDIENTE DE LA MEDICION PERIODICA	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FUNDAMENTAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO Y DE LA ASISTENCIA DE CONSULTA Y OBSERVACIONES.	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FUNDAMENTAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO Y DE LA ASISTENCIA DE CONSULTA Y OBSERVACIONES.	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FUNDAMENTAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO Y DE LA ASISTENCIA DE CONSULTA Y OBSERVACIONES.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FUNDAMENTAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO Y DE LA ASISTENCIA DE CONSULTA Y OBSERVACIONES.
---	--	--	--	--	---------------------------------------	--

ITEM 4	MONITOR DE FUNCIONES VITALES ADULTO/PEDIATRICO, TIPO FIJO DE 8 PARAMETROS PARA USO INTRAHOSPITALARIO					
POSTOR 1	TECNIMED SYSTEM S.A.	NO CUMPLE, NO SE VALIDA CUMPLIMIENTO DE EET				
POSTOR 2	GOLDEN MEDICAL TECH SAC	NO CUMPLE, NO SE VALIDA CUMPLIMIENTO DE EET				
POSTOR 3	CPB MEDICAL SAC	NO CUMPLE, NO SE VALIDA CUMPLIMIENTO DE EET				
POSTOR 4	NOVAMED PERU SAC	CUMPLE Y SE VALIDA CUMPLIMIENTO DE EET				
POSTOR 5	CARDIOPULMONARY CARE SAC	NO CUMPLE, NO SE VALIDA CUMPLIMIENTO DE EET				

Al respecto, como parte de la documentación obligatoria de las bases integradas se ha requerido la presentación "FORMATO Nº01 "Hoja de presentación del equipo/ sustento de cumplimiento de características técnicas" mediante el cual, los postores deben demostrar fehacientemente que el bien ofrecido cumple con las especificaciones técnicas y características técnicas solicitadas.

Sobre el punto, es importante señalar que las bases integradas del presente procedimiento de selección han sido elaboradas tomando como condiciones y características técnicas, y en ese sentido se advierte el contenido de la oferta de los postores no resulta ser concuyente, por otro lado, es confusa no permitiendo a este comité de selección tener certeza de que el equipo efectivamente cumple con el sensor de sop2 esterilizable, lo cual, no le otorga a este comité de selección, la certeza de que el equipo cumple con todas las condiciones necesarias para cumplir con la finalidad de la contratación, más aún cuando se está vulnerando las características. En este punto resulta importante traer a colación la Resolución Nº01251-2022-TCE-S2 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

"Por el contrario, de presentarse una oferta profusa, difusa y confusa, imposibilitando al comité de selección determinar fehacientemente el real alcance de la misma, este deberá no admitirla o descalificarla, según corresponda. pues no es función de dicho órgano interpretar el alcance de una oferta, establecer ambigüedades, o precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofrecido, en función a las condiciones expresamente detalladas, sin posibilidad, como se indicó, de inferir o interpretar hecho alguno.

Por lo tanto, existen denominaciones o tecnicismos o términos que no han sido requeridos en las bases integradas del presente procedimiento de selección que no permite a este colegiado tener la certeza de acreditación de la característica técnica en cuestión.

Previamente se ha establecido características y condiciones técnicas el cual busca la adquisición de MONITORES DE FUNCIONES VITALES ADULTO/PEDIATRICO, TIPO FIJO DE 8 PARAMETROS PARA USO INTRAHOSPITALARIO para la atención a pacientes de unidad críticas.

CARACTERISTICA DE FICHA HOMOLOGADA:
POSTOR 1: TECNIMED SYSTEM S.A.



De la evaluación de la propuesta presentada de manera integral y en cumplimiento de la presentación de documentos obligatorios según lo requerido en las bases integradas:

No cumple con sustento técnico de las características solicitadas, debido a la siguiente divergencia y omisión en la propuesta, las cuales no son subsanables dado que una modificación en ese supuesto impacta en los términos en los que se encuentra expresada una oferta y con ello, en el contenido esencial de esta y que a continuación se detallan.

CARACTERÍSTICAS 4.10.1 DE LA FICHA HOMOLOGADA

4.10	Capnografía (CO2)	
	En caso de ser Mainstream: El CO2 (CO2) se mide reemplazando con cable conectado al equipo, con los adaptadores necesarios por una almohada o cubreata (40) adaptadores de conexión de vías aéreas. Con los de calibración si el equipo lo requiere.	
4.10.1	Sensor de Capnografía	En caso de ser Sidestream: Válvula (20) trocero de agua, cuaverta (40) trocero de muñeca y ventila adaptadores especializados que se les de vías aéreas. En caso de ser Mainstream: Válvula (20) trocero de agua, cuaverta (40) trocero de muñeca y ventila adaptadores, especializados que se les de vías aéreas.

En el folio 84 y con las evidencias de su propuesta; el postor sustenta "En Caso de ser Sidestream:..."; a través de una declaración jurada, siendo esta una característica técnica, que debe ser acreditada a través de una carta del fabricante, según CAPÍTULO II: DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, numeral 2.2.1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE OFERTAS, de las Bases Integradas del Proceso de Selección



• **MONITOR DE FUNCIONES VITALES ADULTO/PEDIATRICO, TIPO
FIO DE 8 PARAMETROS PARA USO INTRAHOSPITALARIO: 1.1 a
1.9, 2.1.1 a 2.3.3, 3.1.1 a 3.8.2 y de 4.1 a 4.15.2**

CARATERISTICA DE FICHA HOMOLOGADA:

POSTOR 2: GOLDEN MEDICAL TECH SAC.

De la evaluación de la propuesta presentada de manera integral y en cumplimiento de la presentación de documentos obligatorios según lo requerido en las bases integradas:

No cumple con sustento técnico de las características solicitadas, debido a la siguiente divergencia y omisión en la propuesta, las cuales no son subsanables dado que una modificación en ese supuesto impacta en los términos en los que se encuentra expresada una oferta y con ello, en el contenido esencial de esta y que a continuación se detallan.

CARACTERÍSTICAS 1.5 DE LA FICHA HOMOLOGADA

1.5	Conexión a sistema de información hospitalaria	Mediante protocolo HL7
-----	--	------------------------

En el folio 31 y con las evidencias de su propuesta; el postor sustenta "el monitor admite protocolo HL7", no siendo claro y preciso, presenta información incompleta, al momento de acreditar "conexión a Sistema de Información Hospitalaria", cabe precisar que cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el Comité de Selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones. Así pues, toda información contenida en la oferta técnica o económica, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad"



6.5 Sistema de monitoreo central

El monitor puede conectarse al sistema de monitoreo central. A través de la red:

1. El monitor envía la información del paciente, la monitoriza en tiempo real o los datos de medición al sistema de monitoreo central.
2. La información del monitoreo en tiempo real se visualiza en el sistema de monitoreo central al igual que en el monitor, y el sistema de monitoreo central puede realizar cierto control bilateral. Por ejemplo: cambiar información del paciente, recibir a un paciente, dar de alta a un paciente y demás.

Para obtener información más detallada, consulte *Manual del usuario del sistema de monitoreo central Affi-M-CMS*.

Y el monitor admite el protocolo HL7.



CARACTERÍSTICAS 3.2.2. DE LA FICHA HOMOLOGADA

3.2.2	Método	Medición a través de cable ECG (método de impedancia) y a través de las vías aéreas mediante la capnografía
-------	--------	---

Establecido por el Ministerio

En el folio 37 y con las evidencias de su propuesta; el postor sustenta solo un Método de Medición de Frecuencia Respiratoria (FR), a través de Claves ECG, presenta información incompleta, al momento de acreditar "a través de las vías aéreas mediante la capnografía", cabe precisar que cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el Comité de Selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones. Así pues, toda información contenida en la oferta técnica o económica, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad".

Capítulo 9 Monitoreo de RESP

9.1 Descripción general

El monitor mide la respiración del grado de impedancia torácica entre dos electrodos de ECG. El cambio de la impedancia entre los dos electrodos (debido al movimiento torácico) genera una forma de onda respiratoria en la pantalla. ← 3.2.1

CARACTERÍSTICA DE FICHA HOMOLOGADA:

POSTOR 3: CPB MEDICAL SAC.


De la evaluación de la propuesta presentada de manera integral y en cumplimiento de la presentación de documentos obligatorios según lo requerido en las bases integradas:

No cumple con sustento técnico de las características solicitadas, debido a la siguiente divergencia y omisión en la propuesta, las cuales no son subsanables dado que una modificación en ese supuesto impacta en los términos en los que se encuentra expresada una oferta y con ello, en el contenido esencial de ésta y que a continuación se detallan.

CARACTERÍSTICAS 1.5 DE LA FICHA HOMOLOGADA

1.5	Conexión a sistema de información hospitalaria	Mediante protocolo HL7
-----	--	------------------------

En el folio 31 y con las evidencias de su propuesta; el postor sustenta "el monitor admite protocolo HL7", no siendo claro y preciso, presenta información incompleta, al momento de acreditar "conexión a Sistema de Información Hospitalaria", cabe precisar que cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el Comité de Selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones. Así pues, toda información contenida en la oferta técnica o económica, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad"




6.5 Sistema de monitoreo central

El monitor puede conectarse al sistema de monitoreo central. A través de la red:

1. El monitor envía la información del paciente, la monitorea en tiempo real o los datos de medición al sistema de monitoreo central.
2. La información del monitoreo en tiempo real se visualiza en el sistema de monitoreo central al igual que en el monitor, y el sistema de monitoreo central puede realizar control bilateral. Por ejemplo: cambiar información del paciente, recibir a un paciente, dar de alta a un paciente y demás.

Para obtener información más detallada, consulte *Manual del usuario del sistema de monitoreo central MFM-C-V8*.

X el monitor admite el protocolo HL7. 



CARACTERÍSTICAS 3.3.1 DE LA FICHA HOMOLOGADA

3.3	Saturación de oxígeno (SpO2)	
3.3.1	Método de medición en condiciones de baja perfusión y/o movimiento	Tecnología de extracción de señales, o algoritmo de procesamiento de señales cardíacas

En el folio 269, con las evidencias de su propuesta, el postor sustenta Método de Medición en Condiciones de baja perfusión, no cumpliendo con lo solicitado "medición en condiciones de baja perfusión", cuando "se indica un bajo nivel de perfusión y una calidad de señal pobre en el sitio de monitoreo, se debe reposicionar el Sensor o hallar un mejor lugar", cabe precisar que cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el Comité de Selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones. Así pues, toda información contenida en la oferta técnica o económica, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad"

10.7 Índice de perfusión (IP)*

* Solo se aplica al módulo SpO₂ de EDAN

3.3.1

IP es un valor numérico indicador del nivel de perfusión. Refleja el nivel de perfusión en el sitio de monitoreo.

3.3.2

Dado que la medición de SpO₂ se basa en la pulsación causada por el flujo sanguíneo a través del vaso, IP tiene relación con la intensidad del pulso. Además, puede utilizarse IP como un indicador de calidad de la señal para la medición de SpO₂.

El IP se indica con un valor que oscila entre 0 y 10. Entre más alto sea el valor, mejor será la perfusión y la calidad de señal. El nivel de perfusión y la calidad de señal llegan a su nivel máximo cuando se muestra un valor de 10. Cuando el IP es menor que 2, este indica un bajo nivel de perfusión y una calidad de señal pobre en el sitio de monitoreo, se debe repositionar el sensor o hallar un mejor lugar.

El valor de IP se mostrará en el área de parámetros de SpO₂.

CARACTERÍSTICA DE FICHA HOMOLOGADA:


POSTOR 3: CARDIO PULMONARY CARE SAC.

De la evaluación de la propuesta presentada de manera integral y en cumplimiento de la presentación de documentos obligatorios según lo requerido en las bases integradas:

No cumple con sustento técnico de las características solicitadas, debido a la siguiente divergencia y omisión en la propuesta, las cuales no son subsanables dado que una modificación en ese supuesto impacta en los términos en los que se encuentra expresada una oferta y con ello, en el contenido esencial de esta y que a continuación se detallan.


CARACTERÍSTICAS 3.1.1 DE LA FICHA HOMOLOGADA

3.1	Electrocardiograma (ECG)	
3.1.1	Visualización en pantalla	Dos (02) ondas o más y un (01) valor numérico medido



En el folio 044, 064, 065 y con las evidencias de su propuesta; el postor sustenta visualización en pantalla, no cumpliendo con lo solicitado "Dos (02) ondas o más", en todos los extremos solo sustenta Una (01) Onda, cabe precisar que cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el Comité de Selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones. Así pues, toda información contenida en la oferta técnica o económica, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad"

♦ Pantalla de la forma de onda 3.1.1

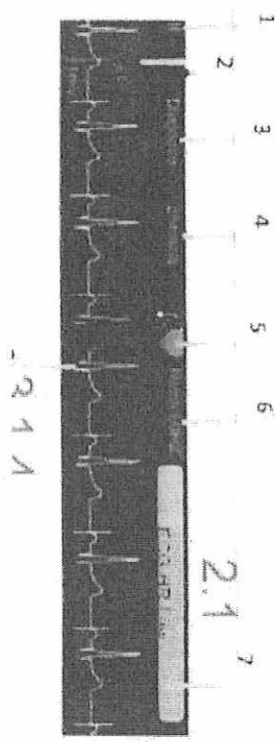

CARACTERÍSTICAS 3.3.1 DE LA FICHA HOMOLOGADA

3.3	Saturación de oxígeno (SpO2)	Tecnología de extracción de señales, o algoritmo de procesamiento de señales cardíacas
3.3.1	Método de medición en condiciones de baja perfusión y/o movimiento	

En el folio 023, 024, 025, 028 y con las evidencias de su propuesta; el postor sustenta el método de medición en condiciones de baja perfusión y/o movimiento, con un catálogo que pertenece a otro equipo que no es el ofertado, el método de medición no se encuentra sustentado en el catálogo y/o carta del fabricante, cabe precisar que cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el Comité de Selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones. Así pues, toda información contenida en la oferta técnica o económica, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad"

Masimo SET: Disminuya los costos y mejore el proceso de atención



Estudios publicados demuestran un aumento en la eficiencia con la implementación de la pulsioximetría Masimo SET® en todos los entornos clínicos

Con pulsioximetría Masimo SET®

no se requiere el uso de cables, la instalación es sencilla y no requiere de personal especializado. La instalación es sencilla y no requiere de personal especializado.

CARACTERÍSTICAS 3.3.5 DE LA FICHA HOMOLOGADA

3.3.5	Precisión	+/- 3% (+/- 3 dígitos) o menor, en el rango de 70 % a 100 %
-------	-----------	---


21/1

En el folio 134 y con las evidencias de su propuesta; el postor sustenta la PRECISIÓN de $\pm 3\%$ (+/- 3 DIGITOS) O MENOR, EN EL RANGO DE 70% A 100%, existe una incongruencia en su sustento, cuando menciona los valores en su catálogo, indica que su PRECISIÓN es "en condiciones sin movimiento", contradiendo el sustento de la existencia de la tecnología MASIMO, cabe precisar que cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el Comité de Selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones. Así pues, toda información contenida en la oferta técnica o económica, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad"










➤ Masimo SpO₂ 1.2

Medición de parámetro:	SpO ₂ , SpMet, PVI, SpHb, SpOC, PI y SpCO
Rango de medición	0% a 100% 3.3.4
Resolución	1%
Precisión	70% a 100%: $\pm 2\%$ (Adulto/Pediatric, en condiciones sin movimiento) 3.3.5 70% a 100%: $\pm 3\%$ (Neonato, en condiciones sin movimiento) 0% a 69%: sin especificar

La evaluación se sustenta en las Resoluciones: N° 1950-2019-TCE-S2 y N° 0235-2022-TCE-S4; donde se dice "... Al respecto, cabe precisar que cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el Comité de Selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones. Así pues, toda información contenida en la oferta técnica o económica, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad". (lo subrayado no es propio)



ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

1	NÚMERO DE ACTA	001-2023-CS- AS-HOMOLOGACIÓN N° 40-2023-GERESA/LL																														
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL <p>En, la ciudad de trujillo, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre del año 2023, en el local de la GERESALL, a las 12:30 pm horas, se reunieron los integrantes del COMITE DE SELECCION designados mediante Formato N° 04-2023-GERESA/LL , encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de AS-HOMOLOGACIÓN N° 40-2023 GERESA/LL , cuyo objeto de convocatoria es "IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO (18) INCUBADORA NEONATAL AVANZADA PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD". ITEM 5 IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DOS (02) VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO NEONATAL + ALTA FRECUENCIA PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD</p>																															
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER) <p>El quorum necesario que exige la normativa de contratación del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:</p> <table border="1"> <tr> <td>Presidente</td> <td>ECON. ANGEL DANIEL TEJADA NUÑEZ</td> <td>Titular X</td> <td>Dependencia:</td> <td>UTF-ABASTECIMIENTO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Suplente</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer Miembro</td> <td>ING.OSCAR IVAN DIAZ ARANA</td> <td>Titular X</td> <td>Dependencia:</td> <td>OFICINA DE PLANIFICACION</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Suplente</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Miembro</td> <td>ING. DAVID LUNA GRANDEZ</td> <td>Titular X</td> <td>Dependencia:</td> <td>OFICINA DE PLANIFICACION</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Suplente</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Presidente	ECON. ANGEL DANIEL TEJADA NUÑEZ	Titular X	Dependencia:	UTF-ABASTECIMIENTO			Suplente			Primer Miembro	ING.OSCAR IVAN DIAZ ARANA	Titular X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION			Suplente			Segundo Miembro	ING. DAVID LUNA GRANDEZ	Titular X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION			Suplente		
Presidente	ECON. ANGEL DANIEL TEJADA NUÑEZ	Titular X	Dependencia:	UTF-ABASTECIMIENTO																												
		Suplente																														
Primer Miembro	ING.OSCAR IVAN DIAZ ARANA	Titular X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION																												
		Suplente																														
Segundo Miembro	ING. DAVID LUNA GRANDEZ	Titular X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION																												
		Suplente																														
4	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO <p>De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:</p> <table border="1"> <tr> <th>Nombre o razón social del postor ganador</th> <th>Monto adjudicado</th> </tr> <tr> <td>NOVAMED PERU SAC</td> <td>S/ 432,000.00</td> </tr> </table>		Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado	NOVAMED PERU SAC	S/ 432,000.00																										
Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado																															
NOVAMED PERU SAC	S/ 432,000.00																															
5	BASE LEGAL <p>Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "Luego de la calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE".</p>																															
6	ACUERDO ADOPTADO <p>Los integrantes del COMITÉ DE SELECCION , por UNANIMIDAD, otorgan la buena pro al postor mencionado en el numeral 4.</p>																															
7	<table border="1"> <tr> <td>  Econ. Angel Daniel Tejada Nuñez Presidente Titular </td> <td>  ING.OSCAR IVAN DIAZ ARANA Primer Miembro </td> <td>  ING. DAVID LUNA GRANDEZ Segundo Miembro </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS </td> </tr> </table>		 Econ. Angel Daniel Tejada Nuñez Presidente Titular	 ING.OSCAR IVAN DIAZ ARANA Primer Miembro	 ING. DAVID LUNA GRANDEZ Segundo Miembro	NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS																										
 Econ. Angel Daniel Tejada Nuñez Presidente Titular	 ING.OSCAR IVAN DIAZ ARANA Primer Miembro	 ING. DAVID LUNA GRANDEZ Segundo Miembro																														
NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS																																

FORMATO N° 11
ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:

1 NÚMERO DE ACTA 001-2023-CS- AS-HOMOLOGACIÓN N°40-2023-GERESA/LL

2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En, las instalaciones de la oficina de UTF -ABASTECIMIENTO, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre del año 2023, en el local del Gerencia Regional de Salud de la Libertad , a las 12:00 pm horas, se reunieron los integrantes del comite designados mediante formato N° 004 AS-HOMOLOGACIÓN N°40-2023 GERESA/LL, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección AS HOMOLOGACIÓN N° 40-2023 GERESA/LL , cuyo objeto de convocatoria es "IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO (18) INCUBADORA NEONATAL AVANZADA PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", ITEM 5 IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DOS (02) VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO NEONATAL + ALTA FRECUENCIA PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, a fin de efectuar la APERTURA DE LAS OFERTAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	ECON. ANGEL DANIEL TEJADA NUÑEZ	Titular	X	Dependencia:	UTF-ABASTECIMIENTO
		Suplente			
Primer Miembro	ING. OSCAR IVAN DIAZ ARANA	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION
		Suplente			
Segundo Miembro	ING. DAVID LUNA GRANDEZ	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION
		Suplente			

4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU	20100162238
2	ALBUJAR MEDICA S.A.C.	20130329471
3	MEDELCO SRL	20208310730
4	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	20340116055
5	BIOLOGIAS MEDICAS ANDINAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20454094221
6	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	20494151503
7	ABAMEDIC S.R.L.	20502626931
8	HEMOCARE S.A.C.	20505463146
9	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20512709088
10	CARDIOMED DEL PERU SAC	20520987186
11	CORPORACION DACMAR S.A.C.	20529457554
12	DRAEGER PERU S.A.C.	20538597121
13	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	20545804795
14	ASECO PERU S.A.C.	20565911920
15	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	20565935861
16	VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.	20601325153
17	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -	20601571065
18	ADVANCED MEDICAL INC E.I.R.L.	20602703003
19	VPM PROVEEDORES S.R.L.	20602922597
20	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	20603355289
21	NOVAMED PERU S.A.C.	20604537372
22	GAESA MEDIC E.I.R.L.	20606094834
23	NIMAT MEDICAL S.A.C.	20608071521
24	MEDICALDIST S.A.C.	20608573373
25	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	20610815341

5 DETALLE DE LOS POSTORES

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron sus ofertas en la plataforma digital del SEACE :

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	NOVAMED PERU S.A.C.	15/11/2023	21:41:55
2	DRAEGER PERU S.A.C.	15/11/2023	22:38:49

6 Acto seguido, se procede con la apertura de las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.

7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
----	----------------------------------	---

1	DRAEGER PERU S.A.C.		NO CUMPLE Y SUSTENTA EL CUMPLIMIENTO DE EETT, PUESTO QUE ELLOS SUSTENTAN EN SU FOLIO 294, 295 Y 296	
---	---------------------	--	---	--

8	DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN			
De acuerdo con la revisión efectuada por el comité, así como el cumplimiento de las especificaciones del ingeniero equipador parte de este colegiado y validando su cumplimiento, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:				
Nº	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula		
1	NOVAMED PERU S.A.C.	ITEM 5 IIOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DOS (02) VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO NEONATAL + ALTA FRECUENCIA PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD LA LIBERTAD		

9	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS			
9.1	DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA			
Nº	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial	
1	NOVAMED PERU S.A.C.	S/ 432,000.00	99.63%	
9.2	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			
La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo 01 que forma parte de la presente Acta.				

10	PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES			
COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR				
10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1		NOVAMED PERU S.A.C.	
	FACTORES		PUNTAJES	
	PRECIO		70	
	PLAZO DE ENTREGA		20	
	MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		0	
	BONIFICACION MYPE		4.5	
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		94.5 PUNTOS	




11	CALIFICACIÓN			
Luego de culminada la evaluación, el Comité de selección determinó si el postor que obtuvo el primer lugar según los requisitos de				
11.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1		NOVAMED PERU S.A.C.	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR	X	
	B	CAPACIDAD LEGAL	X	
	C	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CUMPLE	

12	RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN			
De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo la buena pro, cumple con los requisitos de calificación establecidos en las bases:				
Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR			
1	NOVAMED PERU S.A.C.			
DE SER EL CASO INCLUIR:				
Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases:				
Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN		
1	XXXXXX	XXXXXXXXXX		

Que, mediante carta NOVAMED-COR-264/2023 de fecha 28 de noviembre de 2023, señala que "(...) debemos indicar que haciendo una evaluación de los costos a incurrir en el bien a contratar hemos considerado por esta ocasión hacer un reajuste en el precio de la oferta económica (...) PRECIO TOTAL REDUCIDO S/ 432, 000.00"

14	REDUCCIÓN DEL PRECIO DE LA OFERTA			
Nº	Nombre o razón social del postor	Aceptó reducción de su oferta		
1	NOVAMED PERU S.A.C.	Si	X	
		No		

15	ACUERDO ADOPTADO			
Los integrantes del comité de selección por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.				

15	  			
	Egoñ, Angel Daniel Tejeda Nuñez Presidente Titular ING. OSCAR VAN DIAZ ARANA Primer Miembro ING. DAVID LUNA GRANDEZ Segundo Miembro			
	NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			

NOVAMED-COR-264/2023

Lima, 28 de Noviembre del 2023

Señores
GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD
Presente.-

Atte.: **Lic. Angel Daniel Tejeda Nuñez**
Presidente de Comité de Selección

Ref.: **Reducción de la Oferta Económica**

Estimados Señores:

Por la presente, en respuesta a vuestra solicitud con carta N° 01-2023-CS sobre **REDUCCION DE OFERTA ECONOMICA**, en el proceso **Adjudicación Simplificada Homologación N° 40-2023-GERESALL ITEM N° 5**, debemos indicar que haciendo una evaluación de los costos a incurrir en el bien a contratar hemos considerado por esta ocasión hacer un reajuste en el precio de la oferta económica de la siguiente manera:

PRECIO REAJUSTADO


ITEM N°	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL OFERTADO S/	PRECIO TOTAL REDUCIDO S/
05	IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DOS (02) VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO NEONATAL + ALTA FRECUENCIA PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	02	436,000.00	432,000.00

Adjunto al presente, remitimos el **Anexo N° 6** debidamente firmada por nuestra Representante Legal.

Sin otro particular, quedamos como siempre atentos a sus gratas órdenes.

Atentamente,

NOVAMED PERÚ S.A.C.



Valeria Geraldine Valdiviezo Shaplama
GERENTE GENERAL

ANEXO N° 06**ITEM 5****PRECIO DE LA OFERTA**

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA HOMOLOGACIÓN N° 040-2023-GERESALL
Presente.-


De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

PRESTACION	DESCRIPCION	PRECIO TOTAL S/
PRINCIPAL	IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DOS (02) VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO NEONATAL + ALTA FRECUENCIA PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	428,000.00
	CAPACITACION	
ACCESORIAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	4,000.00
TOTAL S/		432,000.00

El precio de la oferta en **SOLES** incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos

NOVAMED PERÚ S.A.C.


Valeria Geraldine Valdiviezo Shaplama
GERENTE GENERAL

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

FORMATO N° 11																																																																																	
ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:																																																																																	
1	NÚMERO DE ACTA	001-2023-CS- AS-HOMOLOGACIÓN N°40-2023-GERESA/LL																																																																															
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En, las instalaciones de la oficina de UTF -ABASTECIMIENTO, a los veinte y siete (27) días del mes de noviembre del año 2023, en el local del Gerencia Regional de Salud de la Libertad , a las 02:30 pm horas, se reunieron los integrantes del comité designados mediante formato N° 004 AS-HOMOLOGACIÓN N°40-2023 GERESA/LL, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección AS-HOMOLOGACIÓN N° 40-2023 GERESA/LL , cuyo objeto de convocatoria es "IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO (18) INCUBADORA NEONATAL AVANZADA PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", ITEM 5 IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DOS (02) VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO NEONATAL + ALTA FRECUENCIA PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, a fin de efectuar la APERTURA DE LAS OFERTAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.																																																																																
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER) El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%;">Presidente</td> <td style="width: 30%;">ECON. ANGEL DANIEL TEJADA NUÑEZ</td> <td style="width: 10%;">Titular</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 10%;">Dependencia:</td> <td style="width: 10%;">UTF-ABASTECIMIENTO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Suplente</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer Miembro</td> <td>ING. OSCAR IVAN DIAZ ARANA</td> <td>Titular</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Dependencia:</td> <td>OFICINA DE PLANIFICACION</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Suplente</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Miembro</td> <td>ING. DAVID LUNA GRANDEZ</td> <td>Titular</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Dependencia:</td> <td>OFICINA DE PLANIFICACION</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Suplente</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Presidente	ECON. ANGEL DANIEL TEJADA NUÑEZ	Titular	X	Dependencia:	UTF-ABASTECIMIENTO			Suplente				Primer Miembro	ING. OSCAR IVAN DIAZ ARANA	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION			Suplente				Segundo Miembro	ING. DAVID LUNA GRANDEZ	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION			Suplente																																													
Presidente	ECON. ANGEL DANIEL TEJADA NUÑEZ	Titular	X	Dependencia:	UTF-ABASTECIMIENTO																																																																												
		Suplente																																																																															
Primer Miembro	ING. OSCAR IVAN DIAZ ARANA	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION																																																																												
		Suplente																																																																															
Segundo Miembro	ING. DAVID LUNA GRANDEZ	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION																																																																												
		Suplente																																																																															
4	DETALLE DE LOS PARTICIPANTES De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">N°</th> <th style="width: 60%;">Nombre o razón social del participante</th> <th style="width: 35%;">RUC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.</td><td>20100162238</td></tr> <tr><td>2</td><td>ALBUJAR MEDICA S.A.C.</td><td>20130329471</td></tr> <tr><td>3</td><td>MEDELCO SRL</td><td>20208310730</td></tr> <tr><td>4</td><td>TECNI - MED.SYSTEM. S.A.</td><td>20340116055</td></tr> <tr><td>5</td><td>BIOLOGIAS MEDICAS ANDINAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</td><td>20454094221</td></tr> <tr><td>6</td><td>SALUD AMAZONICA E.I.R.L.</td><td>20494151503</td></tr> <tr><td>7</td><td>ABAMEDIC S.R.L.</td><td>20502626931</td></tr> <tr><td>8</td><td>HEMOCARE S.A.C.</td><td>20505463146</td></tr> <tr><td>9</td><td>CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</td><td>20512709088</td></tr> <tr><td>10</td><td>CARDIOMED DEL PERU SAC</td><td>20520987186</td></tr> <tr><td>11</td><td>CORPORACION DACMAR S.A.C.</td><td>20529457554</td></tr> <tr><td>12</td><td>DRAEGER PERU S.A.C.</td><td>20538597121</td></tr> <tr><td>13</td><td>GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C</td><td>20545804795</td></tr> <tr><td>14</td><td>ASECO PERU S.A.C.</td><td>20565911920</td></tr> <tr><td>15</td><td>IMPORTACIONES VASMED S.A.C.</td><td>20565935861</td></tr> <tr><td>16</td><td>VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.</td><td>20601325153</td></tr> <tr><td>17</td><td>JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK</td><td>20601571065</td></tr> <tr><td>18</td><td>ADVANCED MEDICAL INC E.I.R.L.</td><td>20602703003</td></tr> <tr><td>19</td><td>VPM PROVEEDORES S.R.L.</td><td>20602922597</td></tr> <tr><td>20</td><td>CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.</td><td>20603355289</td></tr> <tr><td>21</td><td>NOVAMED PERU S.A.C.</td><td>20604537372</td></tr> <tr><td>22</td><td>GAESA MEDIC E.I.R.L.</td><td>20606094834</td></tr> <tr><td>23</td><td>NIMAT MEDICAL S.A.C.</td><td>20608071521</td></tr> <tr><td>24</td><td>MEDICALDIST S.A.C.</td><td>20608573373</td></tr> <tr><td>25</td><td>ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD</td><td>20610815341</td></tr> </tbody> </table>			N°	Nombre o razón social del participante	RUC	1	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	20100162238	2	ALBUJAR MEDICA S.A.C.	20130329471	3	MEDELCO SRL	20208310730	4	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	20340116055	5	BIOLOGIAS MEDICAS ANDINAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20454094221	6	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	20494151503	7	ABAMEDIC S.R.L.	20502626931	8	HEMOCARE S.A.C.	20505463146	9	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20512709088	10	CARDIOMED DEL PERU SAC	20520987186	11	CORPORACION DACMAR S.A.C.	20529457554	12	DRAEGER PERU S.A.C.	20538597121	13	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	20545804795	14	ASECO PERU S.A.C.	20565911920	15	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	20565935861	16	VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.	20601325153	17	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK	20601571065	18	ADVANCED MEDICAL INC E.I.R.L.	20602703003	19	VPM PROVEEDORES S.R.L.	20602922597	20	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	20603355289	21	NOVAMED PERU S.A.C.	20604537372	22	GAESA MEDIC E.I.R.L.	20606094834	23	NIMAT MEDICAL S.A.C.	20608071521	24	MEDICALDIST S.A.C.	20608573373	25	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	20610815341
N°	Nombre o razón social del participante	RUC																																																																															
1	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	20100162238																																																																															
2	ALBUJAR MEDICA S.A.C.	20130329471																																																																															
3	MEDELCO SRL	20208310730																																																																															
4	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	20340116055																																																																															
5	BIOLOGIAS MEDICAS ANDINAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20454094221																																																																															
6	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	20494151503																																																																															
7	ABAMEDIC S.R.L.	20502626931																																																																															
8	HEMOCARE S.A.C.	20505463146																																																																															
9	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20512709088																																																																															
10	CARDIOMED DEL PERU SAC	20520987186																																																																															
11	CORPORACION DACMAR S.A.C.	20529457554																																																																															
12	DRAEGER PERU S.A.C.	20538597121																																																																															
13	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	20545804795																																																																															
14	ASECO PERU S.A.C.	20565911920																																																																															
15	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	20565935861																																																																															
16	VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.	20601325153																																																																															
17	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK	20601571065																																																																															
18	ADVANCED MEDICAL INC E.I.R.L.	20602703003																																																																															
19	VPM PROVEEDORES S.R.L.	20602922597																																																																															
20	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	20603355289																																																																															
21	NOVAMED PERU S.A.C.	20604537372																																																																															
22	GAESA MEDIC E.I.R.L.	20606094834																																																																															
23	NIMAT MEDICAL S.A.C.	20608071521																																																																															
24	MEDICALDIST S.A.C.	20608573373																																																																															
25	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	20610815341																																																																															
5	DETALLE DE LOS POSTORES En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron sus ofertas en la plataforma digital del SEACE : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 5%;">N°</th> <th style="width: 60%;">Nombre o razón social del postor</th> <th style="width: 15%;">Fecha de presentación</th> <th style="width: 20%;">Hora de presentación</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>NOVAMED PERU S.A.C.</td> <td>15/11/2023</td> <td>21:41:55</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DRAEGER PERU S.A.C.</td> <td>15/11/2023</td> <td>22:38:49</td> </tr> </table>			N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación	1	NOVAMED PERU S.A.C.	15/11/2023	21:41:55	2	DRAEGER PERU S.A.C.	15/11/2023	22:38:49																																																																		
N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación																																																																														
1	NOVAMED PERU S.A.C.	15/11/2023	21:41:55																																																																														
2	DRAEGER PERU S.A.C.	15/11/2023	22:38:49																																																																														
6	Acto seguido, se procede con la apertura de las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la																																																																																
7	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 5%;">N°</th> <th style="width: 60%;">Nombre o razón social del postor</th> <th style="width: 35%;">Consignar las razones para su no admisión</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>			N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión																																																																											
N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión																																																																															

	1	DRAEGER PERU S.A.C.	NO CUMPLE Y SUSTENTA EL CUMPLIMIENTO DE EETT, PUESTO QUE ELLOS SUSTENTAN EN SU FOLIO 294, 295 Y 296	
--	---	---------------------	---	--

8	DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN			
	De acuerdo con la revisión efectuada por el comité, así como el cumplimiento de las especificaciones del ingeniero equipador parte de este			
	Nº	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula	
	1	NOVAMED PERU S.A.C.	ITEM 5 IIOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DOS (02) VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO NEONATAL + ALTA FRECUENCIA PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTADNTO LA LIBERTAD	




9	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS			
	9.1	DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA		
	Nº	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
	1	NOVAMED PERU S.A.C.	S/ 436,000.00	100.55%
	9.2	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		
	La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo 01 que forma parte de la presente Acta.			

10	PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES			
	COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR			
	10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1	NOVAMED PERU S.A.C.	
		FACTORES		PUNTAJES
		PRECIO		70
		PLAZO DE ENTREGA		20
		MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS		0
	BONIFICACION MYPE		4.5	
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		94.5 PUNTOS	

11	CALIFICACIÓN			
	Luego de culminada la evaluación, el Comité de selección determinó si el postor que obtuvo el primer lugar según los requisitos de calificación			
	11.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1	NOVAMED PERU S.A.C.	
		REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR	X	
	B	CAPACIDAD LEGAL	X	
	C	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CUMPLE	

12	RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN			
	De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo la buena pro, cumple con los requisitos de calificación establecidos en las bases:			
	Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR		
	1	NOVAMED PERU S.A.C.		
	DE SER EL CASO INCLUIR:			
	Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases:			
	Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN	
1	xxxxxx	xxxxxxxxx		

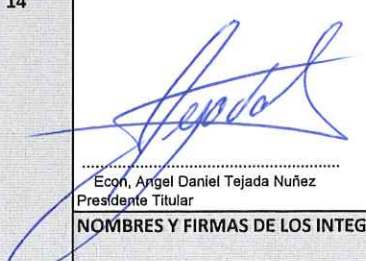13	ACUERDO ADOPTADO
	Los integrantes del comité de selección por UNANIMIDAD, remitir carta N° 01-2023-CS, traves de correo electronico a postor NOVAMED PERU SAC, con la finalidad que acepte la solicitud de reducción de oferta y posterior otorgamiento de Buena Pro, en razón al art 68° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

14	  		
	Econ. Angel Daniel Tejada Nuñez Presidente Titular	ING. OSCAR IVAN DIAZ ARANA Primer Miembro	ING. DAVID LUNA GRANDEZ Segundo Miembro
	NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES		

IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DOS (02) VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO NEONATAL + ALTA FRECUENCIA PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		02 UNIDADES	
MONTO DISPONIBLE		S/ 433,600.00	
POSTORES		NOVAMED PERU SAC	DRAGER
RUC		20604537372	20538597121
DOCUMENTOS PARA ADMISION DE OFERTAS ITEM 05			
DECLARACION JURADA DEL POSTOR ANEXO 01		CONFORME	CONFORME
COPIA CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL COPIA DE DNI	VIGENCIA PODER	CONFORME	CONFORME
DECLARACION JURADA ANEXO 2	ANEXO 02	CONFORME	CONFORME
DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 01	ANEXO 03	CONFORME	CONFORME
ACREDITACION DE ESPECIFICACIONES		CUMPLE	NO CUMPLE
CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELECTRICA		CONFORME	CONFORME
COPIA DEL CERTIFICADO ISO 13485		CONFORME	CONFORME
REGISTRO SANITARIO		CONFORME	CONFORME
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE ENTREGA	ANEXO 04	CONFORME-40 DIAS	CONFORME -65 DIAS
PROMESA DE CONSORCIO	ANEXO 05	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
PRECIO OFERTA	ANEXO 06	CONFORME	CONFORME
DOCUMENTACION DE PRESENTACION FACULTATIVA			
BONIFICACION DE MYPE	5%	CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
PUNTAJES			
VALOR OFERTA		S/ 436,000.00	S/ 336,000.40
% DEL VALOR DE OFERTA		100.55%	
PRECIO		70	
PLAZO DE ENTREGA		20	
MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS		0	
TOTAL FACTORES		90	
BONIFICACION MYPE		4.5	
PUNTAJE TOTAL		94.5	

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR REQUISITOS DE CALIFICACION		
EXPERIENCIA DEL POSTOR	CONFORME	CONFORME
CAPACIDAD LEGAL	CONFORME	CONFORME
CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL	CONFORME	CONFORME

AS Nº 040-2023-GERESALL
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 5		VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO NEONATAL + ALTA FRECUENCIA		
POSTOR 1		DRAEGER PERU SAC		
POSTOR 2		NOVAMED PERU SAC		
		ESPECIFICACIONES TECNICAS		
A	CARACTERISTICAS/CONDICIONES	ESPECIFICACIONES	POSTOR 1	POSTOR 2
A01	BASE	RODABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO O FRENSOS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A02	PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO	VENTILACION CONTROLADA O LIMITADO POR PRESION	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A03	TIPO DE SINCRONIZACION	POR FLUIDO, COMO MINIMO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A04	VISUALIZACION DE GRAFICAS	DE ONDAS GRAFICAS Y LAZOS EN TIEMPO REAL	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A05	SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE MEDICINAL	INTEGRADO O INCORPORADO EN LA MISMA ESTRUCTURA DEL VENTILADOR	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A06	FUNCION/MANIOBRA/PROCEDIMIENTO ESPECIAL	RESPIRACION MANUAL O INSPIRACION MANUAL	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A07	CAPACIDAD DE SUMINISTRAR VOLUMENES TIDALES	DESDE 2ML O MENOS, HASTA 100 ML O MAS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A08	MONITOR (TAMAÑO DE PANTALLA)	10 PULGADAS COMO MINIMO (VEASE NOTA 2)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A09	FACILIDAD DE USO EN VENTILACION CONVENCIONAL A VENTILACION DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA HFO	CAMBIO DE MODO DE VENTILACION CONVENCIONAL A MODO DE VENTILACION ALTA FRECUENCIA Y VICEVERSA SIN NECESIDAD DE CAMBIAR EL CIRCUITO PACIENTE	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
MODALIDAD DE VENTILACION				
A10	ASISTIDO/CONTROLADO (MECANISMO DE ACCIONAMIENTO: TRIGGER POR FLUIDO COMO MINIMO)		SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A11	SIMV (VENTILACION MANDATORIA INTERMITENTE SINCRONIZADA)		SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A12	CPAP (PRESION POSITIVA CONTINUA EN LA VIA AEREA)		SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A13	VENTILACION DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA (HFO) CON VOLUMEN GARANTIZADO		SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A14	PRESION SOPORTE (PS)		SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A15	VOLUMEN GARANTIZADO (VOLUMEN ASEGURADO O VOLUMEN CONTROLADO O VOLUMEN LIMITE), CON REGULACION AUTOMATICA DE LA PRESION INSPIRATORIA		SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A16	VENTILACION NO INVASIVA		SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A17	COMPENSACION DE FUGAS		SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A18	TERAPIA DE OXIGENO DE ALTO FLUIDO		SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
CONTROLES CON PROGRAMACION DIRECTA				
A19	FRECUENCIA RESPIRATORIA (RESPIRACION MINUTO)	10 O MENOS A 100 O MAS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT

A20	FRACCION INSPIRATORIA (FIO2) %	21 A 100	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A21	TIEMPO INSPIRATORIO	0,1 S O MENOS, A 2 S O MAS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A22	PICO DE PRESION INSPIRATORIA	10CMH2O O MENOS, A 60CMH2O O MAS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A23	ALTA FRECUENCIA	5 HZ O MENOS, A 15HZ O MAS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A24	PRESION POSITIVA AL FINAL DE LA EXPIRACION (PEEP)	3CMH2O O MENOS, A 30CMH2O O MAS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A25	DISPARO	POR FLUJO COMO MINIMO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
MONITOREO DE PARAMETROS				
A26	FRECUENCIA RESPIRATORIA	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A27	PRESION PICO INSPIRATORIO (PIP)	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A28	PRESION MEDIA DE VIAS AEREAS O RESPIRATORIAS	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A29	VOLUMEN TIDAL (VT)	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A30	VOLUMEN MINUTO (VM)	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A31	PRESION POSITIVA AL FINAL DE LA EXPIRACION (PEEP)	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A32	FRACCION INSPIRATORIA DE OXIGENO (FIO2)	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A33	CAPNOGRAFIA DE USO NEONATAL (ETCO2)	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A34	DCO2	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A35	RELACION I:E	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
ALARMAS				
A36	ALTA PRESION DE VIAS AEREAS	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A37	BAJA PRESION DE VIAS AEREAS O DESCONEXION	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A38	APNEA	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A39	ALTO/BAJO VOLUMEN MINUTO	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A40	ALTA/BAJA CONCENTRACION DE OXIGENO	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A41	FALLA DE SUMINISTRO DE GASES	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A42	PRESION POSITIVA AL FINAL DE LA EXPIRACION	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A43	ALTA/BAJA ETCO2	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A44	RED ELECTRICA	DE FALLA ELECTRICA (RED Y/O BATERIA BAJA)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
COMPONENTES				
HUMIDIFICADOR PARA USO EN TRATAMIENTO INVASIVO Y NO INVASIVO				
B01	RANGO DE TEMPERATURA	31°C A 40°C O RANGO MAS AMPLIO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
B02	TEMPERATURA DE VIAS AEREAS	VISUALIZACION DE TEMPERATURA DE VIAS AEREAS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT

B03	TEMPERATURA DE SALIDA DE CAMARA	VISUALIZACION DE TEMPERATURA DE LA CAMARA	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
B04	CALENTADOR	TIPO HILO-CALENTE	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
B05	SILENCIADOR DE ALARMA	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
B06	ALARMA DE TEMPERATURA Y/O HUMEDAD	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
CARACTERISTICAS		ESPECIFICACION		
C01	JUEGO COMPLETO DE CIRCUITO PACIENTE NEONATAL, PARA TODOS LOS MODOS DE HUMIDIFICACION	VENTILATORIOS, REUSABLE - ESTERILIZABLE (INCLUYE CAMARA DE HUMIDIFICACION)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
CANTIDAD		CINCO (05)		
C02	JUEGO COMPLETO DE CIRCUITO PACIENTE NEONATAL, PARA TODOS LOS MODOS DE AUTOLLENADO Y CALENTAMIENTO EN AMBAS RAMAS INSPIRATORIO Y EXPIRATORIO	VENTILATORIOS DESCARTABLE (CON CAMARA DE HUMIDIFICACION, CON SISTEMA	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
CANTIDAD		VEINTE (20)		
C03	JUEGO COMPLETO PARA VENTILACION NO INVASIVA DESCARTABLE (GORROS, INTERFACE O GENERADOR O ADAPTADOR O CORRUGADO, (TRES (03) MASCARILLAS DE TAMAÑOS: S, M, L; TRES (03) PRONG NASAL DE TAMAÑOS S, M, L)		CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
CANTIDAD		SEIS (06)		
C04	CANULA PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO DE TRES TAMAÑOS DIFERENTES (DOS (02) S, DOS (02) M, DOS (02) L)		CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
CANTIDAD		SEIS (06)		
C05	PULMONES DE PRUEBA NEONATAL		CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
CANTIDAD		DOS (02)		
C06	BRAZO SOPORTE DE CIRCUITO PACIENTE	ARTICULADO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
CANTIDAD				
C07	MANGUERAS DE OXIGENO Y DE AIRE MEDICINAL	TIPO DISS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
CANTIDAD				
C08	NEBULIZADOR CON ACCESORIOS COMPLETOS	MICROBOMBA O ULTRASONICO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
CANTIDAD				
C09	SENSOR DE FLUJO (VEASE NOTA 3)			
TIPO		REUSABLE, ESTERILIZABLE	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
CANTIDAD		DOCE (12)		
C10	JUEGOS DE CABLES PARA EL CALENTADOR PARA USO EN CIRCUITO REUSABLE (SENSOR DE TEMPERATURA Y CABLE ADAPTADOR)		CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
CANTIDAD		DOS (02)		
C11	CABLE ADAPTADOR PARA EL CALENTADOR PARA USO EN CIRCUITO DESCARTABLE (DOBLE RAMA)		CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
CANTIDAD		DOS (02)		
C12	VALVULAS DE EXHALACION COMPLETAS O CASSETTE ESPIRATORIO		CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT

TIPO	REUSABLE – ESTERILIZABLE			
CANTIDAD	TRES (03)			
C13 ESTABILIZADOR DE VOLTAJE (VEASE NOTA 4)				
TIPO	ESTADO SOLIDO CON LINEA A TIERRA		CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
RANGO DE VARIACION DE LA TENSION ELECTRICA DE SALIDA	MENOR O IGUAL A +/- 3%			
POTENCIA	SUPERIOR EN 25% O MAS DE LA POTENCIA NOMINAL DEL EQUIPO Y COMPONENTE			
C14 BATERIA(S) INTERNA RECARGABLE(S)			NO CUMPLE Y SUSTENTA EL CUMPLIMIENTO DE EETT, PUESTO QUE ELLOS SUSTENTAN EN SU POLO 294, 295 Y 296	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
AUTONOMIA	DOS (02) HORAS O MAYOR			
C15 REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES				
REQUISITOS DEPENDIENTES DEL CONTEXTO	ALTITUD: HASTA 3000 MENOR O MAYOR		CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
D01	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	Cumplir con lo establecido en la subregla 2, Regla 020-500 del código de la referencia.	Código nacional de electricidad-utilización aprobado por resolución ministerial N° 037-2006-MEM/DM	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
D02	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	Cumplir con lo establecido en la regla 020-502 del código de la referencia	Código nacional de electricidad-utilización aprobado por resolución ministerial N° 037-2006-MEM/DM	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
D03	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	1.- cumplir con la aplicación del diagrama 1 del artículo 2 del	1.- R.M. N°175-2008-MEM/DM	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
		2.- cumplir con los requerimientos establecidos en el momento.	2.- NTP IEC60884 -1:2013(revisa el 2018) enchufes y tomacorrientes para uso doméstico y propósitos similares, parte 1: requerimientos generales.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
	MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS			
1	TECNICA DE OSCILACION FORZADA (FOT) Y VENTILACION NO INVASIVA CON FLUJO VARIABLE A DEMANDA		NO CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
2	HERRAMIENTA DE VIGILANCIA DE LA DINAMICA VENTILATORIA DEL PACIENTE QUE MUESTRE DE MANERA GRAFICA LOS CAMBIOS EN LA COMPLIANCE Y RESISTENCIA EN TIEMPO REAL, ADEMAS DE EL MOVIMIENTO DEL DIAFRAGMA COMO RESPIRACIONES ESPONTANEAS DEL PACIENTE Y LA PROPORCION DE TRABAJO RESPIRATORIO DEL PACIENTE Y DEL VENTILADOR		CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	NO CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT

POSTOR 1: DRAEGER PERU SA	NO CUMPLE, NO SE VALIDA PROPUESTA TECNICA PRESENTADA
POSTOR 2: NOVAMED PERU SAC	CUMPLE, SE VALIDA PROPUESTA TECNICA PRESENTADA

CARACTERISTICA DE FICHA HOMOLOGADA:

POSTOR: DRAEGER PERU SAC

De la evaluación de la propuesta presentada de manera integral y en cumplimiento de la presentación de documentos obligatorios según lo requerido en las bases integradas:

No cumple con sustento técnico de las características solicitadas, debido a la siguiente divergencia y omisión en la propuesta, las cuales no son subsanables dado que una modificación en ese supuesto impacta en los términos en los que se encuentra expresada una oferta y con ello, en el contenido esencial de esta y que a continuación se detallan.

CARATERISTICA DE FICHA HOMOLOGADA:

POSTOR: DRAEGER PERU SAC

De la evaluación de la propuesta presentada de manera integral y en cumplimiento de la presentación de documentos obligatorios según lo requerido en las bases integradas:

No cumple con sustento técnico de las características solicitadas, debido a la siguiente divergencia y omisión en la propuesta, las cuales no son subsanables dado que una modificación en ese supuesto impacta en los términos en los que se encuentra expresada una oferta y con ello, en el contenido esencial de esta y que a continuación se detallan

CARACTERÍSTICAS A32 DE LA FICHA HOMOLOGADA

C14. Batería(s) interna recargable(s)	
Autonomía	Dos (02) horas o mayor

DE ACUERDO A LAS BASES INTEGRADAS EL CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACION TECNICA C14 "BATERIAS INTERNA RECARGABLE(S): DOS (02) HORAS O MAYOR" señalamos que se solicita que el ventilador tenga una batería INTERNA y con dos horas de batería, DEL FOLIO 294 de la oferta es una transcripción de la especificación técnica solicitada de las bases integradas del proceso. DEL FOLIO 295 menciona el postor que tiene dos tipos de baterías siendo la GS500 Con autonomía de 30 minutos, DEL FOLIO 296 se aprecia la configuración y componentes del equipo ofertado siendo donde el componente N° 2 indica a el ventilador y el componente

Nº4 menciona **PS500 UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACION** del mismo indica claramente que la batería es externa. De tal forma el postor no cumple las especificaciones técnicas mínimas solicitadas en las bases del proceso.

La evaluación se sustenta en las Resoluciones: N° 1950-2019-TCE-S2 y N° 0235-2022-TCE-S4; donde se dice "... **Al respecto, cabe precisar que cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el Comité de Selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones. Así pues, toda información contenida en la oferta técnica o económica, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad**". (lo subrayado no es propio)

Al respecto, como parte de la documentación obligatoria de las bases integradas se ha requerido la presentación "FORMATO N°01 "Hoja de presentación del equipo/ sustento de cumplimientos de características técnicas" mediante el cual, los postores deben demostrar fehacientemente que el bien ofertado cumplió con las especificaciones técnicas y características técnicas solicitadas.

" Por el contrario, de presentarse una oferta profusa, difusa y confusa, imposibilitando al comité de selección determinar fehacientemente el real alcance de la misma, este deberá no admitirla o descalificarla, según corresponda, pues no es función de dicho órgano interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, o precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado, en función a las condiciones expresamente detalladas, sin posibilidad, como se indicó, de inferir o interpretar hecho alguno.

Teniendo en cuenta lo señalado párrafos anteriores, se procesó a revisar los folios señalados por el postor para dar cumplimiento a las características técnicas, el cual el postor **DRAEGER PERU SAC** no cumple con las especificaciones técnicas mínima solicitadas en el proceso de selección.