

**FORMATO N° 11**  
**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:**

**1 NÚMERO DE ACTA**

001-2023-CS- AS-HOMOLOGACIÓN N°40-2023-GERESA/LL

**2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL**

En las instalaciones de la oficina de UTF -ABASTECIMIENTO, a los veintisiete(27) días del mes de noviembre del año 2023, en el local del Gerencia Regional de Salud de la Libertad , a las 02:30 pm horas, se reunieron los integrantes del comite designados mediante formato N° 004 AS-HOMOLOGACIÓN N°40-2023 GERESA/LL, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección AS-HOMOLOGACIÓN N° 40-2023 GERESA/LL , cuyo objeto de convocatoria es "IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO (18) INCUBADORA NEONATAL AVANZADA PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", ITEM 1 - IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO (18) INCUBADORA NEONATAL AVANZADA PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD a fin de efectuar la APERTURA DE LAS OFERTAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.

**3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)**

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	ECON. ANGEL DANIEL TEJADA NUÑEZ	Titular	X	Dependencia:	UTF-ABASTECIMIENTO
		Suplente			
Primer Miembro	ING. OSCAR IVAN DIAZ ARANA	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION
		Suplente			
Segundo Miembro	ING. DAVID LUNA GRANDEZ	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION
		Suplente			

**4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES**

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	20100162238
2	ALBUJAR MEDICA S.A.C.	20130329471
3	MEDELCO SRL	20208310730
4	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	20340116055
5	BIOLOGIAS MEDICAS ANDINAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20454094221
6	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	20494151503
7	ABAMEDIC S.R.L.	20502626931
8	HEMOCARE S.A.C.	20505463146
9	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20512709088
10	CARDIOMED DEL PERU SAC	20520987186
11	CORPORACION DACMAR S.A.C.	20529457554
12	DRAEGER PERU S.A.C.	20538597121
13	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	20545804795
14	ASECO PERU S.A.C.	20565911920
15	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	20565935861
16	VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.	20601325153
17	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	20601571065
18	ADVANCED MEDICAL INC E.I.R.L.	20602703003
19	VPM PROVEEDORES S.R.L.	20602922597
20	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	20603355289
21	NOVAMED PERU S.A.C.	20604537372
	GAESA MEDIC E.I.R.L.	20606094834
	NIMAT MEDICAL S.A.C.	20608071521
	MEDICALDIST S.A.C.	20608573373
	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20610815341

**5 DETALLE DE LOS POSTORES**

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron sus ofertas en la plataforma digital del SEACE :

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	NOVAMED PERU S.A.C.	15/11/2023	21:41:55
1	DRAEGER PERU S.A.C.	15/11/2023	22:38:49

**6** Acto seguido, se procede con la apertura de las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.

**7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS**

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
----	----------------------------------	---



1	DRAEGER PERU S.A.C.	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE LO SOLICITADO EN LA EETT (SE SOLICITA BALANZA ELECTRONICA INTEGRADA AL EQUIPO; POSTOR SUSTENTA CON FOLIOS 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486 Y EN FOLIO 482 DICE: SE CONECTA A LA COLUMNA PRINCIPAL DE ALIMENTACION ELECTRICA Y FOLIO 483: PARA PERU, SE USA EL CABLE DE ALIMENTACION ELECTRICA TIPO NEMA 5-15p (INCORPORADO).  NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE LO SOLICITADO EN LA EETT (POSTOR SUSTENTA REQUERIMIENTO CON FOLIOS 506 AL 516, DONDE SE EVIDENCIA QUE LA UNIDAD DE RESUCITACION Y/O REANIMACION: CON SISTEMA DE ASPIRACION, MEZCLADOR DE AIRE/02 (BLENDER) Y MANÓMETRO COMO MÍNIMO, INTEGRADOS O INCORPORADOS EN LA UNIDAD, CON VÁLVULA DE PIEZA EN T; NO ES COMPACTA
---	---------------------	--

8	<b>DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN</b> De acuerdo con la revisión efectuada por el comité, así como el cumplimiento de las especificaciones del ingeniero equipador parte de este colegiado y validando su cumplimiento, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:	
	Nº	Nombre o razón social del postor
	1	NOVAMED PERU S.A.C.
		Item(s) a los que postula  ITEM 1 - IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO (18) INCUBADORA NEONATAL AVANZADA PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

9	<b>EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS</b>		
	9.1	<b>DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA</b>	
	Nº	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta
	1	NOVAMED PERU S.A.C.	S/ 2,790,000.00
	9.2	<b>DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS</b> La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo 01 que forma parte de la presente Acta.	
			% del valor referencial 99.35%

10	<b>PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES</b> COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR		
	10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1	NOVAMED PERU S.A.C.
		FACTORES	PUNTAJES
		PRECIO	70.00
		PLAZO DE ENTREGA	20
		MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	0
		BONIFICACION MYPE	—
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	90 PUNTOS

11	<b>CALIFICACIÓN</b> Luego de culminada la evaluación, el Comité de selección determinó si el postor que obtuvo el primer lugar según los requisitos de calificación detallados en las bases:		
	12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1	NOVAMED PERU S.A.C.
		REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE NO CUMPLE
		A EXPERIENCIA DEL POSTOR	X
		B CAPACIDAD LEGAL	X
		C CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL	X
		RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN	CUMPLE

12	<b>RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN</b> De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo la buena pro, cumple con los requisitos de calificación establecidos en las bases:	
	Nº	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
	1	NOVAMED PERU S.A.C.
	DE SER EL CASO INCLUIR:	
	Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases:	
	Nº	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR
	1	xxxxxxx
		CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN xxxxxxx

18	<b>ACUERDO ADOPTADO</b> Los integrantes del comité de selección por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.	
----	--	--

19	 Econ. Angel Daniel Tejada Nuñez Presidente Titular  ING. OSCAR IVAN DIAZ ARANA Primer Miembro  ING. DAVID LUNA GRANDEZ Segundo Miembro	
	NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	



¿IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO (18) INCUBADORA NEONATAL AVANZADA PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿		18 UNIDADES	
MONTO DISPONIBLE		S/ 2,808,000.00	
POSTORES	NOVAMED PERU S.A.C.	DRAEGER PERU S.A.C.	
RUC	20604537372	20538597121	
DOCUMENTOS PARA ADMISION DE OFERTAS ITEM 01			
DECLARACION JURADA DEL POSTOR ANEXO 01	ANEXO 01	CONFORME	CONFORME
COPIA CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL COPIA DE DNI	VIGENCIA PODER	CONFORME	CONFORME
DECLARACION JURADA ANEXO 2	ANEXO 02	CONFORME	CONFORME
DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 01	ANEXO 03	CONFORME	CONFORME
ACREDITACION DE ESPECIFICACIONES		CUMPLE	NO CUMPLE
CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELECTRICA		CONFORME	CONFORME
COPIA DEL CERTIFICADO ISO 13485		CONFORME	CONFORME
REGISTRO SANITARIO		CONFORME	CONFORME
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE ENTREGA	ANEXO 04	CONFORME-30 DIAS	CONFORME - 30 DIAS
PROMESA DE CONSORCIO	ANEXO 05	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
PRECIO OFERTA	ANEXO 06	CONFORME	CONFORME
DOCUMENTACION DE PRESENTACION FACULTATIVA			
BONIFICACION DE MYPE	5%	CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
PUNTAJES			
VALOR OFERTA		S/ 2,790,000.00	S/ 2,465,300.00
% DEL VALOR DE OFERTA		99.35%	
PRECIO		70	
PLAZO DE ENTREGA		20	
MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS		0	
TOTAL POR FACTORES		90	
BONIFICACION MYPE			
PUNTAJE TOTAL		90.00	
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR REQUISITOS DE CALIFICACION			
EXPERIENCIA DEL POSTOR		CUMPLE	
CAPACIDAD LEGAL		CUMPLE	
CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL		CUMPLE	



# AS N° 040-2023-GERESALL

## EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

### ITEM 1 INCUBADORA NEONATAL

POSTOR 1 DRAEGER PERUS SAC

POSTOR 2 NOVAMED PERU SAC

ESPECIFICACIONES TECNICAS			POSTOR 1	POSTOR 2
GENERALES				
01	CONTROL DE TEMPERATURA	MEDIANTE MICROPROCESADOR O MICROCONTROLADOR.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
02	TIPO DE PANTALLA	LCD (TFT) A COLOR	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
2.1	TAMAÑO DE PANTALLA	8" O MAYOR	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
2.2	VISUALIZACIÓN	TEMPERATURA (PIEL Y AIRE IMULTÁNEAMENTE), HUMEDAD RELATIVA Y PESO. COMO MÍNIMO.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
03	BASE	RODABLE, CON FRENSOS EN LAS CUATRO RUEDAS.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
04	NIVEL DE RUIDO DENTRO DEL HABITÁCULO.	MENOR O IGUAL A 45 DB	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
05	PUERTAS DE ACCESOS AL PACIENTE	CINCO (05) COMO MÍNIMO.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
06	CONTROL DE ALTURA	AJUSTABLE ELÉCTRICAMENTE.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
07	CAJÓN	UNO (01) COMO MÍNIMO.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
08	ACCESOS PARA TUBOS	PARA INFUSIÓN INTRAVENOSA U OTROS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
09	BANDEJA PARA PROCEDIMIENTOS DE RAYOS X	INTEGRADA AL EQUIPO (ACCESO SIN NECESIDAD DE MOVER AL NEONATO)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
10	MECANISMO DE INCLINACIÓN DEL COLCHÓN Y/O DE LA CÚPULA	DE 12 GRADOS COMO MÍNIMO O CAPACIDAD DE REALIZAR POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSA.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
11	CON DOBLE PARED O SISTEMA QUE EVITE CAMBIOS DE TEMPERATURA EN EL NEONATO	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
12	VISUALIZACIÓN DE TENDENCIAS GRÁFICAS	DE AL MENOS 24 HORAS.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
13	VELOCIDAD DE AIRE SOBRE EL COLCHÓN	0,35 M/S O MENOR.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
14	SISTEMA DE CONVERSIÓN A CUNA DE CALOR RADIANTE(SERVOCUNA)	CONTROL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO O MANUAL	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
15	CAPACIDAD DE UTILIZAR CALEFACTOR (MODO SERVOCUNA)	CON POTENCIA DE HASTA 100%	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA				
16	DE AIRE	AJUSTABLE DE 23°C O MENOS A 37°C O MÁS.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
17	DE PIEL	AJUSTABLE DE 35°C O MENOS A 37°C O MÁS (SERVOCONTROLADO).	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
18	LECTURA DIGITAL DE TEMPERATURA.	SI.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
SISTEMA DE CONTROL DE HUMEDAD (ACTIVA)				
19	HUMEDAD SERVOCONTROLADA	AJUSTABLE DE 40% O MENOS A 95% O MÁS.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
20	LECTURA DIGITAL DE HUMEDAD	SÍ.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT



<b>SISTEMA DE CONTROL DE OXIGENO</b>					
21	CONCENTRACION DE OXIGENO SERVOCONTROLADA	AJUSTABLE DE 22% O MENOS A 65% O MAS		CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
22	LECTURA DIGITAL DE OXIGENO	SI		CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
<b>SISTEMA DE PESAJE</b>					
23	BALANZA ELECTRONICA	INTEGRADA AL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FIEBACIENTEMENTE LO SOLICITADO EN LA EETT (SE SOLICITA BALANZA ELECTRONICA INTEGRADA AL EQUIPO; POSTOR SUSTENTA CON FOLIOS 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486 Y EN FOLIO 482 DICE: SE CONECTA A LA COLUMNA PRINCIPAL DE ALIMENTACION ELECTRICA Y FOLIO 483: PARA PERU, SE USA EL CABLE DE ALIMENTACION ELECTRICA TIPO NEMA 5-15P (INCORPORADO)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
24	CAPACIDAD MAXIMA DE MEDICION	7 KG O MAS		CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
25	RESOLUCION	10 GRAMOS O MENOS		CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
<b>SISTEMA DE ALARMAS AUDIOVISUALES</b>					
26	TEMPERATURA DE PIEL	ALTA Y BAJA		CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
27	TEMPERATURA DE AIRE	ALTA Y BAJA		CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
28	CONCENTRACION DE OXIGENO	ALTA Y BAJA		CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
29	DE FALLA DE ALIMENTACION ELECTRICA	SI.		CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
30	DE FALLA DE SENSORES.	SI.		CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
31	DE FALLA DEL SISTEMA DE VENTILACION O CIRCULACION DE AIRE.	SI.		CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
32	DE BAJO NIVEL O FALTA DE AGUA.	SI.		CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
<b>COMPONENTES (INCORPORADOS O INTEGRADOS)</b>					
33	UNIDAD DE RESUSCITACION Y/O REANIMACION	UNA (01), COMPACTA (CON SISTEMA DE ASPIRACION; MEZCLADOR DE AIRE/02 (BLENDER) Y MANOMETRO COMO MÍNIMO, INTEGRADOS O INCORPORADOS EN LA UNIDAD), CON VÁLVULA DE PIEZA EN T.	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FIEBACIENTEMENTE LO SOLICITADO EN LA EETT (POSTOR SUSTENTA REQUERIMIENTO CON FOLIOS 506 AL 516, DONDE SE EVIDENCIA QUE LA UNIDAD DE RESUSCITACION Y/O REANIMACION: CON SISTEMA DE ASPIRACION, MEZCLADOR DE AIRE/02 (BLENDER) Y MANOMETRO COMO MÍNIMO, INTEGRADOS O INCORPORADOS EN LA UNIDAD, CON VÁLVULA DE PIEZA EN T); NO ES COMPACTA	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
34	UNIDAD DE MONITORIZACION DE SATURACION DE OXIGENO (SP02)	UNA (01), CON DISEÑO QUE PERMITA RECHAZAR ARTEFACTOS DE MOVIMIENTO Y BAJA PERFUSION; TECNOLOGÍA DE EXTRACCION DE SEÑALES (O ALGORITMO DE PROCESAMIENTO DE SEÑALES).	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
35	SOPORTE PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES	UNO (01), GIRABLE O TIPO BANDEJA LATERAL.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
36	SOPORTE PARA INFUSION INTRAVENOSA	UNO (01), DE MATERIAL ANTICORROSIVO.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
37	RESERVORIO DE HUMEDAD	UNO (01), REMOVIBLE, CON CAPACIDAD DE 1000 ML O MAS O SUMINISTRO DE AGUA EXTERNO CON CONEXION AL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
38	LAMPARA DE LUZ BLANCA	UNA (01) TECNOLOGÍA LED, PARA PROCEDIMIENTOS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
39	UNIDAD DE FOTOTERAPIA	UNA (01) LAMPARA DE TECNOLOGÍA LED	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
40	SOPORTE PARA TUBOS DE VENTILADOR	UNO (01), DE MATERIAL ANTICORROSIVO.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT



ACCESORIOS (VEASE NOTA 1)				
41	COLCHONETAS	CUATRO (04), DE FÁCIL LAVADO Y DESINFECCIÓN, RADIOTRASPARENTE A LOS RAYOS X.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
42	SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL	TRES (03) REUSABLES O SESENTA (60) DESCARTABLES.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
43	CIRCUITO PACIENTE	DOS (02) JUEGOS REUSABLES O VEINTE (20) DESECHABLES PARA LA UNIDAD DE RESUSCITACIÓN Y/O REANIMACIÓN.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
44	SENSOR DE PULSOXIMETRÍA (NEONATAL)	SEIS (06), REUSABLES Y SIN RESORTES O PINZAS DE SUJECCIÓN.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
45	CASCOS CEFÁLICOS	TRES (03), DE DIFERENTES TAMAÑOS.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
46	FILTROS DE AIRE	CINCO (05) JUEGOS.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
47	MASCARILLA FACIAL NEONATAL	UNA (01), DE SILICONA REUSABLE O CUARENTA (40) DESCARTABLES.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
48	COBERTOR PARA PROTECCIÓN DE LUZ AL NEONATO	UNO (01), REUSABLE, PARA CUBRIR TODA LA INCUBADORA.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
SISTEMA DE ALIMENTACION DE ENERGIA				
49	VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO	220 VAC (NOMINAL)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
50	FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO	60 HZ.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
51	TIPO DE ENCHUFE	SCHUKO, 250V, 16 A.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT

La evaluación se sustenta en las Resoluciones: N° 1950-2019-TCE-S2 y N° 0235-2022-TCE-S4; donde se dice "... Al respecto, cabe precisar que cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el Comité de Selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones. Así pues, toda información contenida en la oferta técnica o económica, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad". (lo subrayado no es propio)

POSTOR 1: DRAEGER PERU SA	NO CUMPLE, NO SE VALIDA PROPUESTA TECNICA PRESENTADA
POSTOR 2: NOVAMED PERU SAC	CUMPLE, SE VALIDA PROPUESTA TECNICA PRESENTADA



**CARATERISTICA DE FICHA HOMOLOGADA:****POSTOR: DRAEGER PERU SAC**

De la evaluación de la propuesta presentada de manera integral y en cumplimiento de la presentación de documentos obligatorios según lo requerido en las bases integradas:

**No cumple con sustento técnico de las características solicitadas**, debido a la siguiente divergencia y omisión en la propuesta, las cuales no son subsanables dado que una modificación en ese supuesto impacta en los términos en los que se encuentra expresada una oferta y con ello, en el contenido esencial de esta y que a continuación se detallan.

**CARACTERÍSTICAS 23 DE LA FICHA HOMOLOGADA**

23	Balanza electrónica.	Integrada al equipo.	Establecido por el Ministerio
----	----------------------	----------------------	-------------------------------

En folio 482 con la evidencia de la propuesta del postor sustenta de la siguiente manera:

**Balanza**

Para medir el peso de los pacientes en la incubadora Babyleo TN500, se usa una balanza electrónica integrada. La balanza se conecta a la columna principal de alimentación eléctrica, así como al procedimiento de control de peso en la pantalla de usuario.

En folio 483, con la evidencia de la propuesta del postor sustenta de la siguiente manera:

**Cable de alimentación**

Para Perú, se usa el cable de alimentación tipo NEMA 5-15p

Con la información sustentada por el postor se demuestra que NO CUMPLE lo solicitado:

**BALANZA ELECTRONICA: INTEGRADA AL EQUIPO.**

**CARACTERÍSTICAS 33 DE LA FICHA HOMOLOGADA**


33	Unidad de resucitación y/o reanimación	Una (01), compacta (con sistema de aspiración, mezclador de aire/O2(blender) y manómetro como mínimo, integrados o incorporados en la unidad), con válvula de pieza en T.	Establecido por el Ministerio.
----	--	---	--------------------------------

En el folio 507 al 509 y con las evidencias de su propuesta; el postor sustenta con el reanimador Neopuff como dispositivo de reanimación manual por flujo de gas..., donde se evidencia: **Manómetro de calidad medica**: mide y muestra la presión con precisión...; **Nuevo control de PIP**: rango de ajuste mejorado...; **Salida de gas**: Permite una conexión fácil y segura a los circuitos con pieza en T de F&P....

## REANIMADOR PARA LACTANTES CON PIEZA EN T NEOPUFF™

Neopuff, el reanimador para lactantes con pieza en T de Fisher & Paykel Healthcare, es un dispositivo de reanimación fácil de usar, adecuado para salas de dilatación y salas de partos, unidades de neonatología, quirófanos, medios de transporte, unidades de cuidados especiales para lactantes y unidades de cuidados intensivos neonatales.

El reanimador para lactantes con pieza en T Neopuff es un dispositivo de reanimación manual por flujo de gas diseñado para suministrar a los lactantes respiraciones con un flujo previamente ajustado, con una presión inspiratoria pico (PIP) y con una presión espiratoria final positiva (PEEP).

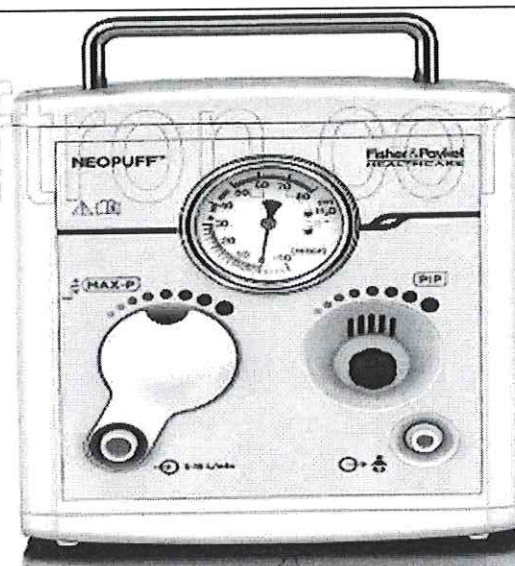

## Fácil De Usar

El nivel de experiencia, formación, concentración y fatiga del operador no afecta a la presión suministrada.

## Funcionamiento Flexible



El Neopuff puede admitir y suministrar concentraciones de oxígeno del 21% al 100% procedentes de un medidor de caudal o un mezclador. El circuito con pieza en T puede conectarse a una máscara de reanimación para lactantes o a un tubo endotraqueal.

## Suministro Preciso De Presión

El manómetro de indicación rápida permite asegurarse constantemente de la estanqueidad de la máscara, así como de la PIP y la PEEP suministradas.

## Asistencia Respiratoria Temporal Alternativa

Se puede suministrar una PEEP constante como asistencia respiratoria durante el transporte o el cambio del circuito de ventilación.

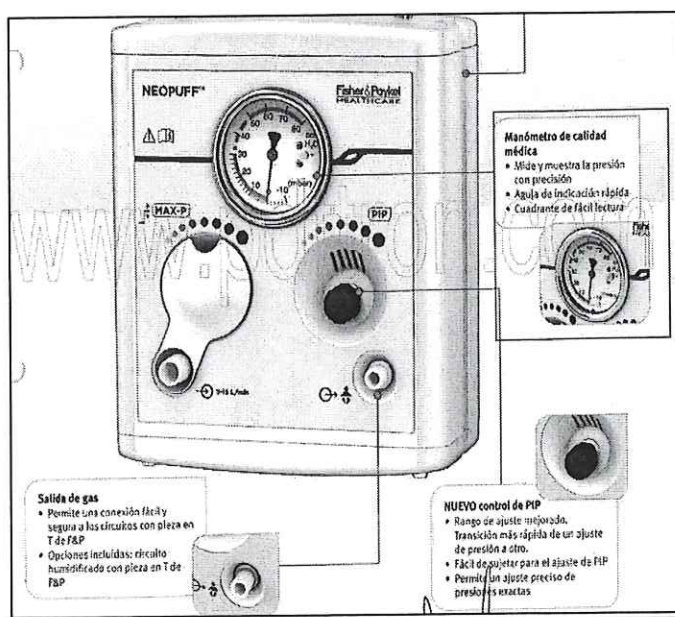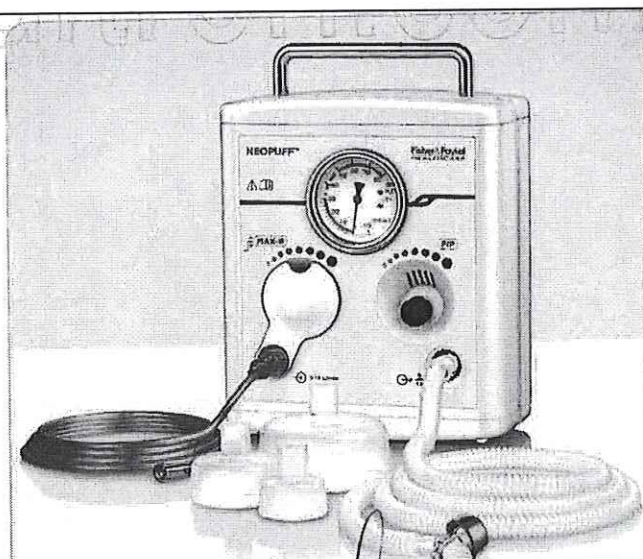




En el folio 511 y 512 y con las evidencias de su propuesta; el postor sustenta el accesorio: **VarioAir-Soluciones para aspiración clínica. Consumibles y accesorios.** Además, complementa con **Oxymixer: El Oxymixer permite de forma continua y personalizada la mezcla de aire y oxígeno de grado médico que se administra a bebés, niños y adultos....**

**VarioAir® - Soluciones para aspiración clínica Consumibles y accesorios**

Ya sea en el quírofano o en la unidad de cuidados intensivos, cuando hablamos de aspiración, necesitamos dispositivos de alto rendimiento, fáciles de manejar. Con las soluciones de aspiración VarioAir® se obtienen niveles de rendimiento, seguridad y calidad completamente nuevos.

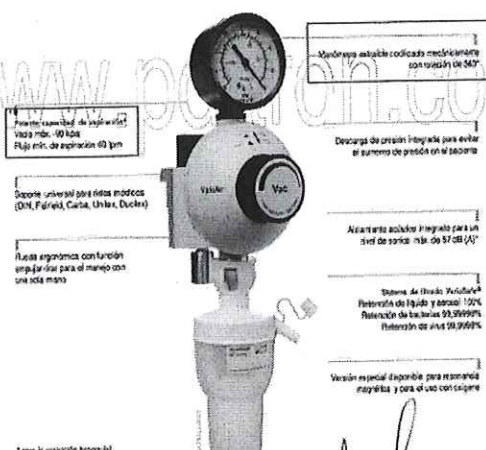


- Manómetro ajustable codificado mecánicamente con una escala de 0 a 100 mmHg
- Potencia máxima de aspiración: 100 l/min. Flujo mín. de aspiración 60 l/min
- Deposito universal para todos los endoscopios (DNI, Fagot, Curb, Uniflex, Ductus)
- Ruedas ergonómicas con función empujante para el manejo con una sola mano
- Descarga de presión integrada para evitar el aumento de presión en el paciente
- Alcance de succión integrado para un nivel de succión mín. de 57 cm (A)
- Sistema de filtrado VarioAir® Retención de líquidos y aerosol: 100% Retención de bacterias 99,99999% Retención de virus 99,9999%
- Versión especial disponible para resonancia magnética y para el uso con coágulo

\* para la aspiración bronquial

**Oxymixer**

El Oxymixer permite ajustar de forma continua y personalizada la mezcla de aire y oxígeno de grado médico que se administra a bebés, niños y adultos. La concentración de O<sub>2</sub> se ajusta fácilmente para alcanzar un flujo alto con precisión gracias al purgado, aun cuando se manejen velocidades de flujo inferiores a 3 l/min.




Con la información sustentada por el postor se demuestra que **NO CUMPLE** lo solicitado: **UNA (01), COMPACTA (CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN, MEZCLADOR DE AIRE/O2 (BLENDER) Y MANÓMETRO COMO MÍNIMO, INTEGRADOS O INCORPORADOS EN LA UNIDAD).**

#### CARACTERÍSTICAS 41 DE LA FICHA HOMOLOGADA

41	Colchonetas	Cuatro (04), de fácil lavado y desinfección, radiotransparente a los rayos X.	Establecido por el Ministerio
----	-------------	---	-------------------------------

Postor sustenta con folios 546, 547, 548, 549, 550, 551 y de la verificación se evidencia que al colchón no se puede realizar el procedimiento de "DESINFECCION". Sustento del postor:



**Colchón Softbed**

El colchón Softbed de Dräger aporta confort al paciente gracias al núcleo de espuma viscoelástica. El diseño considera las necesidades especiales de la piel sensible en desarrollo. El material blando minimiza las pérdidas de calor conductivas, lo que contribuye a un desarrollo positivo del recién nacido al evitarse el estrés por frío.

#### Colchón Dräger Softbed Consumibles y accesorios

Máxima comodidad para los pacientes más pequeños: gracias al relleno de espuma viscoelástica, el colchón Softbed biocompatible de Dräger proporciona una agradable sensación de descanso.

#### Lo importante está en el interior

En el corazón del Softbed se encuentra el relleno de espuma viscoelástica «Memory Foam Core». Se trata de una espuma especial desarrollada para la industria aeroespacial. Destaca sobre todo por su elasticidad y por recuperar su forma original una vez que el recién nacido ya no descansa en el colchón.

#### Gran calidad

El Softbed proporciona protección adicional a los pacientes más pequeños: el relleno de espuma ha sido fabricado con aceite de girasol inocuo, apto para uso sanitario. Tanto la biocompatibilidad probada como el cumplimiento de la normativa Öko-Tex garantizan seguridad adicional.

#### Porque el tiempo es oro

El manejo del Softbed no supone ningún esfuerzo adicional. La funda se limpia fácilmente y permite eliminar la suciedad de manera muy rápida. Además, en caso necesario, es posible quitarla completamente para lavarla. Solo hay que abrir la cremallera, protegida de la suciedad gracias a una solapa. Por supuesto, también es posible realizar radiografías a través del Softbed.


**C Colchón SoftBed,  
para Babyleo TN500, reutilizable,  
forro: 100 % poliuretano, tejido: 100 % poliéster**

#### Extracción del soporte de la cama

El soporte de la cama puede ser extraído del equipo por ambos lados, p. ej., para llevar a cabo el método canguro. Si la bandeja del colchón está inclinada o elevada, deje suficiente espacio por encima del paciente.

##### Procedimiento:

- 1 Bajar la bandeja del colchón y posicionarla horizontalmente.
- 2 Abrir uno de los dos paneles de acceso laterales.
- 3 Abrir la tapa abatible para rayos X.
- 4 Extraer el soporte de la cama por un lado del equipo utilizando los asideros empotrados (1).

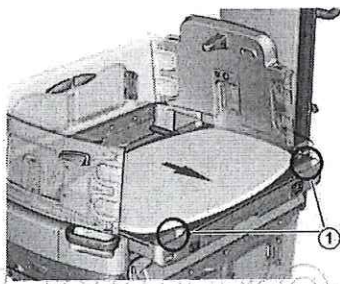

Imag. 27 Soporte de la cama con asideros empotrados

Con la información sustentada por el postor se demuestra que NO CUMPLE lo solicitado: **COLCHONETA: CUATRO (04), ... Y DESINFECCIÓN...**; lo cual es exigible en los equipos, componentes y/o accesorios de equipos médicos para ambientes de UCI Neonatología, para evitar las infecciones intrahospitalarias y siendo los equipos enfocados para pacientes Neonatos en estado inmunosuprimidos; y no cumpliendo lo solicitado, existe el riesgo antes mencionado (infecciones intrahospitalarias).



**FORMATO N° 11**  
**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:**

<b>1</b>	<b>NÚMERO DE ACTA</b>	001-2023-CS- AS-HOMOLOGACIÓN N°40-2023-GERESA/LL
----------	-----------------------	--

<b>2</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b>
En, las instalaciones de la oficina de UTF -ABASTECIMIENTO, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre del año 2023, en el local del Gerencia Regional de Salud de la Libertad , a las 02:30 pm horas, se reunieron los integrantes del comite designados mediante formato N° 004 AS-HOMOLOGACIÓN N°40-2023 GERESA/LL, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección AS-HOMOLOGACIÓN N° 40-2023 GERESA/LL , cuyo objeto de convocatoria es "IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO (18) INCUBADORA NEONATAL AVANZADA PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", ITEM 2 - IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE UNA (01) INCUBADORA NEONATAL DE TRANSPORTE PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD a fin de efectuar la APERTURA DE LAS OFERTAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.	

3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)					
	El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
	Presidente	ECON. ANGEL DANIEL TEJADA NUÑEZ	Titular	X	Dependencia:	UTF-ABASTECIMIENTO
			Suplente			
	Primer Miembro	ING. OSCAR IVAN DIAZ ARANA	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION
			Suplente			
	Segundo Miembro	ING. DAVID LUNA GRANDEZ	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION
			Suplente			

4

DETALLE DE LOS PARTICIPANTES		
De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:		
N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	20100162238
2	ALBUJAR MEDICA S.A.C.	20130329471
3	MEDELCO SRL	20208310730
4	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	20340116055
5	BIOLOGIAS MEDICAS ANDINAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20454094221
6	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	20494151503
7	ABAMEDIC S.R.L.	20502626931
8	HEMOCARE S.A.C.	20505463146
9	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20512709088
10	CARDIOMED DEL PERU SAC	20520987186
11	CORPORACION DACMAR S.A.C.	20529457554
12	DRAEGER PERU S.A.C.	20538597121
13	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	20545804795
14	ASECO PERU S.A.C.	20565911920
15	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	20565935861
16	VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.	20601325153
17	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK	20601571065
18	ADVANCED MEDICAL INC E.I.R.L.	20602703003
19	VPM PROVEEDORES S.R.L.	20602922597
20	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	20603355289
21	NOVAMED PERU S.A.C.	20604537372
	GAESA MEDIC E.I.R.L.	20606094834
	NIMAT MEDICAL S.A.C.	20608071521
	MEDICALDIST S.A.C.	20608573373
	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20610815341

5	DETALLE DE LOS POSTORES			
	En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron sus ofertas en la plataforma digital del SEACE :			
	N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
	1	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	15/11/2023	21:50:04
	2	ALBUJAR MEDICA S.A.C	15/11/2023	16:10:23



3	NIMAT MEDICAL S.A.C	15/11/2023	22:55:07
---	---------------------	------------	----------

6	Acto seguido, se procede con la apertura de las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.
---	---

7	<b>DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS</b>		
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:		
	Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
	1	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	NO SUSTENTA ESPECIFICACIONES TECNICAS, SE ADJUNTA EVALUACION TECNICA POR PARTE DE LOS INGENIEROS ESPECIALISTAS

8	<b>DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN</b>		
	De acuerdo con la revisión efectuada por el comité, así como el cumplimiento de las especificaciones del ingeniero equipador parte de este colegiado y validando su cumplimiento, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:		
	Nº	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
	1	ALBUJAR MEDICA S.A.C	ITEM 2- IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE UNA (01) INCUBADORA NEONATAL DE TRANSPORTE PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
	2	NIMAT MEDICAL S.A.C	ITEM 2- IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE UNA (01) INCUBADORA NEONATAL DE TRANSPORTE PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

9	<b>EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS</b>			
	9.1	<b>DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA</b>		
	Nº	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
	1	ALBUJAR MEDICA S.A.C	S/ 78,900.00	66.08%
	2	NIMAT MEDICAL S.A.C	S/ 77,500.00	64.91%
	9.2	<b>DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>		
		La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo 01 que forma parte de la presente Acta.		

10	<b>PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES</b>			
	COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR			
	10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1	ALBUJAR MEDICA S.A.C	
		FACTORES		PUNTAJES
		PRECIO		68.76
		PLAZO		20
		MEJORAS		10
		BONIFICACION MYPE		4.94
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		103.7 PUNTOS
	10.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1	NIMAT MEDICAL S.A.C	
		FACTORES		PUNTAJES
		PRECIO		70
		PLAZO		20
		MEJORAS		10
		BONIFICACION MYPE		5
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		105 PUNTOS

11	<b>RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN</b>		
	De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:		
	Nº DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
	1	NIMAT MEDICAL S.A.C	105
	2	ALBUJAR MEDICA S.A.C	103.7



12	<b>CALIFICACIÓN</b>			
	Luego de culminada la evaluación, el Comité de selección determinó si el postor que obtuvo el primer lugar según los requisitos de calificación detallados en las bases:			
	12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		NIMAT MEDICAL S.A.C
		REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE NO CUMPLE
		A	EXPERIENCIA DEL POSTOR	X
		B	CAPACIDAD LEGAL	X
		C	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL	X
		RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CUMPLE
	12.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		ALBUJAR MEDICA S.A.C
		REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE NO CUMPLE
		A	EXPERIENCIA DEL POSTOR	X
		B	CAPACIDAD LEGAL	X
		C	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL	X
		RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CUMPLE

13	<b>RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN</b>	
	De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo EL PRIMER LUGAR POR ORDEN DE PRELACION, cumple con los requisitos de calificación establecidos en las bases:	
	Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
	1	NIMAT MEDICAL S.A.C

DE SER EL CASO INCLUIR:

18	<b>ACUERDO ADOPTADO</b>
	Los integrantes del comité de selección por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.

19	  		
	Econ. Angel Daniel Tejada Nuñez Presidente Titular	ING. OSCAR IVAN DIAZ ARANA Primer Miembro	ING. DAVID LUNA GRANDEZ Segundo Miembro

**NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**

ITEM 2 IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE UNA (01) INCUBADORA NEONATAL DE TRANSPORTE PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		01 UNIDAD		
MONTO DISPONIBLE		S/ 119,400.00		
POSTORES		TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	ALBUJAR MEDICA S.A.C	NIMAT MEDICAL S.A.C.
RUC		20340116055	20130329471	20608071521
DOCUMENTOS PARA ADMISION DE OFERTAS ITEM 02				
DECLARACION JURADA DEL POSTOR ANEXO 01	ANEXO 01	CONFORME	CONFORME	CONFORME
COPIA CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL COPIA DE DNI	VIGENCIA PODER	CONFORME	CONFORME	CONFORME
DECLARACION JURADA ANEXO 2	ANEXO 02	CONFORME	CONFORME	CONFORME
DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 01	ANEXO 03	CONFORME	CONFORME	CONFORME
ACREDITACION DE ESPECIFICACIONES		NO CUMPLE	CONFORME	CONFORME
CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELECTRICA		CONFORME	CONFORME	CONFORME



CERTIFICAD O DE SEGURIDAD ELECTRICA		CONFORME	CONFORME	CONFORME
COPIA DEL CERTIFICAD O ISO 13485		CONFORME	CONFORME	CONFORME
REGISTRO SANITARIO		CONFORME	CONFORME	CONFORME
DECLARACI ON JURADA DE PLAZO DE ENTREGA	ANEXO 04	CONFORME-30 DIAS	CONFORME-20 DIAS	CONFORME-30 DIAS
PROMESA DE CONSORCI O	ANEXO 05	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
PRECIO OFERTA	ANEXO 06	CONFORME	CONFORME	CONFORME
DOCUMENTACION DE PRESENTACION FACULTATIVA				
BONIFICACI ON DE MYPE	5%	CONFORME	CONFORME	CONFORME
PUNTAJES				
VALOR OFERTA		S/ 76,200.00	S/ 78,900.00	S/ 77,500.00
% DEL VALOR DE OFERTA		63.82%	66.08%	64.91%
PRECIO			68.76	70.00
PLAZO			20	20
MEJORAS			10	10
TOTAL FACTORES			98.76	100.00
BONIFICACION MYPE			4.94	5.00
PUNTAJE TOTAL			103.70	105.00

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR REQUISITOS DE CALIFICACION			
EXPERIENCIA DEL POSTOR		CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD LEGAL		CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL		CUMPLE	CUMPLE

# AS Nº 040-2023-GERESALL

## EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

### ITEM 2 INCUBADORA DE TRANSPORTE

<b>POSTOR 1</b>		NIMAT MEDICAL S.A.C.			
<b>POSTOR 2</b>		TECNIMED SYSTEM S.A.			
<b>POSTOR 3</b>		ALBUJAR MEDICA S.A.C.			
Nº	CARACTERISTICAS	ESPECIFICACIONES	POSTOR 1	POSTOR 2	POSTOR 3
01	COCHE,	CON RUEDAS Y ALTURA AJUSTABLE.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
02	FIJADOR (RECEPTACULO) PARA EL SOPORTE DE INFUSION INTRAVENOSA	LOCALIZADO FUERA DE LA SUPERFICIE DEL CUERPO O HABITACULO DEL EQUIPO O ACORLADO DE MATERIAL METALICO.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
03	ACCESOS PARA MANOS E INTUBACION	CON DOS (02) O MAS VENTANAS O PUERTAS DE ACCESO PARA MANOS, Y UNA (01) VENTANA O PUERTA EN LA CABECERA PARA INTUBAR.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
04	ACCESOS PARA TUBOS.	DE INFUSION INTRAVENOSA, CIRCUITO PACIENTE U OTROS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
05	DOBLE PARED O SISTEMA QUE EVITE CAMBIOS DE TEMPERATURA EN EL NEOMATO	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
06	NIVEL DE RUIDO	MEJOR A 60 DB	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
<b>CONTROL / MONITOREO DE TEMPERATURA</b>					
07	CONTROL Y MONITOREO DE LA TEMPERATURA DE AIRE	AJUSTABLE DE 30°C O MENOS A 38°C O MÁS.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
08	CONTROL Y/O MONITOREO DE LA TEMPERATURA DE PIEL	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
09	LECTURA DIGITAL DE TEMPERATURA	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
10	SEÑALIZADOR DE CARGA DE BATERÍA.	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
<b>CONTROL DE % OXIGENO</b>					



11	TIPO DE CONTROL	PASIVO O SERVOCONTROLADO.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
<b>ALARMAS</b>					
12	DE ALTA TEMPERATURA (LÍMITE DE SEGURIDAD).	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
13	DE FALLA DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN O CIRCULACIÓN DE AIRE.	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
14	DE BATERÍA BAJA Y/O FALLA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
15	DE FALLA DEL SENSOR	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
<b>COMPONENTES (INCORPORADOS O INTEGRADOS A LA INCUBADORA)</b>					
16	ANALIZADOR O MONITOR DE OXÍGENO AMBIENTAL.	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
17	PULSÓXÍMETRO	CON DISEÑO QUE PERMITA RECHAZAR ARTEFACTOS DE MOVIMIENTO Y BAJA PERFUSIÓN CON TECNOLOGÍA DE EXTRACCIÓN DE SEÑALES O ALGORITMO DE PROCESAMIENTO DE SEÑALES CARDIACAS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
18	UNIDAD DE RESUSCITACIÓN Y/O REANIMACIÓN	UNA (01), COMPACTA Y/O SISTEMA COMPACTO DE VENTILACIÓN (CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN, MEZCLADOR DE AIRE/O2(BLENDER) Y MANÓMETRO COMO MÍNIMO, INTEGRADOS O INCORPORADOS EN LA UNIDAD).	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
19	SOPORTE PARA EQUIPO DE INFUSIÓN.	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
20	SOPORTE PARA MONITOR	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
21	CILINDROS DE OXÍGENO TIPO E	DOS (02), DE ALUMINIO, CADA; UNO CON VÁLVULA TIPO PIN INDEX, REGULADOR DE PRESIÓN CON MANÓMETRO Y FLUJÓMETRO, CADA REGULADOR DEBE TENER DOS SALIDAS: UNA DE 50 PSI Y LA OTRA DE FLUJO REGULABLE (AMBOS CILINDROS, FIADOS AL EQUIPO).	NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SOLICITADA, EL REGULADOR NO CUENTA CON LA SALUDAD DE 50 PSI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT

22	CILINDRO PARA AIRE COMPIMIDO TIPO E	UNO (01), DE ALUMINIO, CON VÁLVULA TIPO PIN INDEX, REGULADOR DE PRESIÓN CON MANÓMETRO Y FLUJÓMETRO, EL REGULADOR DEBE TENER DOS SALIDAS: UNA DE 50 PSI Y LA OTRA DE FLUJO REGULABLE O COMPRESOR DE AIRE INTEGRADO	NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA SOLICITADA, "EL REGULADOR NO CUENTA CON LA SALIDAD DE 50 PSI"	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
23	MEZCLADOR DE AIRE / OXIGENO MEDICINAL.	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
24	MANGUERA DE CONEXIÓN.	PARA LA UNIDAD DE REANIMACIÓN, DESDE LA RED CENTRAL Y BALÓN DE OXÍGENO. PARA USO CON CIRCUITOS DE VENTILADOR NEONATAL O INTERCAMBIADORES DE CALOR Y HUMEDAD (INCLUIR 50 FILTROS) PARA NEONATOS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
25	HUMIDIFICADOR CALENTADOR.	PARA USO CON CIRCUITOS DE VENTILADOR NEONATAL O INTERCAMBIADORES DE CALOR Y HUMEDAD (INCLUIR 50 FILTROS) PARA NEONATOS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
26	SISTEMA PARA FUDACIÓN DE LA INCUBADORA A LA AMBULANCIA.	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT

#### ACCESORIOS

27	SENSORES DE TEMPERATURA DE PIEL.	DOS (02) REUSABLES, O CUARENTA (40) DESCARTABLES	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT. PRESENTA DECLARACION JURADA ADICIONAL	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT. PRESENTA CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
28	COLCHONETAS	CUATRO (04), RESISTENTE A FLUIDO, DE FÁCIL LAVADO Y DESINFECCIÓN	NO CUMPLE AL NO ACREDITAR QUE LAS COLCHONETAS PUEDAN DESINFECTARSE	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT. PRESENTA CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
29	CIRCUITO PACIENTE	CUATRO (04) JUEGOS COMPLETOS REUSABLES O SESENTA (60) DESECHABLES PARA LA UNIDAD DE RESUCTACIÓN Y/O SISTEMA COMPACTO DE VENTILACIÓN	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT. PRESENTA DECLARACION JURADA ADICIONAL	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT. PRESENTA CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
30	SENSORES PARA PULSTOXIMETRIA (NEONATAL)	SEIS (06), REUSABLES Y SIN RESORTES O PINZAS DE SUCCIÓN QUE PUEDAN CAUSAR DAÑOS AL NEONATO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT. PRESENTA DECLARACION JURADA ADICIONAL	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT. CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
31	FILTROS DE AIRE	CON UN (01) JUEGO SEGÚN CONFIGURACIÓN BÁSICA + CINCO (05) JUEGOS ADICIONALES.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT. PRESENTA DECLARACION JURADA ADICIONAL	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT. CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
32	MASCARILLA FACIAL NEONATAL	UNA (01) DE SILICONA REUSABLE O CUARENTA (40) DESCARTABLES	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT. PRESENTA CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT



REQUERIMIENTO DE ENERGÍA					
33	FUENTE DE PODER INDEPENDIENTE	CON BATERÍA(S) RECARGABLE(S) PARA AUTONOMÍA DE DOS (02) HORAS O MAYOR	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
34	CONEXIÓN EXTERNA.	DE 12 VDC. CON CABLE	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
35	VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO	220 VAC (NOMINAL)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
36	FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO	60 HZ	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
37	TIPO DE ENCHUFE	SCHUKO. 250V 16 A	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT





La evaluación se sustenta en las Resoluciones: N° 1950-2019-TCE-S2 y N° 0235-2022-TCE-S4, donde se dice "... Al respecto, cabe precisar que cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el Comité de Selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones. Así pues, toda información contenida en la oferta técnica o económica, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad". (lo subrayado no es propio)

#### RESUMEN FINAL DE LA CALIFICACION DE PROPUESTAS:

POSTOR 1: NIMAT MEDICAL S.A.C.	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS - SE VALIDA PROPUESTA TECNICA
POSTOR 2: TECNIMED SYSTEM SA.	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS - NO SE VALIDA PROPUESTA TECNICA
POSTOR 3: ALBUJAR MEDICA S.A.C.	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS - SE VALIDA PROPUESTA TECNICA

SE ADJUNTA OFERTA DE LA EMPRESA TECNIMED SYSTEM SA., SUSTENTO ITEM 21,22 Y 28

ACCESORIOS (IMÁGENES REFERENCIALES)

CILINDRO DE AIRE COMPRIMIDO PIN INDEX	REGULADOR DE PRESION Y FLUJOMETRO
	
CILINDRO DE OXIGENO PIN INDEX	REGULADOR DE PRESION Y FLUJOMETRO
	



3.4 Colchón de memoria 28

El colchón del lecho de la incubadora de Transporte AI A3158, proporciona comodidad y seguridad al paciente durante la realización del transporte. Está confeccionado con espuma especial de poliuretano auto-extinguible, con densidad y composición apropiada y con "efecto memoria". La funda de revestimiento es de PVC atóxico, resistente y maleable y posee bordes pensados que impiden el depósito de suciedad y facilitan su higienización.



¡Atención! Item opcional.



**FORMATO N° 11**  
**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:**

**1 NÚMERO DE ACTA**

001-2023-CS- AS-HOMOLOGACIÓN N°40-2023-GERESA/LL - **ITEM3**

**2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL**

En, las instalaciones de la oficina de UTF -ABASTECIMIENTO, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre del año 2023, en el local del Gerencia Regional de Salud de la Libertad, a las 02:30 pm horas, se reunieron los integrantes del comite designados mediante formato N° 004 AS-HOMOLOGACIÓN N°40-2023 GERESA/LL, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección AS-HOMOLOGACIÓN N° 40-2023 GERESA/LL, cuyo objeto de convocatoria es "IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO (18) INCUBADORA NEONATAL AVANZADA PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", **ITEM 3** - IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE UNA (01) INCUBADORA NEONATAL DE TRANSPORTE CON VENTILADOR DE TRASLADO PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD a fin de efectuar la APERTURA DE LAS OFERTAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.

**3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)**

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	ECON. ANGEL DANIEL TEJADA NUÑEZ	Titular <input checked="" type="checkbox"/>	Dependencia:	UTF-ABASTECIMIENTO
		Suplente		
Primer Miembro	ING. OSCAR IVAN DIAZ ARANA	Titular <input checked="" type="checkbox"/>	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION
		Suplente		
Segundo Miembro	ING. DAVID LUNA GRANDEZ	Titular <input checked="" type="checkbox"/>	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION
		Suplente		

**4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES**

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	20100162238
2	ALBUJAR MEDICA S.A.C.	20130329471
3	MEDELCO SRL	20208310730
4	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	20340116055
5	BIOLOGIAS MEDICAS ANDINAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20454094221
6	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	20494151503
7	ABAMEDIC S.R.L.	20502626931
8	HEMOCARE S.A.C.	20505463146
9	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20512709088
10	CARDIOMED DEL PERU SAC	20520987186
11	CORPORACION DACMAR S.A.C.	20529457554
12	DRAEGER PERU S.A.C.	20538597121
13	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	20545804795
14	ASECO PERU S.A.C.	20565911920
15	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	20565935861
16	VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.	20601325153
17	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK	20601571065
18	ADVANCED MEDICAL INC E.I.R.L.	20602703003
19	VPM PROVEEDORES S.R.L.	20602922597
20	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	20603355289
21	NOVAMED PERU S.A.C.	20604537372
	GAESA MEDIC E.I.R.L.	20606094834
	NIMAT MEDICAL S.A.C.	20608071521
	MEDICALDIST S.A.C.	20608573373
	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20610815341

**5 DETALLE DE LOS POSTORES**

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron sus ofertas en la plataforma digital del SEACE :

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	NOVAMED PERU S.A.C.	15/11/2023	21:41:12
2	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	15/11/2023	18:42:42



6 Acto seguido, se procede con la apertura de las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.

7	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS		
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:		
	Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
		NIMAT MEDICAL S.A.C	NO SUSTENTA ESPECIFICACIONES TECNICAS, SE ADJUNTA EVALUACION TECNICA POR PARTE DE LOS INGENIEROS ESPECIALISTAS
	1	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	NO SUSTENTA ESPECIFICACIONES TECNICAS, SE ADJUNTA EVALUACION TECNICA POR PARTE DE LOS INGENIEROS ESPECIALISTAS

8	DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN		
	De acuerdo con la revisión efectuada por el comité, así como el cumplimiento de las especificaciones del ingeniero equipador parte de este colegiado y validando su cumplimiento, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:		
	Nº	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
	1	NOVAMED PERU S.A.C.	ITEM 3 - IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE UNA (01) INCUBADORA NEONATAL DE TRANSPORTE CON VENTILADOR DE TRASLADO PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

9	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS			
	9.1	DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA		
	Nº	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
	1	NOVAMED PERU S.A.C.	S/ 240,000.00	96.64%
	9.2	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		
		La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo 01 que forma parte de la presente Acta.		

10	PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES			
	COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR			
	10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1	NOVAMED PERU S.A.C.	
		FACTORES		PUNTAJES
		PRECIO		70
		PLAZO		20
		MEJORAS		10
		BONIFICACION MYPE		5
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		105 PUNTOS

11	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN		
	De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:		
	Nº DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
	1	NOVAMED PERU S.A.C.	105

12	CALIFICACIÓN			
	Luego de culminada la evaluación, el Comité de selección determinó si el postor que obtuvo el primer lugar según los requisitos de calificación detallados en las bases:			
	12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1	NOVAMED PERU S.A.C.	
		REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
		A EXPERIENCIA DEL POSTOR	X	
		B CAPACIDAD LEGAL	X	
		C CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL	X	
		RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN	CUMPLE	

13	RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN
----	-------------------------------



De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo EL PRIMER LUGAR POR ORDEN DE PRELACION, cumple con los requisitos de calificación establecidos en las bases:

Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
1	NOVAMED PERU S.A.C.

DE SER EL CASO INCLUIR:

18

**ACUERDO ADOPTADO**

Los integrantes del comité de selección por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.


19



Egon Angel Daniel Tejada Nuñez  
Presidente Titular



ING. OSCAR IVAN DIAZ ARANA  
Primer Miembro



ING. DAVID LUNA GRANDEZ  
Segundo Miembro

**NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**

ITEM 3 IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE UNA (01) INCUBADORA NEONATAL DE TRANSPORTE CON VENTILADOR DE TRASLADO PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		01 UNIDAD		
MONTO DISPONIBLE		s/248,333.33 Soles		
POSTORES		NOVAMED PERU S.A.C.	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	NIMAT MEDICAL S.A.C.
RUC		20604537372	20603355289	20608071521
DOCUMENTOS PARA ADMISION DE OFERTAS ITEM 03				
DECLARACION JURADA DEL POSTOR ANEXO 01	ANEXO 01	CONFORME	CONFORME	CONFORME
COPIA CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL COPIA DE DNI	VIGENCIA PODER	CONFORME	CONFORME	CONFORME
DECLARACION JURADA ANEXO 2	ANEXO 02	CONFORME	CONFORME	CONFORME
DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 01	ANEXO 03	CONFORME	CONFORME	CONFORME
CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS		CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELECTRICA		CONFORME	CONFORME	CONFORME
COPIA DEL CERTIFICADO ISO 13485		CONFORME	CONFORME	CONFORME
REGISTRO SANITARIO		CONFORME	CONFORME	CONFORME
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE ENTREGA	ANEXO 04	CONFORME 30 DIAS	CONFORME 44 DIAS	CONFORME 30 DIAS
PROMESA DE CONSORCIO	ANEXO 05	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
PRECIO OFERTA	ANEXO 06	S/ 240,000.00	S/ 155,000.00	S/ 177,500.00
DOCUMENTACION DE PRESENTACION FACULTATIVA				
BONIFICACION DE MYPE	5%	CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	CORRESPONDE
PUNTAJES				
VALOR OFERTA		S/ 240,000.00	S/ 155,000.00	S/ 177,500.00
% DEL VALOR DE OFERTA		96.64%	62.41%	71.47%
PRECIO		70		
PLAZO DE ENTREGA		20		
MEJORAS		10		
TOTAL POR FACTORES		100		
BONIFICACION MYPE		5		
PUNTAJE TOTAL		105		

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR REQUISITOS DE CALIFICACION			
EXPERIENCIA DEL POSTOR	CUMPLE PERO EN EL CUADRO EL POSTOR PONE COMO EXPERIENCIA S/4,377,488.45 Y HACIENDO LA SUMATORIA ES DE S/1,591,875.01		
CAPACIDAD LEGAL	CUMPLE		
CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL	CUMPLE		



**AS Nº 040-2023-GERESALL  
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS**

ITEM 3	INCUBADORA NEONATAL DE TRANSPORTE CON VENTILADOR DE TRASLADO					
POSTOR 1	NIMAT MEDICAL SAC					
POSTOR 2	CPB MEDICAL SAC					
POSTOR 3	NOVAMED PERU SAC					
Nº		ESPECIFICACIONES TECNICAS		POSTOR 1	POSTOR 2	POSTOR 3
CARACTERISTICAS/CONDICIONES		ESPECIFICACIONES				
GENERALES						
A01	CUPULA TRANSPARENTE	CON DOBLE PARED	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	
A02	ACCESOS PARA MANOS	CUATRO (04) PUERTAS O VENTANAS DE ACCESO COMO MINIMO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	
A03	ACCESOS PARA TUBOS	DOS (02) ACCESOS, PARA TUBOS DE INFUSION INTRAVENOSA Y CIRCUITO PACIENTE, COMO MINIMO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	
A04	NIVEL DE RUIDO DENTRO DE LA CUPULA	IGUAL O MENOR A 60 DBA CONSIDERANDO SOLO EL RUIDO GENERADO POR LA PROPIA INCUBADORA	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	
A05	SISTEMA DE SUJECION PARA EL NEONATO	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	
A06	FLUADOR (RECEPTACULO) PARA EL SOPORTE DE INFUSION INTRAVENOSA	LOCALIZADO FUERA DE LA SUPERFICIE DEL CUERPO O HABITACULO DEL EQUIPO O ACOPLADO DE MATERIAL METALICO.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	
A07	CONTROL Y MONITOREO DE LA TEMPERATURA DE AIRE	AJUSTABLE DE 30°C O MENOS A 38°C O MAS, CON RESOLUCION DE 0,1° C	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	
A08	CONTROL Y/O MONITOREO DE LA TEMPERATURA DE PIEL	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	
A09	LECTURA DE TEMPERATURA EN PANTALLA DIGITAL	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	
A10	LUZ PARA EXAMEN	TECNOLOGIA LED	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	
A11	INDICADOR DE CARGA DE BATERIA	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	
	ALARMAS (AUDIBLES Y VISUALES)					
A12	DE ALTA Y BAJA TEMPERATURA DE PIEL.	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	
A13	DE ALTA Y BAJA TEMPERATURA DE AIRE.	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	
A14	DE FALLA DE SISTEMA DE VENTILACION O CIRCULACION DE AIRE	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	
A15	DE BATERIA BAJA Y/O FALLA DE ALIMENTACION ELECTRICA	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	

A16	DE FALLA DE TEMPERATURA	DE SENSORES (MINIMO DE SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
<b>COMPONENTES</b>					
<b>CARACTERISTICA</b>		<b>ESPECIFICACION</b>			
<b>VENTILADOR NEONATAL</b>					
B01	MODOS DE VENTILACION	ASISTIDO/CONTROLADO, CPAP	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
B02	CONTROLES DE CONCENTRACION DE OXIGENO	DE 21% A 100%	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
B03	FRECUENCIA RESPIRATORIA	120 RESPIRACIONES POR MINUTO O MAYOR	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
B04	SENSOR O CELDAS OXIGENO	UN (01) SENSOR O CELDA DE OXIGENO DE REPUESTO, ADICIONAL AL INSTALADO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
B05	SENSOR DE FLUJO	CINCO (05) SENSORES DE FLUJO REUSABLES Y ESTERILIZABLES	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FERRACIENTEMENTE LA CARACTERISTICA SOLICITADA (SOLICITA: CINCO (05) SENSORES DE FLUJO REUSABLES Y ESTERILIZABLES; NO SUSTENTA: "ESTERILIZABLE")	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
B06	SUMINISTRO DE ENERGIA	BATERIA INTERNA Y RED ELECTRICA	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
<b>HUMIDIFICADOR CALENTADOR</b>					
B07	PARA CIRCUITO DE VENTILADOR NEONATAL	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
B08	CONTROL DE TEMPERATURA	31°C O MENOR A 40°C O MAYOR	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
B09	TEMPERATURA DE VIAS AEREAS	VISUALIZACION DE TEMPERATURA DE VIAS AEREAS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
B010	CALENTADOR	TIPO HILO-CALENTE	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
B011	SILENCIADOR DE ALARMA	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
B012	ALARMA DE TEMPERATURA	DE ALTA Y BAJA TEMPERATURA	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
B013	TIPO	SERVO CONTROLADO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
B014	RANGO	DE 50% O MENOR A 90% O MAYOR	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
B015	FILTROS	CINCUENTA (50)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
<b>PULSOXIMETRO</b>					



B16	TECNOLOGIA QUE PERMITA RECHAZAR ARTEFACTOS DE MOVIMIENTO Y/O BAJA PERFUSION CON TECNOLOGIA DE EXTRACCION DE SEÑALES O ALGORITMO DE PROCESAMIENTO DE SEÑALES CARDIACAS	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FENACIENTEMENTE LA CARACTERISTICA SOLICITADA (SE SOLICITA: TECNOLOGIA QUE PERMITA RECHAZAR ARTEFACTOS DE MOVIMIENTO Y/O BAJA PERFUSION CON TECNOLOGIA DE EXTRACCION DE SEÑALES O ALGORITMO DE PROCESAMIENTO DE SEÑALES CARDIACAS; NO SUSTENTA: CON TECNOLOGIA DE EXTRACCION DE SEÑALES O ALGORITMO DE PROCESAMIENTO DE SEÑALES CARDIACAS)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
B17	SENSOR	SEIS (06) SENSORES PARA PULSIOXIMETRIA REUSABLE (SIN RESORTES NI PINZAS DE SUJECION QUE PUEDAN CAUSAR DAÑOS AL NEONATO)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
<b>ANALIZADOR O MONITOR DE OXIGENO AMBIENTAL</b>					
B18	CANTIDAD	UNO (01)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
<b>ACCESORIOS</b>					
C01	BASE RODABLE PARA INCUBADORA				
	SISTEMA DE FIJACION A AMBULANCIA	MECANICO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
	ALTURA	VARIABLE CON MECANISMO PLEGABLE	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
	RUEDAS	CON SISTEMA DE BLOQUEO O FRENO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
C02	SENSOR NEONATAL DE TEMPERATURA DE PIEL REUSABLE				
	CANTIDAD	DOS (02)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
C03	COLCHONETA IMPERMEABLE RADIOTRANSAPARENTE				
	CANTIDAD	DOS (02)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
C04	SOPORTE PARA EQUIPO DE INFUSION				
	MATERIAL	POSTE O BARRA DE ACERO INOXIDABLE	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
	CANTIDAD	UNO (01)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
C05	SOPORTE PARA MONITOR				
	CANTIDAD	UNO (01)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
C06	CILINDRO DE OXIGENO				
	CANTIDAD	DOS (02)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT

	TIPO	E	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
	MATERIAL	ALUMINIO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
	VALVULA	CON SISTEMA DE SEGURIDAD PIN INDEX (PISS)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
C07	REGULADOR DE PRESION				
	CANTIDAD	UNO (01)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
	SALIDAS	PARA 50 PSI Y REGULADA	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
	MANOMETRO	UNO (01)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
	FLUJOMETRO	UNO (01)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
C08	COMPRESOR DE AIRE INTEGRADO O INCORPORADO AL EQUIPO				
	CANTIDAD	UNO (01)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
C09	MANGUERA DE CONEXIÓN PARA EL VENTILADOR, DESDE EL BALON DE OXIGENO				
	CANTIDAD	UNO (01)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
C10	JUEGO DE CIRCUITO DE PACIENTE COMPLETO REUSABLE PARA VENTILADOR				
	CANTIDAD	CUATRO (04) JUEGOS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
C11	FILTROS DE AIRE				
	CANTIDAD	DIEZ (10)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
C12	BATERIA INTERNA				
	TIPO	RECARGABLE	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
	AUTONOMIA	TRES (03) HORAS O MAYOR	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
<b>REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES (CONDICIONES LOCALES DONDE FUNCIONARA EL EQUIPO) (VER NOTA 1)</b>					
	ALTITUD (MSNM)		CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
	HUMEDAD RELATIVA (%)		CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
	RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN (°C)		CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
D01	Tensión de funcionamiento 220 VAC (nominal)	Cumplir con lo establecido en la subregla 2, Regla 020-500 del código de la referencia.	Código nacional de electricidad- utilización aprobado por resolución ministerial N° 037- 2006-MEM/DM	Código nacional de electricidad- utilización aprobado por resolución ministerial N° 037- 2006-MEM/DM	Código nacional de electricidad- utilización aprobado por resolución ministerial N° 037- 2006-MEM/DM



D02	Frecuencia 60Hz	Cumplir con lo establecido en la regla 020-502 del código de la referencia	Código nacional de electricidad- utilización aprobado por resolución ministerial N° 037- 2006-MEM/DM	Código nacional de electricidad- utilización aprobado por resolución ministerial N° 037- 2006-MEM/DM	Código nacional de electricidad- utilización aprobado por resolución ministerial N° 037- 2006-MEM/DM
D03	Tipo de enchufe Schuko, 250V, 16 A (Nota 1)	1.- cumplir con la aplicación del diagrama 1 del artículo 2 del documento de referencia	1.- R.M. N°175-2008-MEM/DM	1.- R.M. N°175-2008-MEM/DM	1.- R.M. N°175-2008-MEM/DM
D04	Conexión externa de suministro eléctrico	12 VDC	UNE 60601-2-20	UNE 60601-2-20	UNE 60601-2-20

POSTOR 1: NIMAT MEDICAL SAC	NO CUMPLE, NO SE VALIDA PROPUESTA TECNICA PRESENTADA
POSTOR 2: CPB MEDICAL SAC	NO CUMPLE, NO SE VALIDA PROPUESTA TECNICA PRESENTADA
POSTOR 3: NOVAMED PERU SAC	CUMPLE, SE VALIDA PROPUESTA TECNICA PRESENTADA

### CARATERISTICA DE FICHA HOMOLOGADA:

#### POSTOR: NIMAT MEDICAL SAC

De la evaluación de la propuesta presentada de manera integral y en cumplimiento de la presentación de documentos obligatorios según lo requerido en las bases integradas:

**No cumple con sustento técnico de las características solicitadas**, debido a la siguiente divergencia y omisión en la propuesta, las cuales no son subsanables dado que una modificación en ese supuesto impacta en los términos en los que se encuentra expresada una oferta y con ello, en el contenido esencial de esta y que a continuación se detallan.

#### CARACTERÍSTICAS B05 DE LA FICHA HOMOLOGADA

B05 Sensor de flujo	Cinco (05) sensores de flujo reusables y esterilizables
---------------------	---

En folios 51 y 75 y con las evidencias de su propuesta técnica; se manifiesta: Postor sustenta en FOLIO 51 con el siguiente contexto: "**Sensor de Flujo de gas fresco (reusable)**" (lo subrayado no es propio) y en FOLIO 75 presenta y/o sustenta con documento con el

contexto/denominación **"DECLARACIÓN JURADA DE ENTREGA DE ACCESORIOS"**; pero teniendo en cuenta la característica de la ficha homologada que debe ser integral, no se evidencia el sustento de lo solicitado: **"ESTERILIZABLE"**; razón por la cual no evidencia el cumplimiento de lo solicitado en las especificaciones técnicas mínimas del proceso de selección.

**CARATERISTICA DE FICHA HOMOLOGADA:**

**POSTOR: CPB MEDICAL SAC**

De la evaluación de la propuesta presentada de manera integral y en cumplimiento de la presentación de documentos obligatorios según lo requerido en las bases integradas:

**No cumple con sustento técnico de las características solicitadas**, debido a la siguiente divergencia y omisión en la propuesta, las cuales no son subsanables dado que una modificación en ese supuesto impacta en los términos en los que se encuentra expresada una oferta y con ello, en el contenido esencial de esta y que a continuación se detallan.

**CARACTERÍSTICAS B16 DE LA FICHA HOMOLOGADA**

<b>B16. Tecnología que permita rechazar artefactos de movimiento y/o baja perfusión con tecnología de extracción de señales ó algoritmo de procesamiento de señales cardíacas</b>	
<b>Si</b>	

En el folio 210 y con las evidencias de su propuesta técnica; el postor no sustenta que el pulsioxímetro ofertado cuente con **"TECNOLOGÍA DE EXTRACCIÓN DE SEÑALES O ALGORITMO DE PROCESAMIENTO DE SEÑALES CARDÍACAS"** de lo solicitado en las especificaciones técnicas mínimas del proceso de selección.

La evaluación se sustenta en las Resoluciones: N° 1950-2019-TCE-S2 y N° 0235-2022-TCE-S4; donde se dice "... **Al respecto, cabe precisar que cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el**



Comité de Selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones. Así pues, toda información contenida en la oferta técnica o económica, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad". (lo subrayado no es propio)

En ese sentido, considerando lo precisado precedentemente, el cual se encuentra conforme a lo previsto en las Bases Estándar objeto de la contratación, y en la medida que lo señalado.

Al respecto, como parte de la documentación obligatoria de las bases integradas se ha requerido la presentación "FORMATO N°01 "Hoja de presentación del equipo/ sustento de cumplimiento de características técnicas" mediante el cual, los postores deben demostrar fehacientemente que el bien ofertado cumplió con las especificaciones técnicas y características técnicas solicitadas.

Sobre el punto, es importante señalar que las bases integradas del presente procedimiento de selección han sido elaboradas tomando condiciones y características técnicas

En ese sentido se advierte el contenido de la oferta de los postores no resulta ser concluyente, por otro lado, es confusa no permitiendo a este comité de selección tener certeza de que el equipo efectivamente cuente con lo solicitado en las especificaciones técnicas del proceso de selección, lo cual, no le otorga a este comité de selección, la certeza de que el equipo cuente con todas las condiciones necesarias para cumplir con la finalidad de la contratación, más aún cuando se está vulnerando las características. En este punto resulta importante traer a colación la Resolución N°01251-2022-TCE-S2 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

*" Por el contrario, de presentarse una oferta profusa, difusa y confusa, imposibilitando al comité de selección determinar fehacientemente el real alcance de la misma, este deberá no admitirla o descalificarla, según corresponda, pues no es función de dicho órgano interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, o precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado, en función a las condiciones expresamente detalladas, sin posibilidad, como se indicó, de inferir o interpretar hecho alguno.*

Por lo tanto, existen denominaciones o tecnicismos o términos que no han sido requeridos en las bases integradas del presente procedimiento de selección que no permite a este profesional tener la certeza de acreditación de la característica técnica en cuestión.

Previamente se ha establecido características y condiciones técnicas el cual busca la adquisición de Incubadora Neonatal De Transporte Con Ventilador De Traslado, para el uso con pacientes de la unidad crítica neonatal.

Teniendo en cuenta lo señalado párrafos anteriores, se procesó a revisar los folios señalados por el postor para dar cumplimiento a las características técnicas, el cual el postor **NIMAT MEDICAL SAC Y CPB MEDICAL SAC** no cumple con las especificaciones técnicas mínima solicitadas en el proceso de selección.





**FORMATO N° 11**  
**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:**

1	NÚMERO DE ACTA	001-2023-CS- AS-HOMOLOGACIÓN N°40-2023-GERESA/LL
---	----------------	--

2	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b> En las instalaciones de la oficina de UTF -ABASTECIMIENTO, a los veintiocho(28) días del mes de noviembre del año 2023, en el local del Gerencia Regional de Salud de la Libertad, a las 03:30 pm. horas, se reunieron los integrantes del comité designados mediante formato N° 004 AS-HOMOLOGACIÓN N°40-2023 GERESA/LL, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección AS HOMOLOGACIÓN N° 40-2023 GERESA/LL, cuyo objeto de convocatoria es "IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO (18) INCUBADORA NEONATAL AVANZADA PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", ITEM 4 IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DOCE (12) MONITOR DE FUNCIONES VITALES ADULTO/PEDIÁTRICO, TIPO FIJO DE 8 PARAMETROS PARA USO INTRAHOSPITALARIO PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, a fin de efectuar la APERTURA DE LAS OFERTAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.
---	--

3	<b>SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)</b> El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:				
Presidente	ECON. ANGEL DANIEL TEJADA NUÑEZ	Titular	X	Dependencia:	UTF-ABASTECIMIENTO
		Suplente			
Primer Miembro	ING. OSCAR IVAN DIAZ ARANA	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION
		Suplente			
Segundo Miembro	ING. DAVID LUNA GRANDEZ	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION
		Suplente			

4

**DETALLE DE LOS PARTICIPANTES**  
De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU	20100162238
2	ALBUJAR MEDICA S.A.C.	20130329471
3	MEDELCO SRL	20208310730
4	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	20340116055
5	BIOLOGIAS MEDICAS ANDINAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20454094221
6	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	20494151503
7	ABAMEDIC S.R.L.	20502626931
8	HEMOCARE S.A.C.	20505463146
9	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20512709088
10	CARDIOMED DEL PERU SAC	20520987186
11	CORPORACION DACMAR S.A.C.	20529457554
12	DRAEGER PERU S.A.C.	20538597121
13	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	20545804795
14	ASECO PERU S.A.C.	20565911920
15	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	20565935861
16	VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.	20601325153
17	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -	20601571065
18	ADVANCED MEDICAL INC E.I.R.L.	20602703003
19	VPM PROVEEDORES S.R.L.	20602922597
20	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	20603355289
21	NOVAMED PERU S.A.C.	20604537372
22	GAESA MEDIC E.I.R.L.	20606094834
23	NIMAT MEDICAL S.A.C.	20608071521
24	MEDICALDIST S.A.C.	20608573373
25	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	20610815341

5	<b>DETALLE DE LOS POSTORES</b>			
	En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron sus ofertas en la plataforma digital del SEACE :			
	Nº	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
	1	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	15/11/2023	21:50:04
	2	NOVAMED	15/11/2023	21:41:55
	3	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	15/11/2023	18:42:54
	4	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	15/11/2023	21:18:53
5	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	15/11/2023	21:26:15	

6	Acto seguido, se procede con la apertura de las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.
---	---

7	<b>DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS</b>		
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:			
	Nº	Nombre o razón social del postor	Completar las razones para su no admisión
	1	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	NO CUMPLE CON EETT SEGÚN INFORME ANEXO DE ING. ESPECIALISTA
	2	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	NO CUMPLE CON EETT SEGÚN INFORME ANEXO DE ING. ESPECIALISTA

3	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	NO CUMPLE CON EETT SEGÚN INFORME ANEXO DE ING. ESPECIALISTA
4	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	NO CUMPLE CON EETT SEGÚN INFORME ANEXO DE ING. ESPECIALISTA

8	<b>DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN</b> De acuerdo con la revisión efectuada por el comité, así como el cumplimiento de las especificaciones del ingeniero equipador parte de este colegiado y validando su cumplimiento, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:	
	Nº	Nombre o razón social del postor
	1	NOVAMED PERU SAC
	2	
		Item(s) a los que postula ITEM 4 IOARR 2801427: ADQUISICIÓN DE DOCE (12) MONITOR DE FUNCIONES VITALES ADULTO/PEDIATRICO, TIPO FIJO DE 8 PARAMETROS PARA USO INTRAHOSPITALARIO PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

9	<b>EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS</b>		
	9.1	<b>DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA</b>	
		Nº	Nombre o razón social del postor
		1	NOVAMED PERU SAC
		Precio de su oferta	5/ 1,416,000.00
		% del valor referencial	108.68%
	9.2	<b>DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b> La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo 01 que forma parte de la presente Acta.	

10	<b>PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES</b> COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR		
	10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1	NOVAMED PERU SAC
		FACTORES	PUNTAJES
		PRECIO	70
		PLAZO DE ENTREGA	20
		MEJORAS	10
		BONIFICACION MYPE	-
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 PUNTOS

11	<b>CALIFICACIÓN</b> Luego de culminada la evaluación, el Comité de selección determinó si el postor que obtuvo el primer lugar según los requisitos de calificación detallados en las bases:		
	12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1	NOVAMED PERU SAC
		REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE NO CUMPLE
		A EXPERIENCIA	X
		B CAPACIDAD LEGAL	X
		C CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL	X
		RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN	CUMPLE

12	<b>RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN</b> De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo la buena pro, cumple con los requisitos de calificación establecidos en las bases:	
	Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
	1	NOVAMED PERU SAC
	DE SER EL CASO INCLUIR:	
	Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases:	
	Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR
	1	XXXXXXXX
		CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN
		XXXXXXXXXX

13	<b>ACUERDO ADOPTADO</b> Los integrantes del comité de selección por UNANIMIDAD, remitir carta N° 02-2023-CS, a través de correo electrónico a postor NOVAMED PERU SAC, con la finalidad que acepte la solicitud de reducción de oferta y posterior otorgamiento de buena pro, en razón al art 68° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.	
----	---	--

14	  		
	Esón, Angel Daniel Tejeda Núñez Presidente Titular		
	ING. OSCAR IVAN DÍAZ ARANA Primer Miembro		
	ING. DAVID LUNA GRANDE Segundo Miembro		
	NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES		



# **ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:**

1	NÚMERO DE ACTA		001-2023-CS- AS-HOMOLOGACIÓN N°40-2023-GERESA/LL	
2	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b> En, las instalaciones de la oficina de UTF -ABASTECIMIENTO, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del año 2023, en el local del Gerencia Regional de Salud de la Libertad , a las 02:30 pm horas, se reunieron los integrantes del comité designados mediante formato N° 004 AS-HOMOLOGACIÓN N°40-2023 GERESA/LL, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección AS HOMOLOGACIÓN N° 40-2023 GERESA/LL , cuyo objeto de convocatoria es "IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO (18) INCUBADORA NEONATAL AVANZADA PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", ITEM 4 IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DOCE (12) MONITOR DE FUNCIONES VITALES ADULTO/PEDIATRICO, TIPO FIJO DE 8 PARAMETROS PARA USO INTRAHOSPITALARIO PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, a fin de efectuar la APERTURA DE LAS OFERTAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.			
3	<b>SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)</b> El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:			
	Presidente	ECON. ANGEL DANIEL TEJADA NUÑEZ	Titular X Suplente	Dependencia: UTF-ABASTECIMIENTO
	Primer Miembro	ING. OSCAR IVAN DIAZ ARANA	Titular X Suplente	Dependencia: OFICINA DE PLANIFICACION
	Segundo Miembro	ING. DAVID LUNA GRANDEZ	Titular X Suplente	Dependencia: OFICINA DE PLANIFICACION
4	<b>DETALLE DE LOS PARTICIPANTES</b> De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:			
	N°	Nombre o razón social del participante	RUC	
	1	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU	20100162238	
	2	ALBUJAR MEDICA S.A.C.	20130329471	
	3	MEDELCO SRL	20208310730	
	4	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	20340116055	
	5	BIOLOGIAS MEDICAS ANDINAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20454094221	
	6	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	20494151503	
	7	ABAMEDIC S.R.L.	20502626931	
	8	HEMOCARE S.A.C.	20505463146	
	9	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20512709088	
	10	CARDIOMED DEL PERU SAC	20520987186	
	11	CORPORACION DACMAR S.A.C.	20529457554	
	12	DRAEGER PERU S.A.C.	20538597121	
	13	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	20545804795	
	14	ASECO PERU S.A.C.	20565911920	
	15	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	20565935861	
	16	VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.	20601325153	
	17	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -	20601571065	
	18	ADVANCED MEDICAL INC E.I.R.L.	20602703003	
	19	VPM PROVEEDORES S.R.L.	20602922597	
	20	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	20603355289	
	21	NOVAMED PERU S.A.C.	20604537372	
	22	GAESA MEDIC E.I.R.L.	20606094834	
	23	NIMAT MEDICAL S.A.C.	20608071521	
	24	MEDICALDIST S.A.C.	20608573373	
	25	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	20610815341	
5	<b>DETALLE DE LOS POSTORES</b> En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron sus ofertas en la plataforma digital del SEACE :			
	N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
	1	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	15/11/2023	21:50:04
	2	NOVAMED	15/11/2023	21:41:55
	3	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	15/11/2023	18:42:54
	4	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	15/11/2023	21:18:53
	5	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	15/11/2023	21:26:15
6	Acto seguido, se procede con la apertura de las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.			

7	<b>DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS</b>		
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:		
	Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
	1	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	NO CUMPLE CON EETT SEGÚN INFORME ANEXO DE ING. ESPECIALISTA
	2	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	NO CUMPLE CON EETT SEGÚN INFORME ANEXO DE ING. ESPECIALISTA
	3	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	NO CUMPLE CON EETT SEGÚN INFORME ANEXO DE ING. ESPECIALISTA
	4	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	NO CUMPLE CON EETT SEGÚN INFORME ANEXO DE ING. ESPECIALISTA

8	<b>DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN</b>		
	De acuerdo con la revisión efectuada por el comité, así como el cumplimiento de las especificaciones del ingeniero equipador parte de este colegiado y validando su cumplimiento, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:		
	Nº	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
	1	NOVAMED PERU SAC	ITEM 4 IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DOCE (12) MONITOR DE FUNCIONES VITALES ADULTO/PEDIATRICO, TIPO FIJO DE 8 PARAMETROS PARA USO INTRAHOSPITALARIO PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

9	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS			
	9.1	DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA		
	Nº	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
	1	NOVAMED PERU SAC	S/ 1'301, 000.00	99.85%
	9.2	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		
	La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo 01 que forma parte de la presente Acta.			

10	<b>PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES</b>			
	COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR			
	10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1	NOVAMED PERU SAC	
	FACTORES			PUNTAJES
	PRECIO			70
	PLAZO DE ENTREGA			20
	MEJORAS			10
	BONIFICACION MYPE			
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES			100 PUNTOS

11	<b>CALIFICACIÓN</b>			
	Luego de culminada la evaluación, el Comité de selección determinó si el postor que obtuvo el primer lugar según los requisitos de calificación detallados en las bases:			
	12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1	NOVAMED PERU SAC	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	EXPERIENCIA	X	
	B	CAPACIDAD LEGAL	X	
	C	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CUMPLE	

12	<b>RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN</b>	
	De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo la buena pro, cumple con los requisitos de calificación establecidos en las bases:	
	Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
	1	NOVAMED PERU SAC
DE SER EL CASO INCLUIR:		



Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases:		
Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN
1	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Que, mediante carta NOVAMED-COR-266/2023 de fecha 29 de noviembre de 2023, señala que "(...) debemos indicar que haciendo una evaluación de los costos a incurrir en el bien a contratar hemos considerado por esta ocasión hacer un reajuste en el precio de la oferta económica (...) PRECIO TOTAL REDUCIDO S/ 1'301, 000.00"		
13	REDUCCIÓN DEL PRECIO DE LA OFERTA	
	Nº	Nombre o razón social del postor
	1	NOVAMED PERU S.A.C.
		Aceptó reducción de su oferta
		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
14	ACUERDO ADOPTADO	
	Los integrantes del comité de selección por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.	
15	 Econ. Angel Daniel Tejeda Nuñez Presidente Titular	
	 ING. OSCAR IVAN DIAZ ARANA Primer Miembro	
	 ING. EDWIN LUNA GRANDEZ Segundo Miembro	
NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS		

ITEM 4 IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DOCE (12) MONITOR DE FUNCIONES VITALES ADULTO/PEDIATRICO, TIPO FIO DE 8 PARAMETROS PARA USO INTRAHOSPITALARIO PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		12 UNIDAD				
MONTO DISPONIBLE		S/1,302,847.29 Soles				
POSTORES	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	NOVAMED PERU S.A.C.	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	CARDIOPULMONA RY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	
RUC	20340116055	20604537372	20603355289	20512709088	20545804795	
DOCUMENTOS PARA ADMISION DE OFERTAS ITEM 04						
DECLARACION JURADA DEL POSTOR ANEXO 01	ANEXO 01	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
COPIA CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL COPIA DE DNI	VIGENCIA PODER	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
DECLARACION JURADA ANEXO 2	ANEXO 02	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 01	ANEXO 03	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
ACREDITACION DE ESPECIFICACIONES		NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELECTRICA		CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
COPIA DEL CERTIFICADO ISO 13485		CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
REGISTRO SANITARIO		CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE ENTREGA	ANEXO 04	CONFORME 23 DIAS	CONFORME 23 DIAS	CONFORME 29 DIAS	CONFORME 22 DIAS	NO CUMPLE CON PRESENTAR ANEXO DE ACUERDO A LA FICHA
PROMESA DE CONSORCIO	ANEXO 05	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
PRECIO OFERTA	ANEXO 06	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
DOCUMENTACION DE PRESENTACION FACULTATIVA						
BONIFICACION DE MYPE	5%	CORRESPONDE	CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	CORRESPONDE
PUNTAJES						
VALOR OFERTA		S/ 1,152,000.00	S/ 1,416,000.00	S/ 960,000.00	S/ 876,000.00	S/ 2,314,800.00
% DEL VALOR DE OFERTA			108.68%			
PRECIO			70			
PLAZO DE ENTREGA			20			
MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS			10			
BONIFICACION MYPE			-			
PUNTAJE TOTAL			100			
EXPERIENCIA DEL POSTOR						
CAPACIDAD LEGAL		CUMPLE				
CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL		CUMPLE				



NOVAMED-COR-266/2023

Lima, 29 de Noviembre del 2023

Señores  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD  
Presente.-

Atte.: Lic. Angel Daniel Teleda Nuñez  
Presidente de Comité de Selección

Ref.: Reducción de la Oferta Económica

Estimados Señores:

Por la presente, en respuesta a vuestra solicitud con carta N° 02-2023-CS sobre REDUCCION DE OFERTA ECONOMICA, en el proceso Adjudicación Simplificada Homologación N° 40-2023-GERESALL ITEM N° 4, debemos indicar que haciendo una evaluación de los costos a incurrir en el bien a contratar hemos considerado por esta ocasión hacer un reajuste en el precio de la oferta económica de la siguiente manera:

**PRECIO REAJUSTADO**

ITEM N°	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL OFERTADO S/	PRECIO TOTAL REDUCIDO S/
04	IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DOCE (12) MONITOR DE FUNCIONES VITALES ADULTO/PEDIATRICO, TIPO FIJO DE 8 PARAMETROS PARA USO INTRAHOSPITALARIO PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	12	1'416,000.00	1'301,000.00

Adjunto al presente, remitimos el **Anexo N° 6** debidamente firmada por nuestra Representante Legal.

Sin otro particular, quedamos como siempre atentos a sus gratas órdenes.

Atentamente,

NOVAMED PERÚ S.A.C.  
  
Valeria Geraldine Valdivezo Shoplana  
GERENTE GENERAL

**ANEXO N° 06****ITEM 5****PRECIO DE LA OFERTA**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA HOMOLOGACIÓN N° 040-2023-GERESALL**  
**Presente.-**

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

PRESTACION	DESCRIPCION	PRECIO TOTAL S/
PRINCIPAL	IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DOCE (12) MONITOR DE FUNCIONES VITALES ADULTO/PEDIATRICO, TIPO FIJO DE 8 PARAMETROS PARA USO INTRAHOSPITALARIO PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	1'297,000.00
	CAPACITACION	
ACCESORIAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	4,000.00
TOTAL S/		1'301,000.00

El precio de la oferta en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos

NOVAMED PERÚ S.A.C.  
  
Valeria Geraldine Valdiviezo Shapiama  
GERENTE GENERAL

Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda



**AS N° 040-2023-GERESALL**  
**EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS**

ITEM 4	MONITOR DE FUNCIONES VITALES ADULTO/PEDIATRICO, TIPO FLO DE 8 PARAMETROS PARA USO INTRAHOSPITALARIO									
POSTOR 1	TECNIMED SYSTEM S. A.									
POSTOR 2	GOLDEN MEDICAL TECH SAS									
POSTOR 3	CPB MEDICAL SAC									
POSTOR 4	NOVAMED PERU SAC									
POSTOR 5	CARDIOPULMONARY CARE SAC									
ESPECIFICACIONES TECNICAS										
Nº	CARACTERISTICAS/CONDICIONES	ESPECIFICACIONES	POSTOR 1	POSTOR 2	POSTOR 3	POSTOR 4	POSTOR 5			
GENERALES										
1.1	BASE	EQUIPO MODULAR, MONITOR Y MODULOS DE LA MISMA MARCA	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET			
1.2	PARAMETROS	ELECTROCARDIOGRAMA (ECG), FRECUENCIA RESPIRATORIA (RR), SATURACION DE OXIGENO (SPO2), PRESION ARTERIAL (NO INVASIVA (PANI), TEMPERATURA (02 CAVALES) CAPNOGRAFIA (CO2), PRESION INVASIVA (PI) Y GASTO CARDIACO (CO)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET			
1.3	TENDENCIAS	HASTA 24 HORAS O MAS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET			
1.4	CONECTIVIDAD CON OTROS EQUIPO	VENTILADOR O MAQUINA DE ANESTESIA O ANALIZADOR DE GASES SANGUINEOS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET			
1.5	CONEXION A SISTEMA DE INFORMACION HOSPITALARIA	MEDIANTE PROTOCOLO HL7	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	NO ACREDITA, NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS. "Cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de tal manera que el Comité de Selección pueda evidenciar lo que el postor se encuentra ofreciendo sin recurrir a interpretaciones" (Véase Resolución N° 750-2021-TC-51; Resolución N° 235-2022-TC-54; Resolución N° 1169-2022-TC-54; Resolución N° 2595-2021-TC-55).				CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET		
1.6	PROTECCION	CONTRA DESCARGAS DE DESFIBRILADOR	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET			
1.7	CAPACIDAD PARA CONECTARSE A LA ENTRADA DE MONITOREO	MEDIANTE RED LAN ALAMBICA E INALAMBICA WIFI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET			
1.8	CALCULO DE FARMACOS O DRUGAS	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET			
1.9	SILENCIADOR DE ALARMAS	FUNCION DE SUSPENDER O SILENCIAR ALARMAS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET			
1.10	INTERFAZ DE ENTRADA	MEDIANTE PANTALLA TÁCTIL (TOUCH SCREEN) Y/O PERIFERIA SERVIDORA)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET			
2	COMPONENTES									

*[Firma]*

<b>2.1 ALARMAS (SONORAS Y VISUALES)</b>									
2.1.1	DE SELECCIÓN PARA LÍMITE SUPERIOR E INFERIOR DE LA FRECUENCIA CARDÍACA	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
2.1.2	DE APNEA	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
2.1.3	DE SELECCIÓN PARA LÍMITE SUPERIOR E INFERIOR DE LA FRECUENCIA RESPIRATORIA	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
2.1.4	DE SELECCIÓN PARA LÍMITE INTERIOR DE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
2.1.5	DE SELECCIÓN PARA LÍMITE SUPERIOR E INFERIOR DE LA PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
2.1.6	DE SELECCIÓN PARA LÍMITE SUPERIOR E INFERIOR DE LA TEMPERATURA	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
2.1.7	DE SELECCIÓN PARA LÍMITE SUPERIOR E INFERIOR DEL CO2 ESPIRADO (ETCO2)	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
2.1.8	DE SELECCIÓN PARA LÍMITE SUPERIOR E INFERIOR DE LA PRESIÓN INVASIVA	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
<b>2.2 PANTALLA</b>									
2.2.1	TIPO	LCD O TFT, A COLOR PARA VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
2.2.2	TAMAÑO	15" DIAGONAL O MAYOR	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
2.2.3	RESOLUCIÓN	1024 X 768 PÍXELES O MAYOR	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
2.2.4	GRÁFICAS	OCHO (08) ONDAS SIMULTÁNEAS O MÁS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
<b>2.3 REGISTRADOR</b>									
2.3.1	TIPO	REGISTRO POR ARREGLO TÉRMICO, INCORPORADO O INTEGRADO EN EL MONITOR	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
2.3.2	CAPACIDAD PARA PAPEL DE 50 MM DE ANCHO	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
2.3.3	NÚMERO DE CAUALES DE IMPRESIÓN	TRES (03) CAUALES DE ONDA DE MANERA SIMULTÁNEA O MÁS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
<b>3 PARÁMETROS</b>									
<b>3.1 ELECTROCARDIOGRAMA (ECG)</b>									
3.1.1	VISUALIZACIÓN EN PANTALLA	DOS (02) ONDAS O MÁS Y UN (01) VALOR NUMÉRICO MEDIDO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
3.1.2	RANGO DE MEDICIÓN DE LA FRECUENCIA CARDÍACA (BPM O LEQ)	DE 30 A 250 BPM O RANGO MÁS AMPLIO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
3.1.3	SELECCIÓN DE DERIVADAS	DOCE (12) DERIVADAS I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
3.1.4	DETECCIÓN O RECHAZO DEL PULSO DEL MARCAPASOS	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT

**NO ACREDITA, NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.** Cada postor debe ser diligente y presentar ofertas claras y comprensibles de tal manera que el Comité de Selección pueda evidenciar la que al postor le encuentra faltando sin recurrir a interpretaciones. (Véase Resolución No 750-2021-TCE-S3; Resolución No 235-2022-TCE-S4; Resolución No 1169-2022-TCE-S4; Resolución No 2595-2023-TCE-S3).



3.1.5	DETECCION DE ARITMIAS	DOCE (12) TIPOS O MAS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
3.1.6	ANALISIS DE DERIVADO ST	EN DOCE (12) DERIVACIONES	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
3.2	FRECUENCIA RESPIRATORIA (FR)		CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
3.2.1	VISUALIZACION EN PANTALLA	UNA (01) ONDA O MAS Y UN (01) VALOR NUMERICO MEDIDO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
3.2.2	METODO	MEDICION A TRAVES DE CABLE ECG (METODO DE IMPEDANCIAS) Y A TRAVES DE LAS VIBS AEREAS MEDIANTE LA CAPNOGRAFIA	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	NO ACREREDITA, NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS. "Cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de tal manera que el Comité de Selección pueda evidenciar lo que el postor se encuentra ofertando sin recurrir a interpretaciones" (Véase Resolución No 750-2021-TC-E-S1; Resolución No 235-2022-TC-E-S4; Resolución No 1169-2022-TC-E-S4; Resolución No 2595-2021-TC-E-S5).	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
3.2.3	RANGO	5 A 120 RESPIRACIONES POR MINUTO O RANGO MAS AMPLIO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
3.3	SATURACION DE OXIGENO (SPO2)		CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
3.3.1	METODO DE MEDICION EN CONDICIONES DE BAJA PERLUSION Y/O MOVIMIENTO	TECNOLOGIA DE EXTRACCION DE SEÑALES, O ALGORITMO DE PROCESAMIENTO DE SEÑALES CARDIACAS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	NO ACREREDITA, NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS. "Cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de tal manera que el Comité de Selección pueda evidenciar lo que el postor se encuentra ofertando sin recurrir a interpretaciones" (Véase Resolución No 750-2021-TC-E-S1; Resolución No 235-2022-TC-E-S4; Resolución No 1169-2022-TC-E-S4; Resolución No 2595-2021-TC-E-S5).	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
3.3.2	VISUALIZACION EN PANTALLA	UNA (01) ONDA PLETISIOGRAFICA Y UN (01) VALOR NUMERICO MEDIDO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
3.3.3	METODO DE MEDICION	ASOCIACION DE LUZ DE LONGITUD DE ONDA	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
3.3.4	RANGO DE LA SATURACION DE OXIGENO	70% A 100% O RANGO MAS AMPLIO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
3.3.5	PRECISION	$\pm 3\%$ (+/- 3 DIGITOS) O MENOR, EN EL RANGO DE 70% A 100%	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	NO ACREREDITA, NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS. "Cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de tal manera que el Comité de Selección pueda evidenciar lo que el postor se encuentra ofertando sin recurrir a interpretaciones" (Véase Resolución No 750-2021-TC-E-S1; Resolución No 235-2022-TC-E-S4; Resolución No 1169-2022-TC-E-S4; Resolución No 2595-2021-TC-E-S5).
3.3.6	RANGO DEL PULSO CARDIACO MEDIANTE PULSIOXIMETRIA (BPM O LPM)	30 A 240 BPM O RANGO MAS AMPLIO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET

3.3.7	INDICADOR EN PANTALLA	POTENCIA DE LA SEÑAL O PERFUSION O INTENSIDAD DE SEÑAL	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
3.4	<b>PREISION ARTERIAL NO INVASIVA (PANI)</b>					
3.4.1	VISUALIZACION EN PANTALLA	VALOR NUMERICO MEDIDO: SISTOLICA, DIASTOLICA Y MEDIA	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
3.4.2	METODO DE MEDICION	OSCILOMETRICO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
3.4.3	TIPO DE PACIENTE	ADULTOS Y NIÑOS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
3.4.4	MODO PARA TOMA DE PRECISION	MANUAL Y AUTOMATICO (A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO O PERIODICOS)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
3.5	<b>TEMPERATURA (TEMP)</b>					
3.5.1	VISUALIZACION EN PANTALLA	DOS (02) VALORES NUMERICOS MEDIDOS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
3.5.2	RANGO DE MEDICION	0° C A 45°C O MAS AMPLIO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
3.5.3	NUMERO DE CANALES	DOS (02) O MAS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
3.6	<b>CAPNOGRAFIA</b>					
3.6.1	VISUALIZACION EN PANTALLA	UNA (01) ONDA O MAS Y UN (01) VALOR NUMERICO MEDIDO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
3.6.2	METODO DE MEDICION	MAINSTREAM O SIDESTREAM O MICROSTREAM	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
3.6.3	RANGO DE MEDICION	DE 0 MMHG A 99 MMHG O RANGO MAS AMPLIO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
3.7	<b>PREISION INVASIVA (PI)</b>					
3.7.1	VISUALIZACION EN PANTALLA	UNA (01) ONDA O MAS Y UN (01) VALOR NUMERICO MEDIDO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
3.7.2	RANGO DE MEDICION	DE 30 MMHG A 300 MMHG O RANGO MAS AMPLIO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
3.7.3	NUMERO DE CANALES	DOS (02) CANALES O MAYOR	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
3.7.4	CALIBRACION	BALANCE, AJUSTE A CERO DE LA PREISION INVASIVA	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
3.8	<b>GASTO CARDIACO (GC)</b>					
3.8.1	VISUALIZACION EN PANTALLA	UN (01) VALOR NUMERICO MEDIDO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
3.8.2	METODO DE MEDICION	TERMODILUACION O TERMODILUACION TRANSPULMONAR	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
4	<b>ACCESORIOS (VER NOTA 2)</b>					
4.1	RACK DE PARED, DE ALTA GRABATABLE E INCLINACION PARA EL MONITOR	UNO (01)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
4.2	CABLE DE ALIMENTACION	UNO (01)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
4.3	<b>ESTABILIZADOR EXTERNO</b>					
4.3.1	TIPO	ESTADO SOLIDO (SIN RELE), FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO, CON LINEA A TIERRA	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
4.3.2	VARIACION DEL VOLTAJE DE SALIDA	MEJOR O IGUAL A +/- 5%	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
4.3.3	POTENCIA	SUPERIOR EN 25% O MAYOR DE LA POTENCIA NOMINAL DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
4.3.4	CANTIDAD	UNO (01)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
4.4	<b>ECG PARA 3 DERIVADAS</b>					
4.4.1	CABLE TRIUNAL DE ECG PARA 3 DERIVADAS DE 1.50 M O MAYOR	DOS (02)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT



4.4.2	CABLE RAMAL DE ECG PARA 3 DERIVADAS	OCHO (08)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
4.5	ECG PARA 5 O 6 DERIVADAS							
4.5.1	CABLE TRONCAL DE ECG PARA 5 O 6 DERIVADAS, DE 1,50 M O MAYOR	DOS (02)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
4.5.2	CABLE RAMAL DE ECG PARA 5 O 6 DERIVADAS	OCHO (08)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
4.6	ECG PARA 12 DERIVADAS							
4.6.1	CABLE TRONCAL DE ECG PARA 12 DERIVADAS, DE 1,50 M O MAYOR	DOS (02)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
4.6.2	CABLE RAMAL DE ECG PARA 12 DERIVADAS	DOS (02)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
4.7	SATURACION DE OXIGENO (SP02)							
4.7.1	SENSOR REUSABLE PARA MEDIR SATURACION DE OXIGENO, PARA ADULTO	SEIS (06)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
4.7.2	SENSOR REUSABLE PARA MEDIR SATURACION DE OXIGENO, PARA PEDIATRICO	DOS (02)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
4.7.3	CABLE EXTENSOR	UNO (01)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
4.8	PRESION ARTERIAL NO INVASIVA (PANI)							
4.8.1	BRAZALETE REUSABLE PARA MEDICION DE LA PRESION NO INVASIVA, PARA ADULTO	DOS (02)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
4.8.2	BRAZALETE REUSABLE PARA MEDICION DE LA PRESION NO INVASIVA, PARA PEDIATRICO	DOS (02)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
4.8.3	BRAZALETE REUSABLE PARA MEDICION DE LA PRESION NO INVASIVA, PARA ADULTO GRANDE	DOS (02)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
4.8.4	BRAZALETE REUSABLE PARA MEDICION DE LA PRESION NO INVASIVA, PARA PEDIATRICO PEQUEÑO	DOS (02)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
4.8.5	MANIGUERA CON CONECTOR PARA LOS BRAZALETES ADULTO/PEDIATRICO	DOS (02)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
4.9	TEMPERATURA (TEMP)							
4.9.1	SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA (DE PIEL O SUPERFICIE) PARA ADULTO	DOS (02)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
4.9.2	SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA (ESOFAGICO O RECTAL) PARA ADULTO	DOS (02)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
4.9.3	SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA (DE PIEL O SUPERFICIE) PARA PEDIATRICO	DOS (02)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
4.9.4	SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA (ESOFAGICO O RECTAL) PARA PEDIATRICO	DOS (02)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET
4.10	CAPNOGRAFIA (CO2)							

*[Handwritten signature]*

4.10.1	SENSOR DE CAPNOGRAFIA	EN CASO DE SER MAINSTREAM: DOS (02) SENSORES REUSABLES, CON CABLE CONECTOR AL EQUIPO, CON DOS ADAPTADORES REUSABLES DE VIAS AEREAS O CUARENTA (40) ADAPTADORES DESCARTABLES DE VIAS AEREAS, CON SET DE CALIBRACION SI EL EQUIPO LO REQUIERE.	NO ACREDITA, NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS. "Cada profesor debe ser diligente y presentar ofertas claras y congruentes de tal manera que el Comité de Selección pueda evidenciar lo que el profesor se encuentra efectuando sin recurrir a interpretaciones (Vase Resolución N° 750-2021-ITE-SI; Resolución N° 235-2022-ITE-SI; Resolución N° 1169-2022-ITE-SI; Resolución N° 2595-2021-ITE-SI).	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
4.11	PRESION INVASIVA (PI)							
4.11.1	KIT COMPLETO PARA PRESION ARTERIAL INVASIVA, DESCARTABLE, PARA USO ADULTO/PEDIATRICO (TRANSDUCTOR, CABLES Y JUEGO DE INYECTOR)	VEINTE (20) (INCLUYE 2 CABLES PARA CONEXION)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
4.12	GASTOCARDIACO (GC)							
4.12.1	KIT COMPLETO PARA GASTO CARDIACO (CABLES, SENSORES, CATETERES Y SONDAS)	VEINTE (20) (INCLUYE 2 CABLES PARA CONEXION)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
4.13	PAPEL TERMOSENSIBLE							
4.13.1	CANTIDAD	CINCO (05) ROLLOS O PAQUETES	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
4.14	ELECTRODOS PARA ECG							
4.14.1	TIPO	BROCHE PARA PIEL	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
4.14.2	CANTIDAD	CIENTO (100) ELECTRODOS DESCARTABLES	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
4.15	BATERIA							
4.15.1	TIPO	RECARGABLE, INCORPORADA AL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
4.15.2	AUTONOMIA	DE SESENTA (60) MINUTOS O MAYOR	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
5	REQUERIMIENTO DE ENERGIA							
5.1	VOLTAJE	220 VAC (NOMINAL)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
5.2	FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO	60 HZ	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
6	CUMPLIMIENTO NORMATIVO							
6.1	CERTIFICACION REGLAMENTARIA	REGISTRO SANITARIO						
MEJORA A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS								
1	DETECCION DE 23 TIPOS DE ARITMIAS Y MEDICION AUTOMATICA QUE ACTIVE LA MEDICION DE LA PRESION ARTERIAL NO INVASIVA CADA VEZ QUE DETECTE UN CAMBIO DE LA PRESION SANGUINEA EN EL PACIENTE INDEPENDIENTE DE LA MEDICION PERIODICA	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FUNDAMENTAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO Y DE LA ABSOLUCION DE CONSULTA Y OBSERVACIONES	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FUNDAMENTAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO Y DE LA ABSOLUCION DE CONSULTA Y OBSERVACIONES	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FUNDAMENTAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO Y DE LA ABSOLUCION DE CONSULTA Y OBSERVACIONES	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FUNDAMENTAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO Y DE LA ABSOLUCION DE CONSULTA Y OBSERVACIONES	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FUNDAMENTAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO Y DE LA ABSOLUCION DE CONSULTA Y OBSERVACIONES



2	MEDICION AUTOMATICA QUE ACTIVE LA MEDICION DE LA PRESION ARTERIAL NO INVASIVA CADA VEZ QUE DETECTE UN CAMBIO DE LA PRESION SANGUINEA EN EL PACIENTE INDEPENDIENTE DE LA MEDICION PERIODICA	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FUNDAMENTAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO Y DE LA ASISTENCIA DE CONSULTA Y OBSERVACIONES.	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FUNDAMENTAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO Y DE LA ASISTENCIA DE CONSULTA Y OBSERVACIONES.	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FUNDAMENTAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO Y DE LA ASISTENCIA DE CONSULTA Y OBSERVACIONES.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EET	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FUNDAMENTAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO Y DE LA ASISTENCIA DE CONSULTA Y OBSERVACIONES.
---	--	--	--	--	---------------------------------------	--

ITEM 4	MONITOR DE FUNCIONES VITALES ADULTO/PEDIATRICO, TIPO FIJO DE 8 PARAMETROS PARA USO INTRAHOSPITALARIO					
POSTOR 1	TECNIMED SYSTEM S.A.	NO CUMPLE, NO SE VALIDA CUMPLIMIENTO DE EET				
POSTOR 2	GOLDEN MEDICAL TECH SAC	NO CUMPLE, NO SE VALIDA CUMPLIMIENTO DE EET				
POSTOR 3	CPB MEDICAL SAC	NO CUMPLE, NO SE VALIDA CUMPLIMIENTO DE EET				
POSTOR 4	NOVAMED PERU SAC	CUMPLE Y SE VALIDA CUMPLIMIENTO DE EET				
POSTOR 5	CARDIOPULMONARY CARE SAC	NO CUMPLE, NO SE VALIDA CUMPLIMIENTO DE EET				

Al respecto, como parte de la documentación obligatoria de las bases integradas se ha requerido la presentación "FORMATO Nº01 "Hoja de presentación del equipo/ sustento de cumplimiento de características técnicas" mediante el cual, los postores deben demostrar fehacientemente que el bien ofrecido cumple con las especificaciones técnicas y características técnicas solicitadas.


Sobre el punto, es importante señalar que las bases integradas del presente procedimiento de selección han sido elaboradas tomando como condiciones y características técnicas, y en ese sentido se advierte el contenido de la oferta de los postores no resulta ser concuyente, por otro lado, es confusa no permitiendo a este comité de selección tener certeza de que el equipo efectivamente cumple con el sensor de sop2 esterilizable, lo cual, no le otorga a este comité de selección, la certeza de que el equipo cumple con todas las condiciones necesarias para cumplir con la finalidad de la contratación, más aún cuando se está vulnerando las características. En este punto resulta importante traer a colación la Resolución Nº01251-2022-TCE-S2 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

*"Por el contrario, de presentarse una oferta profusa, difusa y confusa, imposibilitando al comité de selección determinar fehacientemente el real alcance de la misma, este deberá no admitirla o descalificarla, según corresponda. Pues no es función de dicho órgano interpretar el alcance de una oferta, establecer ambigüedades, o precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofrecido, en función a las condiciones expresamente detalladas, sin posibilidad, como se indicó, de inferir o interpretar hecho alguno.*

Por lo tanto, existen denominaciones o tecnicismos o términos que no han sido requeridos en las bases integradas del presente procedimiento de selección que no permite a este colegiado tener la certeza de acreditación de la característica técnica en cuestión.

Previamente se ha establecido características y condiciones técnicas el cual busca la adquisición de MONITORES DE FUNCIONES VITALES ADULTO/PEDIATRICO, TIPO FIJO DE 8 PARAMETROS PARA USO INTRAHOSPITALARIO para la atención a pacientes de unidad críticas.

**CARACTERISTICA DE FICHA HOMOLOGADA:**  
**POSTOR 1: TECNIMED SYSTEM S.A.**



De la evaluación de la propuesta presentada de manera integral y en cumplimiento de la presentación de documentos obligatorios según lo requerido en las bases integradas:

**No cumple con sustento técnico de las características solicitadas,** debido a la siguiente divergencia y omisión en la propuesta, las cuales no son subsanables dado que una modificación en ese supuesto impacta en los términos en los que se encuentra expresada una oferta y con ello, en el contenido esencial de esta y que a continuación se detallan.

#### CARACTERÍSTICAS 4.10.1 DE LA FICHA HOMOLOGADA

4.10	Capnografía (CO2)	
	En caso de ser Mainstream: El CO2 (CO2) se mide reemplazando con cable conectado al equipo, con los adaptadores necesarios por una sonda o sonda (40) adaptadores específicos de vias aéreas. Con los de calibración si el equipo lo requiere.	
4.10.1	Sensor de Capnografía	Estabilidad por el Método Volumétrico (20) Propios de agua, cuarenta (40) litros de muestra y veinte adaptadores específicos para sonda de vias aéreas. En caso de ser Mainstream: Volumétrico (20) litros de agua, cuarenta (40) litros de muestra y veinte adaptadores específicos para sonda de vias aéreas.

En el folio 84 y con las evidencias de su propuesta; el postor sustenta "En Caso de ser Sidestream:..."; a través de una declaración jurada, siendo esta una característica técnica, que debe ser acreditada a través de una carta del fabricante, según CAPÍTULO II: DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, numeral 2.2.1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE OFERTAS, de las Bases Integradas del Proceso de Selección





• **MONITOR DE FUNCIONES VITALES ADULTO/PEDIATRICO, TIPO  
FIO DE 8 PARAMETROS PARA USO INTRAHOSPITALARIO: 1.1 a  
1.9, 2.1.1 a 2.3.3, 3.1.1 a 3.8.2 y de 4.1 a 4.15.2**

**CARATERISTICA DE FICHA HOMOLOGADA:**

**POSTOR 2: GOLDEN MEDICAL TECH SAC.**

De la evaluación de la propuesta presentada de manera integral y en cumplimiento de la presentación de documentos obligatorios según lo requerido en las bases integradas:

No cumple con sustento técnico de las características solicitadas, debido a la siguiente divergencia y omisión en la propuesta, las cuales no son subsanables dado que una modificación en ese supuesto impacta en los términos en los que se encuentra expresada una oferta y con ello, en el contenido esencial de esta y que a continuación se detallan.

**CARACTERÍSTICAS 1.5 DE LA FICHA HOMOLOGADA**

1.5	Conexión a sistema de información hospitalaria	Mediante protocolo HL7
-----	--	------------------------

En el folio 31 y con las evidencias de su propuesta; el postor sustenta "el monitor admite protocolo HL7", no siendo claro y preciso, presenta información incompleta, al momento de acreditar "conexión a Sistema de Información Hospitalaria", cabe precisar que cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el Comité de Selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones. Así pues, toda información contenida en la oferta técnica o económica, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad"



## 6.5 Sistema de monitoreo central

El monitor puede conectarse al sistema de monitoreo central. A través de la red:

1. El monitor envía la información del paciente, la monitoriza en tiempo real o los datos de medición al sistema de monitoreo central.
2. La información del monitoreo en tiempo real se visualiza en el sistema de monitoreo central al igual que en el monitor, y el sistema de monitoreo central puede realizar cierto control bilateral. Por ejemplo: cambiar información del paciente, recibir a un paciente, dar de alta a un paciente y demás.

Para obtener información más detallada, consulte *Manual del usuario del sistema de monitoreo central Affi-M-CMS*.

Y el monitor admite el protocolo HL7 v2.3.1.



## CARACTERÍSTICAS 3.2.2. DE LA FICHA HOMOLOGADA

3.2.2	Método	Medición a través de cable ECG (método de impedancia) y a través de las vías aéreas mediante la capnografía
-------	--------	---

Establecido por el Ministerio

En el folio 37 y con las evidencias de su propuesta; el postor sustenta solo un Método de Medición de Frecuencia Respiratoria (FR), a través de Claves ECG, presenta información incompleta, al momento de acreditar "a través de las vías aéreas mediante la capnografía", cabe precisar que cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el Comité de Selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones. Así pues, toda información contenida en la oferta técnica o económica, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad".



## Capítulo 9 Monitoreo de RESP

### 9.1 Descripción general

El monitor mide la respiración del grado de impedancia torácica entre dos electrodos de ECG. El cambio de la impedancia entre los dos electrodos (debido al movimiento torácico) genera una forma de onda respiratoria en la pantalla. ← 3.2.1

#### CARACTERÍSTICA DE FICHA HOMOLOGADA:

POSTOR 3: CPB MEDICAL SAC.


De la evaluación de la propuesta presentada de manera integral y en cumplimiento de la presentación de documentos obligatorios según lo requerido en las bases integradas:

No cumple con sustento técnico de las características solicitadas, debido a la siguiente divergencia y omisión en la propuesta, las cuales no son subsanables dado que una modificación en ese supuesto impacta en los términos en los que se encuentra expresada una oferta y con ello, en el contenido esencial de ésta y que a continuación se detallan.

#### CARACTERÍSTICAS 1.5 DE LA FICHA HOMOLOGADA

1.5	Conexión a sistema de información hospitalaria	Mediante protocolo HL7
-----	--	------------------------

En el folio 31 y con las evidencias de su propuesta; el postor sustenta "el monitor admite protocolo HL7", no siendo claro y preciso, presenta información incompleta, al momento de acreditar "conexión a Sistema de Información Hospitalaria", cabe precisar que cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el Comité de Selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones. Así pues, toda información contenida en la oferta técnica o económica, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad"



## 6.5 Sistema de monitoreo central

El monitor puede conectarse al sistema de monitoreo central. A través de la red:

1. El monitor envía la información del paciente, la monitorea en tiempo real o los datos de medición al sistema de monitoreo central.
2. La información del monitoreo en tiempo real se visualiza en el sistema de monitoreo central al igual que en el monitor, y el sistema de monitoreo central puede realizar control bilateral. Por ejemplo: cambiar información del paciente, recibir a un paciente, dar de alta a un paciente y demás.

Para obtener información más detallada, consulte *Manual del usuario del sistema de monitoreo central MFM-C-V8*.

X el monitor admite el protocolo HL7.  1.3



### CARACTERÍSTICAS 3.3.1 DE LA FICHA HOMOLOGADA

3.3	Saturación de oxígeno (SpO2)	
3.3.1	Método de medición en condiciones de baja perfusión y/o movimiento	Tecnología de extracción de señales, o algoritmo de procesamiento de señales cardíacas

En el folio 269, con las evidencias de su propuesta, el postor sustenta Método de Medición en Condiciones de baja perfusión, no cumpliendo con lo solicitado "medición en condiciones de baja perfusión", cuando "se indica un bajo nivel de perfusión y una calidad de señal pobre en el sitio de monitoreo, se debe reposicionar el Sensor o hallar un mejor lugar", cabe precisar que cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el Comité de Selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones. Así pues, toda información contenida en la oferta técnica o económica, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concorde con lo requerido por la Entidad"

## 10.7 Índice de perfusión (IP)\*

\* Solo se aplica al módulo SpO<sub>2</sub> de EDAN

3.3.1

IP es un valor numérico indicador del nivel de perfusión. Refleja el nivel de perfusión en el sitio de monitoreo.

3.3.2

Dado que la medición de SpO<sub>2</sub> se basa en la pulsación causada por el flujo sanguíneo a través del vaso, IP tiene relación con la intensidad del pulso. Además, puede utilizarse IP como un indicador de calidad de la señal para la medición de SpO<sub>2</sub>.

El IP se indica con un valor que oscila entre 0 y 10. Entre más alto sea el valor, mejor será la perfusión y la calidad de señal. El nivel de perfusión y la calidad de señal llegan a su nivel máximo cuando se muestra un valor de 10. Cuando el IP es menor que 2, este indica un bajo nivel de perfusión y una calidad de señal pobre en el sitio de monitoreo, se debe repositionar el sensor o hallar un mejor lugar.

El valor de IP se mostrará en el área de parámetros de SpO<sub>2</sub>.

### CARACTERÍSTICA DE FICHA HOMOLOGADA:

#### POSTOR 3: CARDIO PULMONARY CARE SAC.

De la evaluación de la propuesta presentada de manera integral y en cumplimiento de la presentación de documentos obligatorios según lo requerido en las bases integradas:

**No cumple con sustento técnico de las características solicitadas**, debido a la siguiente divergencia y omisión en la propuesta, las cuales no son subsanables dado que una modificación en ese supuesto impacta en los términos en los que se encuentra expresada una oferta y con ello, en el contenido esencial de esta y que a continuación se detallan.

### CARACTERÍSTICAS 3.1.1 DE LA FICHA HOMOLOGADA


3.1	Electrocardiograma (ECG)	
3.1.1	Visualización en pantalla	Dos (02) ondas o más y un (01) valor numérico medido





En el folio 044, 064, 065 y con las evidencias de su propuesta; el postor sustenta visualización en pantalla, no cumpliendo con lo solicitado "Dos (02) ondas o más", en todos los extremos solo sustenta Una (01) Onda, cabe precisar que cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el Comité de Selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones. Así pues, toda información contenida en la oferta técnica o económica, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad"

♦ Pantalla de la forma de onda 3.1.1

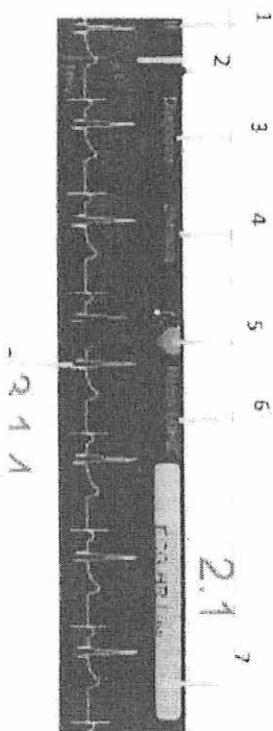


CARACTERÍSTICAS 3.3.1 DE LA FICHA HOMOLOGADA

3.3	Saturación de oxígeno (SpO <sub>2</sub> )	
3.3.1	Método de medición en condiciones de baja perfusión y/o movimiento	Tecnología de extracción de señales, o algoritmo de procesamiento de señales cardíacas

En el folio 023, 024, 025, 028 y con las evidencias de su propuesta; el postor sustenta el método de medición en condiciones de baja perfusión y/o movimiento, con un catálogo que pertenece a otro equipo que no es el ofertado, el método de medición no se encuentra sustentado en el catálogo y/o carta del fabricante, cabe precisar que cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el Comité de Selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones. Así pues, toda información contenida en la oferta técnica o económica, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad"

*[Handwritten signature]*

## Masimo SET: Disminuya los costos y mejore el proceso de atención

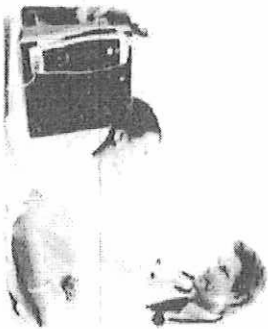

Estudios publicados demuestran un aumento en la eficiencia con la implementación de la pulsioximetría Masimo SET® en todos los entornos clínicos

### Con pulsioximetría Masimo SET®

no se requiere el uso de cables. La tecnología se encuentra en la categoría de dispositivos de diagnóstico y monitoreo de signos vitales.

### CARACTERÍSTICAS 3.3.5 DE LA FICHA HOMOLOGADA

3.3.5	Precisión	+/- 3% (+/- 3 dígitos) o menor, en el rango de 70 % a 100 %
-------	-----------	---

21/1

En el folio 134 y con las evidencias de su propuesta; el postor sustenta la PRECISIÓN de  $\pm 3\%$  (+/- 3 DIGITOS) O MENOR, EN EL RANGO DE 70% A 100%, existe una incongruencia en su sustento, cuando menciona los valores en su catálogo, indica que su PRECISIÓN es "en condiciones sin movimiento", contradiendo el sustento de la existencia de la tecnología MASIMO, cabe precisar que cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el Comité de Selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones. Así pues, toda información contenida en la oferta técnica o económica, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad

**Masimo SpA 1.2**

Medición de parámetro:	SpO <sub>2</sub> , SpMet, PVI, SpHb, SpOC, PI y SpCO
Rango de medición	0% a 100% <b>3.3.4</b>
Resolución	1%
Precisión	70% a 100% $\pm 2\%$ (Adulto/Pediatric, en condiciones sin movimiento) <b>3.3.5</b> 70% a 100% $\pm 3\%$ (Neonato, en condiciones sin movimiento) 0% a 69% sin especificar

La evaluación se sustenta en las Resoluciones: N° 1950-2019-TCE-S2 y N° 0235-2022-TCE-S4; donde se dice "... Al respecto, cabe precisar que cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el Comité de Selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones. Así pues, toda información contenida en la oferta técnica o económica, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad". (lo subrayado no es propio)



**FORMATO N° 11**  
**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:**

**1**      **NÚMERO DE ACTA**      001-2023-CS- AS-HOMOLOGACIÓN N°40-2023-GERESA/LL

**2**      **SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL**

En, las instalaciones de la oficina de UTF -ABASTECIMIENTO, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre del año 2023, en el local del Gerencia Regional de Salud de la Libertad , a las 12:00 pm horas, se reunieron los integrantes del comite designados mediante formato N° 004 AS-HOMOLOGACIÓN N°40-2023 GERESA/LL, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección AS HOMOLOGACIÓN N° 40-2023 GERESA/LL , cuyo objeto de convocatoria es "IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO (18) INCUBADORA NEONATAL AVANZADA PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD". ITEM 5 IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DOS (02) VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO NEONATAL + ALTA FRECUENCIA PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, a fin de efectuar la APERTURA DE LAS OFERTAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.

**3**      **SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)**

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	ECON. ANGEL DANIEL TEJADA NUÑEZ	Titular	X	Dependencia:	UTF-ABASTECIMIENTO
		Suplente			
Primer Miembro	ING. OSCAR IVAN DIAZ ARANA	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION
		Suplente			
Segundo Miembro	ING. DAVID LUNA GRANDEZ	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION
		Suplente			

**4**      **DETALLE DE LOS PARTICIPANTES**

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU	20100162238
2	ALBUJAR MEDICA S.A.C.	20130329471
3	MEDELCO SRL	20208310730
4	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	20340116055
5	BIOLOGIAS MEDICAS ANDINAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20454094221
6	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	20494151503
7	ABAMEDIC S.R.L.	20502626931
8	HEMOCARE S.A.C.	20505463146
9	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20512709088
10	CARDIOMED DEL PERU SAC	20520987186
11	CORPORACION DACMAR S.A.C.	20529457554
12	DRAEGER PERU S.A.C.	20538597121
13	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	20545804795
14	ASECO PERU S.A.C.	20565911920
15	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	20565935861
16	VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.	20601325153
17	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -	20601571065
18	ADVANCED MEDICAL INC E.I.R.L.	20602703003
19	VPM PROVEEDORES S.R.L.	20602922597
20	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	20603355289
21	NOVAMED PERU S.A.C.	20604537372
22	GAESA MEDIC E.I.R.L.	20606094834
23	NIMAT MEDICAL S.A.C.	20608071521
24	MEDICALDIST S.A.C.	20608573373
25	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	20610815341

**5**      **DETALLE DE LOS POSTORES**

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron sus ofertas en la plataforma digital del SEACE :

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	NOVAMED PERU S.A.C.	15/11/2023	21:41:55
2	DRAEGER PERU S.A.C.	15/11/2023	22:38:49

**6**      Acto seguido, se procede con la apertura de las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.

**7**      **DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS**

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Consigñar las razones para su no admisión
----	----------------------------------	---

1	DRAEGER PERU S.A.C.		NO CUMPLE Y SUSTENTA EL CUMPLIMIENTO DE EETT, PUESTO QUE ELLOS SUSTENTAN EN SU FOLIO 294, 295 Y 296	
---	---------------------	--	---	--

8	<b>DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN</b>			
De acuerdo con la revisión efectuada por el comité, así como el cumplimiento de las especificaciones del ingeniero equipador parte de este colegiado y validando su cumplimiento, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:				
Nº	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula		
1	NOVAMED PERU S.A.C.	ITEM 5 IIOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DOS (02) VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO NEONATAL + ALTA FRECUENCIA PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		

9	<b>EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS</b>			
9.1	<b>DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA</b>			
Nº	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial	
1	NOVAMED PERU S.A.C.	S/ 432,000.00	99.63%	
9.2	<b>DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>			
La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo 01 que forma parte de la presente Acta.				

10	<b>PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES</b>			
COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR				
10.1	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1</b>		NOVAMED PERU S.A.C.	
	<b>FACTORES</b>		<b>PUNTAJES</b>	
	PRECIO		70	
	PLAZO DE ENTREGA		20	
	MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		0	
	BONIFICACION MYPE		4.5	
	<b>SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES</b>		<b>94.5 PUNTOS</b>	

11	<b>CALIFICACIÓN</b>			
Luego de culminada la evaluación, el Comité de selección determinó si el postor que obtuvo el primer lugar según los requisitos de				
11.1	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1</b>		NOVAMED PERU S.A.C.	
	<b>REQUISITOS DE CALIFICACIÓN</b>		<b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR	X	
	B	CAPACIDAD LEGAL	X	
	C	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL	X	
	<b>RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN</b>		<b>CUMPLE</b>	

12	<b>RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN</b>			
De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo la buena pro, cumple con los requisitos de calificación establecidos en las bases:				
Nº	<b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR</b>			
1	NOVAMED PERU S.A.C.			
DE SER EL CASO INCLUIR:				
Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases:				
Nº	<b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR</b>	<b>CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN</b>		
1	XXXXXX	XXXXXXXXXX		




Que, mediante carta NOVAMED-COR-264/2023 de fecha 28 de noviembre de 2023, señala que "(...) debemos indicar que haciendo una evaluación de los costos a incurrir en el bien a contratar hemos considerado por esta ocasión hacer un reajuste en el precio de la oferta económica (...) **PRECIO TOTAL REDUCIDO S/ 432, 000.00"**

14	<b>REDUCCIÓN DEL PRECIO DE LA OFERTA</b>			
Nº	Nombre o razón social del postor	<b>Aceptó reducción de su oferta</b>		
1	NOVAMED PERU S.A.C.	Si	X	
		No		

15	<b>ACUERDO ADOPTADO</b>			
Los integrantes del comité de selección por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.				

15	  			
	Egoñ, Angel Daniel Tejeda Nuñez Presidente Titular ING. OSCAR VAN DIAZ ARANA Primer Miembro ING. DAVID LUNA GRANDEZ Segundo Miembro			
	<b>NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>			



NOVAMED-COR-264/2023

Lima, 28 de Noviembre del 2023

Señores  
**GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD**  
Presente.-

Atte.: Lic. Angel Daniel Tejeda Nuñez  
Presidente de Comité de Selección

Ref.: Reducción de la Oferta Económica

Estimados Señores:

Por la presente, en respuesta a vuestra solicitud con carta N° 01-2023-CS sobre **REDUCCION DE OFERTA ECONOMICA**, en el proceso **Adjudicación Simplificada Homologación N° 40-2023-GERESALL ITEM N° 5**, debemos indicar que haciendo una evaluación de los costos a incurrir en el bien a contratar hemos considerado por esta ocasión hacer un reajuste en el precio de la oferta económica de la siguiente manera:

**PRECIO REAJUSTADO**


ITEM N°	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL OFERTADO S/	PRECIO TOTAL REDUCIDO S/
05	IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DOS (02) VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO NEONATAL + ALTA FRECUENCIA PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	02	436,000.00	432,000.00

Adjunto al presente, remitimos el **Anexo N° 6** debidamente firmada por nuestra Representante Legal.

Sin otro particular, quedamos como siempre atentos a sus gratas órdenes.

Atentamente,

NOVAMED PERÚ S.A.C.

  
-----  
Valeria Geraldine Valdiviezo Shaplama  
GERENTE GENERAL



**ANEXO N° 06****ITEM 5****PRECIO DE LA OFERTA**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA HOMOLOGACIÓN N° 040-2023-GERESALL**  
Presente.-


De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

PRESTACION	DESCRIPCION	PRECIO TOTAL S/
<b>PRINCIPAL</b>	IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DOS (02) VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO NEONATAL + ALTA FRECUENCIA PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	428,000.00
	CAPACITACION	
<b>ACCESORIAS</b>	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	4,000.00
<b>TOTAL S/</b>		<b>432,000.00</b>

El precio de la oferta en **SOLES** incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos

**NOVAMED PERÚ S.A.C.**

  
Valeria Geraldine Valdiviezo Shaplama  
GERENTE GENERAL

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o**  
**Representante legal o común, según corresponda**

**FORMATO N° 11**  
**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:**

<b>1</b>	<b>NÚMERO DE ACTA</b>	001-2023-CS- AS-HOMOLOGACIÓN N°40-2023-GERESA/LL
----------	-----------------------	--

<b>2</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b> En, las instalaciones de la oficina de UTF -ABASTECIMIENTO, a los veinte y siete (27) días del mes de noviembre del año 2023, en el local del Gerencia Regional de Salud de la Libertad , a las 02:30 pm horas, se reunieron los integrantes del comité designados mediante formato N° 004 AS-HOMOLOGACIÓN N°40-2023 GERESA/LL, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección AS-HOMOLOGACIÓN N° 40-2023 GERESA/LL , cuyo objeto de convocatoria es "IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO (18) INCUBADORA NEONATAL AVANZADA PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", ITEM 5 IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DOS (02) VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO NEONATAL + ALTA FRECUENCIA PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, a fin de efectuar la APERTURA DE LAS OFERTAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.
----------	---

3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)				
	El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:				
	Presidente	ECON. ANGEL DANIEL TEJADA NUÑEZ	Titular	X	Dependencia: UTF-ABASTECIMIENTO
			Suplente		
	Primer Miembro	ING. OSCAR IVAN DIAZ ARANA	Titular	X	Dependencia: OFICINA DE PLANIFICACION
			Suplente		
	Segundo Miembro	ING. DAVID LUNA GRANDEZ	Titular	X	Dependencia: OFICINA DE PLANIFICACION
		Suplente			

4

DETALLE DE LOS PARTICIPANTES		
De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:		
Nº	Nombre o razón social del participante	RUC
1	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	20100162238
2	ALBUJAR MEDICA S.A.C.	20130329471
3	MEDELCO SRL	20208310730
4	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	20340116055
5	BIOLOGIAS MEDICAS ANDINAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20454094221
6	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	20494151503
7	ABAMEDIC S.R.L.	20502626931
8	HEMOCARE S.A.C.	20505463146
9	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20512709088
10	CARDIOMED DEL PERU SAC	20520987186
11	CORPORACION DACMAR S.A.C.	20529457554
12	DRAEGER PERU S.A.C.	20538597121
13	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	20545804795
14	ASECO PERU S.A.C.	20565911920
15	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	20565935861
16	VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.	20601325153
17	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK	20601571065
18	ADVANCED MEDICAL INC E.I.R.L.	20602703003
19	VPM PROVEEDORES S.R.L.	20602922597
20	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	20603355289
21	NOVAMED PERU S.A.C.	20604537372
22	GAESA MEDIC E.I.R.L.	20606094834
23	NIMAT MEDICAL S.A.C.	20608071521
24	MEDICALDIST S.A.C.	20608573373
25	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	20610815341

5	<b>DETALLE DE LOS POSTORES</b>			
	En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron sus ofertas en la plataforma digital del SEACE :			
	Nº	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
	1	NOVAMED PERU S.A.C.	15/11/2023	21:41:55
	2	DRAEGER PERU S.A.C.	15/11/2023	22:38:49

<b>6</b>	Acto seguido, se procede con la apertura de las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la
----------	---

7	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS		
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:		
	Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión



	1	DRAEGER PERU S.A.C.	NO CUMPLE Y SUSTENTA EL CUMPLIMIENTO DE EETT, PUESTO QUE ELLOS SUSTENTAN EN SU FOLIO 294, 295 Y 296	
--	---	---------------------	---	--

8	<b>DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN</b>			
	De acuerdo con la revisión efectuada por el comité, así como el cumplimiento de las especificaciones del ingeniero equipador parte de este			
	Nº	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula	
	1	NOVAMED PERU S.A.C.	ITEM 5 IIOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DOS (02) VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO NEONATAL + ALTA FRECUENCIA PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTADNTO LA LIBERTAD	

9	<b>EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS</b>			
	9.1	<b>DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA</b>		
	Nº	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
	1	NOVAMED PERU S.A.C.	S/ 436,000.00	100.55%
	9.2	<b>DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>		
	La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo 01 que forma parte de la presente Acta.			

10	<b>PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES</b>			
	COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR			
	10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1	NOVAMED PERU S.A.C.	
		FACTORES		PUNTAJES
		PRECIO		70
		PLAZO DE ENTREGA		20
		MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS		0
	BONIFICACION MYPE		4.5	
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		94.5 PUNTOS	

11	<b>CALIFICACIÓN</b>			
	Luego de culminada la evaluación, el Comité de selección determinó si el postor que obtuvo el primer lugar según los requisitos de calificación			
	11.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1	NOVAMED PERU S.A.C.	
		REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR	X	
	B	CAPACIDAD LEGAL	X	
	C	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN	CUMPLE		




  

12	<b>RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN</b>			
	De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo la buena pro, cumple con los requisitos de calificación establecidos en las bases:			
	Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR		
	1	NOVAMED PERU S.A.C.		
	DE SER EL CASO INCLUIR:			
	Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases:			
	Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN	
1	xxxxxx	xxxxxxxx		

13	<b>ACUERDO ADOPTADO</b>		
	Los integrantes del comité de selección por UNANIMIDAD, remitir carta N° 01-2023-CS, traves de correo electronico a postor NOVAMED PERU SAC, con la finalidad que acepte la solicitud de reducción de oferta y posterior otorgamiento de Buena Pro, en razón al art 68° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.		

14	  		
	Econ. Angel Daniel Tejada Nuñez Présidente Titular		
	ING. OSCAR IVAN DIAZ ARANA Primer Miembro		
ING. DAVID LUNA GRANDEZ Segundo Miembro			
<b>NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>			

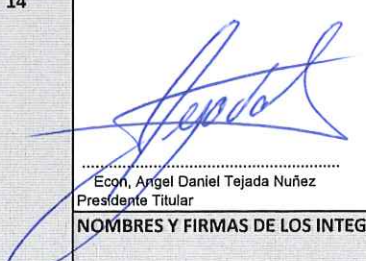

IOARR 2601427: ADQUISICIÓN DE DOS (02) VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO NEONATAL + ALTA FRECUENCIA PARA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		02 UNIDADES	
MONTO DISPONIBLE		S/ 433,600.00	
POSTORES		NOVAMED PERU SAC	DRAGER
RUC		20604537372	20538597121
DOCUMENTOS PARA ADMISION DE OFERTAS ITEM 05			
DECLARACION JURADA DEL POSTOR ANEXO 01		CONFORME	CONFORME
COPIA CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL COPIA DE DNI	VIGENCIA PODER	CONFORME	CONFORME
DECLARACION JURADA ANEXO 2	ANEXO 02	CONFORME	CONFORME
DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 01	ANEXO 03	CONFORME	CONFORME
ACREDITACION DE ESPECIFICACIONES		CUMPLE	NO CUMPLE
CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELECTRICA		CONFORME	CONFORME
COPIA DEL CERTIFICADO ISO 13485		CONFORME	CONFORME
REGISTRO SANITARIO		CONFORME	CONFORME
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE ENTREGA	ANEXO 04	CONFORME-40 DIAS	CONFORME -65 DIAS
PROMESA DE CONSORCIO	ANEXO 05	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
PRECIO OFERTA	ANEXO 06	CONFORME	CONFORME
DOCUMENTACION DE PRESENTACION FACULTATIVA			
BONIFICACION DE MYPE	5%	CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
PUNTAJES			
VALOR OFERTA		S/ 436,000.00	S/ 336,000.40
% DEL VALOR DE OFERTA		100.55%	
PRECIO		70	
PLAZO DE ENTREGA		20	
MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS		0	
TOTAL FACTORES		90	
BONIFICACION MYPE		4.5	
PUNTAJE TOTAL		94.5	

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR REQUISITOS DE CALIFICACION		
EXPERIENCIA DEL POSTOR	CONFORME	CONFORME
CAPACIDAD LEGAL	CONFORME	CONFORME
CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL	CONFORME	CONFORME

**AS Nº 040-2023-GERESALL  
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS**

ITEM 5		<b>VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO NEONATAL + ALTA FRECUENCIA</b>	
POSTOR 1		DRAEGER PERU SAC	
POSTOR 2		NOVAMED PERU SAC	
		ESPECIFICACIONES TECNICAS	
A	CARACTERISTICAS/CONDICIONES	ESPECIFICACIONES	
A01	BASE	RODABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO O FRENSOS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A02	PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO	VENTILACION CONTROLADA O LIMITADO POR PRESION	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A03	TIPO DE SINCRONIZACION	POR FLUIDO, COMO MINIMO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A04	VISUALIZACION DE GRAFICAS	DE ONDAS GRAFICAS Y LAZOS EN TIEMPO REAL	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A05	SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE MEDICINAL	INTEGRADO O INCORPORADO EN LA MISMA ESTRUCTURA DEL VENTILADOR	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A06	FUNCION/MANIOBRA/PROCEDIMIENTO ESPECIAL	RESPIRACION MANUAL O INSPIRACION MANUAL	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A07	CAPACIDAD DE SUMINISTRAR VOLUMENES TIDALES	DESDE 2ML O MENOS, HASTA 100 ML O MAS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A08	MONITOR (TAMAÑO DE PANTALLA)	10 PULGADAS COMO MINIMO (VEASE NOTA 2)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A09	FACILIDAD DE USO EN VENTILACION CONVENCIONAL A VENTILACION DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA HFO	CAMBIO DE MODO DE VENTILACION CONVENCIONAL A MODO DE VENTILACION ALTA FRECUENCIA Y VICEVERSA SIN NECESIDAD DE CAMBIAR EL CIRCUITO PACIENTE	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
<b>MODALIDAD DE VENTILACION</b>			
A10	ASISTIDO/CONTROLADO (MECANISMO DE ACCIONAMIENTO: TRIGGER POR FLUIDO COMO MINIMO)	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A11	SIMV (VENTILACION MANDATORIA INTERMITENTE SINCRONIZADA)	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A12	CPAP (PRESION POSITIVA CONTINUA EN LA VIA AEREA)	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A13	VENTILACION DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA (HFO) CON VOLUMEN GARANTIZADO	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A14	PRESION SOPORTE (PS)	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A15	VOLUMEN GARANTIZADO (VOLUMEN ASEGURADO O VOLUMEN CONTROLADO O VOLUMEN LIMITE), CON REGULACION AUTOMATICA DE LA PRESION INSPIRATORIA	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A16	VENTILACION NO INVASIVA	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A17	COMPENSACION DE FUGAS	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A18	TERAPIA DE OXIGENO DE ALTO FLUIDO	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
<b>CONTROLES CON PROGRAMACION DIRECTA</b>			
A19	FRECUENCIA RESPIRATORIA (RESPIRACION MINUTO)	10 O MENOS A 100 O MAS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT



A20	FRACCION INSPIRATORIA (FIO2) %	21 A 100	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A21	TIEMPO INSPIRATORIO	0,1 S O MENOS, A 2 S O MAS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A22	PICO DE PRESION INSPIRATORIA	10CMH2O O MENOS, A 60CMH2O O MAS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A23	ALTA FRECUENCIA	5 HZ O MENOS, A 15HZ O MAS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A24	PRESION POSITIVA AL FINAL DE LA EXPIRACION (PEEP)	3CMH2O O MENOS, A 30CMH2O O MAS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A25	DISPARO	POR FLUJO COMO MINIMO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
<b>MONITOREO DE PARAMETROS</b>				
A26	FRECUENCIA RESPIRATORIA	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A27	PRESION PICO INSPIRATORIO (PIP)	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A28	PRESION MEDIA DE VIAS AEREAS O RESPIRATORIAS	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A29	VOLUMEN TIDAL (VT)	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A30	VOLUMEN MINUTO (VM)	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A31	PRESION POSITIVA AL FINAL DE LA EXPIRACION (PEEP)	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A32	FRACCION INSPIRATORIA DE OXIGENO (FIO2)	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A33	CAPNOGRAFIA DE USO NEONATAL (ETCO2)	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A34	DCO2	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A35	RELACION I:E	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
<b>ALARMAS</b>				
A36	ALTA PRESION DE VIAS AEREAS	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A37	BAJA PRESION DE VIAS AEREAS O DESCONEXION	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A38	APNEA	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A39	ALTO/BAJO VOLUMEN MINUTO	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A40	ALTA/BAJA CONCENTRACION DE OXIGENO	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A41	FALLA DE SUMINISTRO DE GASES	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A42	PRESION POSITIVA AL FINAL DE LA EXPIRACION	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A43	ALTA/BAJA ETCO2	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
A44	RED ELECTRICA	DE FALLA ELECTRICA (RED Y/O BATERIA BAJA)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
<b>COMPONENTES</b>				
<b>HUMIDIFICADOR PARA USO EN TRATAMIENTO INVASIVO Y NO INVASIVO</b>				
B01	RANGO DE TEMPERATURA	31°C A 40°C O RANGO MAS AMPLIO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
B02	TEMPERATURA DE VIAS AEREAS	VISUALIZACION DE TEMPERATURA DE VIAS AEREAS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT



B03	TEMPERATURA DE SALIDA DE CAMARA	VISUALIZACION DE TEMPERATURA DE LA CAMARA	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
B04	CALENTADOR	TIPO HILO-CALENTE	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
B05	SILENCIADOR DE ALARMA	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
B06	ALARMAS DE TEMPERATURA Y/O HUMEDAD	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
<b>CARACTERISTICAS</b>		<b>ESPECIFICACION</b>		
C01	JUEGO COMPLETO DE CIRCUITO PACIENTE NEONATAL, PARA TODOS LOS MODOS DE HUMIDIFICACION	VENTILATORIOS, REUSABLE - ESTERILIZABLE (INCLUYE CAMARA DE HUMIDIFICACION)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
CANTIDAD		CINCO (05)		
C02	JUEGO COMPLETO DE CIRCUITO PACIENTE NEONATAL, PARA TODOS LOS MODOS DE AUTOLENADO Y CALENTAMIENTO EN AMBAS RAMAS INSPIRATORIO Y EXPIRATORIO	VENTILATORIOS DESCARTABLE (CON CAMARA DE HUMIDIFICACION, CON SISTEMA	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
CANTIDAD		VEINTE (20)		
C03	JUEGO COMPLETO PARA VENTILACION NO INVASIVA DESCARTABLE (GORROS, INTERFACE O GENERADOR O ADAPTADOR O CORRUGADO, (TRES (03) MASCARILLAS DE TAMAÑOS: S, M, L; TRES (03) PRONG NASAL DE TAMAÑOS S, M, L)		CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
CANTIDAD		SEIS (06)		
C04	CANULA PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO DE TRES TAMAÑOS DIFERENTES (DOS (02) S, DOS (02) M, DOS (02) L)		CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
CANTIDAD		SEIS (06)		
C05	PULMONES DE PRUEBA NEONATAL		CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
CANTIDAD		DOS (02)		
C06	BRAZO SOPORTE DE CIRCUITO PACIENTE	ARTICULADO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
CANTIDAD				
C07	MANGUERAS DE OXIGENO Y DE AIRE MEDICINAL	TIPO DISS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
CANTIDAD				
C08	NEBULIZADOR CON ACCESORIOS COMPLETOS	MICROBOMBA O ULTRASONICO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
CANTIDAD				
C09	SENSOR DE FLUJO (VEASE NOTA 3)			
TIPO		REUSABLE, ESTERILIZABLE	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
CANTIDAD		DOCE (12)		
C10	JUEGOS DE CABLES PARA EL CALENTADOR PARA USO EN CIRCUITO REUSABLE (SENSOR DE TEMPERATURA Y CABLE ADAPTADOR)		CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
CANTIDAD		DOS (02)		
C11	CABLE ADAPTADOR PARA EL CALENTADOR PARA USO EN CIRCUITO DESCARTABLE (DOBLE RAMA)		CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
CANTIDAD		DOS (02)		
C12	VALVULAS DE EXHALACION COMPLETAS O CASSETTE ESPIRATORIO		CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT

TIPO	REUSABLE – ESTERILIZABLE			
CANTIDAD	TRES (03)			
C13 ESTABILIZADOR DE VOLTAJE (VEASE NOTA 4)				
TIPO	ESTADO SOLIDO CON LINEA A TIERRA		CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
RANGO DE VARIACION DE LA TENSION ELECTRICA DE SALIDA	MENOR O IGUAL A +/- 3%			
POTENCIA	SUPERIOR EN 25% O MAS DE LA POTENCIA NOMINAL DEL EQUIPO Y COMPONENTE			
C14 BATERIA(S) INTERNA RECARGABLE(S)			NO CUMPLE Y SUSTENTA EL CUMPLIMIENTO DE EETT, PUESTO QUE ELLOS SUSTENTAN EN SU POLO 294, 295 Y 296	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
AUTONOMIA	DOS (02) HORAS O MAYOR			
C15 REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES				
REQUISITOS DEPENDIENTES DEL CONTEXTO	ALTITUD: HASTA 3000 MENOR O MAYOR		CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
D01	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	Cumplir con lo establecido en la subregla 2, Regla 020-500 del código de la referencia.	Código nacional de electricidad-utilización aprobado por resolución ministerial N° 037-2006-MEM/DM	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
D02	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	Cumplir con lo establecido en la regla 020-502 del código de la referencia	Código nacional de electricidad-utilización aprobado por resolución ministerial N° 037-2006-MEM/DM	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
D03	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	1.- cumplir con la aplicación del diagrama 1 del artículo 2 del	1.- R.M. N°175-2008-MEM/DM	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
		2.- cumplir con los requerimientos establecidos en el momento.	2.- NTP IEC60884 -1:2013(revisa el 2018) enchufes y tomacorrientes para uso doméstico y propósitos similares, parte 1: requerimientos generales.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
	MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS			
1	TECNICA DE OSCILACION FORZADA (FOT) Y VENTILACION NO INVASIVA CON FLUJO VARIABLE A DEMANDA		NO CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
2	HERRAMIENTA DE VIGILANCIA DE LA DINAMICA VENTILATORIA DEL PACIENTE QUE MUESTRE DE MANERA GRAFICA LOS CAMBIOS EN LA COMPLIANCE Y RESISTENCIA EN TIEMPO REAL, ADEMAS DE EL MOVIMIENTO DEL DIAFRAGMA COMO RESPIRACIONES ESPONTANEAS DEL PACIENTE Y LA PROPORCION DE TRABAJO RESPIRATORIO DEL PACIENTE Y DEL VENTILADOR		CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	NO CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT

POSTOR 1: DRAEGER PERU SA	NO CUMPLE, NO SE VALIDA PROPUESTA TECNICA PRESENTADA
POSTOR 2: NOVAMED PERU SAC	CUMPLE, SE VALIDA PROPUESTA TECNICA PRESENTADA



**CARATERISTICA DE FICHA HOMOLOGADA:**

**POSTOR: DRAEGER PERU SAC**

De la evaluación de la propuesta presentada de manera integral y en cumplimiento de la presentación de documentos obligatorios según lo requerido en las bases integradas:

**No cumple con sustento técnico de las características solicitadas**, debido a la siguiente divergencia y omisión en la propuesta, las cuales no son subsanables dado que una modificación en ese supuesto impacta en los términos en los que se encuentra expresada una oferta y con ello, en el contenido esencial de esta y que a continuación se detallan.

**CARATERISTICA DE FICHA HOMOLOGADA:**

**POSTOR: DRAEGER PERU SAC**

De la evaluación de la propuesta presentada de manera integral y en cumplimiento de la presentación de documentos obligatorios según lo requerido en las bases integradas:

**No cumple con sustento técnico de las características solicitadas**, debido a la siguiente divergencia y omisión en la propuesta, las cuales no son subsanables dado que una modificación en ese supuesto impacta en los términos en los que se encuentra expresada una oferta y con ello, en el contenido esencial de esta y que a continuación se detallan

**CARACTERÍSTICAS A32 DE LA FICHA HOMOLOGADA**

C14. Batería(s) interna recargable(s)	
Autonomía	Dos (02) horas o mayor

DE ACUERDO A LAS BASES INTEGRADAS EL CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACION TECNICA C14 "BATERIAS INTERNA RECARGABLE(S): DOS (02) HORAS O MAYOR" señalamos que se solicita que el ventilador tenga una batería INTERNA y con dos horas de batería, DEL FOLIO 294 de la oferta es una transcripción de la especificación técnica solicitada de las bases integradas del proceso. DEL FOLIO 295 menciona el postor que tiene dos tipos de baterías siendo la GS500 Con autonomía de 30 minutos, DEL FOLIO 296 se aprecia la configuración y componentes del equipo ofertado siendo donde el componente N° 2 indica a el ventilador y el componente



Nº4 menciona **PS500 UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACION** del mismo indica claramente que la batería es externa. De tal forma el postor no cumple las especificaciones técnicas mínimas solicitadas en las bases del proceso.

La evaluación se sustenta en las Resoluciones: N° 1950-2019-TCE-S2 y N° 0235-2022-TCE-S4; donde se dice "... **Al respecto, cabe precisar que cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el Comité de Selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones. Así pues, toda información contenida en la oferta técnica o económica, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad**". (lo subrayado no es propio)

Al respecto, como parte de la documentación obligatoria de las bases integradas se ha requerido la presentación "FORMATO N°01 "Hoja de presentación del equipo/ sustento de cumplimientos de características técnicas" mediante el cual, los postores deben demostrar fehacientemente que el bien ofertado cumplió con las especificaciones técnicas y características técnicas solicitadas.

" Por el contrario, de presentarse una oferta profusa, difusa y confusa, imposibilitando al comité de selección determinar fehacientemente el real alcance de la misma, este deberá no admitirla o descalificarla, según corresponda, pues no es función de dicho órgano interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, o precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado, en función a las condiciones expresamente detalladas, sin posibilidad, como se indicó, de inferir o interpretar hecho alguno.

Teniendo en cuenta lo señalado párrafos anteriores, se procesó a revisar los folios señalados por el postor para dar cumplimiento a las características técnicas, el cual el postor **DRAEGER PERU SAC** no cumple con las especificaciones técnicas mínima solicitadas en el proceso de selección.