

FORMATO N° 11**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:****ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 030-2023-DIRSAPOL-1****ADQUISICION DE FRASCOS VIALES DE VIDRIO BOROSILICATO TRANSPARENTE X 10 ML CON TAPA DE GOMA PARA LAS SEDES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE DOSAJE ETILICO - DIRSAPOL****1 NÚMERO DE ACTA****004-2023-CS/AS N° 030-2023-DIRSAPOL-1****2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL**

En, el distrito de Miraflores, Provincia de Lima, Departamento de Lima, a los 09 días del mes de noviembre del año 2023, en el local de la Dirección de Sanidad Policial - Av. Arequipa cdra. 4898, a las 10:00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Formato N° 04, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N° 030-2023-DIRSAPOL-1, cuyo objeto de convocatoria es la ADQUISICION DE FRASCOS VIALES DE VIDRIO BOROSILICATO TRANSPARENTE X 10 ML CON TAPA DE GOMA PARA LAS SEDES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE DOSAJE ETILICO - DIRSAPOL, a fin de efectuar la ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	JESSICA ELIZABETH DIAZ FLORES	Titular	X	Dependencia:	UNIDDE
		Suplente			
Primer Miembro	YORMAN ROLLER CASTRO PABLO	Titular	X	Dependencia:	AREA DE ABASTECIMIENTO
		Suplente			
Segundo Miembro	LEANDRO JAVIER ROCCA CAMPOS	Titular	X	Dependencia:	AREA DE ABASTECIMIENTO
		Suplente			

4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	SANCHEZ FLORES LUIS HUMBERTO	10003740582
2	QUISPE LAPA YANINA ESTEFANY	10724401479
3	CORPORACION ALESSANDRA S.A.C.	20509882101
4	CORPORACION MEDICAL BERTH'S S.A.C.	20523370201
5	ABASTECIMIENTO MEDICO TOTAL S.A.C.	20554146881
6	ADVANCE SCIENTIF MEDIC S.A.C.	20563641887
7	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	20600481593
8	LABORATORIO MUNDO MEDIC S.A.C.	20602215122

5 DETALLE DE LOS POSTORES

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron a través del Se@ce de la Entidad sus ofertas en sobre cerrado:

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	CORPORACION MEDICAL BERTH'S S.A.C.	6/11/2023	21:29:24
2	LABORATORIO MUNDO MEDIC S.A.C.	6/11/2023	21:19:12

6 Acto seguido, se procede con la apertura de los sobres que contienen las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.

7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

FORMATO N° 11

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 030-2023-DIRSAPOL-1
ADQUISICION DE FRASCOS VIALES DE VIDRIO BOROSILICATO TRANSPARENTE X 10 ML CON TAPA
DE GOMA PARA LAS SEDES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE DOSAJE ETILICO - DIRSAPOL**

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión	
1	CORPORACION MEDICAL BERTH'S S.A.C.	NO CUMPLE, SEGÚN LA MUESTRA PRESENTADA SE INFORMA LO SIGUIENTE: -SI CUMPLE EN RELACION A ALTA RESISTENCIA A LOS CAMBIOS TERMICOS -NO CUMPLE EN RELACION A RESISTENCIA A FUERZA MECANICA SEGÚN INFORME DE VALIDACION DE MUESTRA REALIZADA POR LOS REPRESENTANTES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE DOSAJE ETILICO	

8	DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN		
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:			
N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula	
1	LABORATORIO MUNDO MEDIC S.A.C.	1	




9	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS		
9.1	DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA		
N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
2	LABORATORIO MUNDO MEDIC S.A.C.	98,000.00	100.00

10	PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES		
COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR			
10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	LABORATORIO MUNDO MEDIC S.A.C.	
	FACTORES	PUNTAJES	
	PRECIO	100 puntos	
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos	

11	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN		
De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:			
N° DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL	
1	LABORATORIO MUNDO MEDIC S.A.C.	100	
Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.			

12	CALIFICACIÓN		
Luego de culminada la evaluación, el Comité de seleccion determinó si el postor que obtuvo el primer y segundo lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:			
12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	LABORATORIO MUNDO MEDIC S.A.C.	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
	B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
	B.1 FACTURACIÓN	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN	CALIFICADO	

13	RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN
-----------	--------------------------------------


FORMATO N° 11**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:****ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 030-2023-DIRSAPOL-1****ADQUISICION DE FRASCOS VIALES DE VIDRIO BOROSILICATO TRANSPARENTE X 10 ML CON TAPA DE GOMA PARA LAS SEDES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE DOSAJE ETILICO - DIRSAPOL**

De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el primer lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
1	LABORATORIO MUNDO MEDIC S.A.C.

14 ACUERDO ADOPTADO


Los integrantes del Comité de selección, por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.

15

JESSICA ELIZABETH DIAZ FLORES
NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN



YORMAN ROLLER CASTRO PABLO
NOMBRE Y FIRMA DEL PRIMER MIEMBRO



LEANDRO JAVIER ROCCA CAMPOS
NOMBRE Y FIRMA DEL SEGUNDO MIEMBRO



PERÚ

Ministerio
del Interior

Policía
Nacional del Perú

Dirección de
Sanidad Policial

Unidad Desconcentrada
Dosaje Etílico SUB DSP

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Surquillo, 09 de noviembre del 2023.

OFICIO N° 875-2023-DIRSAPOL.SUBDIRSAPOL.OFISECOM.UNIDDE.JEF.

SEÑOR (A) : CRNL SPNP
Jessica DIAZ FLORES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN AS-030-2023-
DIRSAPOL-1

ASUNTO : Remite informe referente a evaluación de las muestras remitidas
de los postores de la Adjudicación Simplificada N° 030-2023-
DIRSAPOL-1

REF. : OFICIO N° 001 -2023-AS-030-2023-DIRSAPOL

Me es grato dirigirme a Ud; con la finalidad de remitir adjunto al presente, el informe referente a la evaluación que se ha realizado a las muestras remitidas por los postores de la adjudicación Simplificada N° 030-2023-DIRSAPOL-1. Dando cumplimiento a lo solicitado en el documento de la referencia.

POSTORES:

- Corporación Medical Berth's S.A.C.
- Laboratorio Mundo Medic S.A.C.

Valga la oportunidad para renovarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Dios guarde a Ud.



OS-271109
José Dennis CABEZUDO REATEGUI
CORONEL SPNP
JEFE UNIDAD DESCONCENTRADA
DOSAJE ETILICO SUBDIR DSP

JDCR/RARM
Folios (05)

**PERÚ****Ministerio
del Interior****Policía
Nacional del Perú****Dirección de
Sanidad Policial****Unidad Desconcentrada
Dosaje Etílico SUB DSP****"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"****EVALUACION DE LAS MUESTRAS DE LOS POSTORES DE LA ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 030-2023-DIRSAPOL-1**

Empresa: Corporación Medical Berth's S.A.C.

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO
1	FRASCOS VIALES DE VIDRIO BOROSILICATO TRANSPARENTE X 10 ML	X	

Corporación Medical Berth's S.A.C.	SI	NO
Se verifica el cumplimiento de los términos de referencia presentada por el participante	X	
EVALUACION DEL PRODUCTO		
Se basa en verificar el acabado y color, dimensiones, resistencia, sellado, espesor de los envases.		
Envase de vidrio neutro de resistencia hidrolítica Tipo I	X	
Apropiado para sangre y hemoderivados.	X	
Vial incoloro	X	
Diámetro externo de boca: 19.80mm ± 0.25 aprox.	X	
Diámetro interno de boca: 12.60mm ± 0.25mm aprox.	X	
Espesor de labio: 3.60 ± 0.20mm aprox.	X	
Espesor de fondo: 0.70 mínimo.	X	
Diámetro de cuerpo: 22.50 ± 0.25mm aprox.	X	
Radio de fondo: 1.50 aprox.	X	
Concavidad: 1.00 máximo.	X	
Altura total: 46.50 mm ± 0.50mm aprox.	X	
Espesor de pared: 1.10mm ± 0.5 aprox.	X	
ACABADO Y COLOR		
El acabado en las superficies de los frascos viales debe ser libre de manchas, burbujas, orificios, roturas, suciedad, deformaciones, mal sellado y cualquier otro defecto que afecte la funcionalidad.	X	
PRUEBA DE RESISTENCIA		
Alta resistencia a los cambios térmicos. El material deberá resistir temperaturas de 110°C a más	X	
Material resistente a fuerza mecánica. No debe estallar, no debe rajarse a realizarse la ruptura.		X
ENCARGADOS DE LA EVALUACION DE LAS MUESTRAS		
CRNL SPNP CABEZUDO REATEGUI José Dennis – Jefe de la UNIDDE		
CMDTE SPNP RUIZ MORA Rosa Antonia – Jefe de Logística de la UNIDDE		
LUGAR DONDE SE EVALUA LAS MUESTRAS		
UNIDAD DESCONCENTRADA DE DOSAJE ETILICO		
CONCLUSION		
No cumple la prueba de resistencia a la fuerza mecánica, estalla y se rompe en fragmentos pequeños el 100 % de viales sometidos a esta prueba		





PERÚ


Ministerio
del Interior

Policía
Nacional del Perú


Dirección de
Sanidad Policial

Unidad Desconcentrada
Dosaje Etílico SUB DSP

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

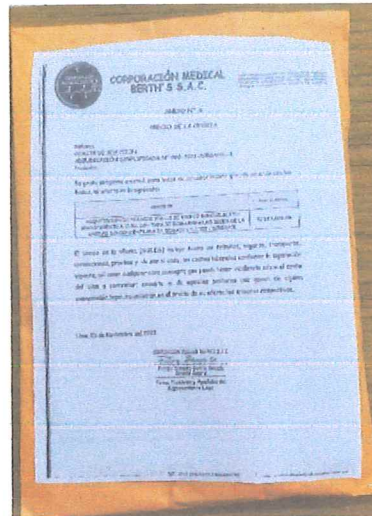

Entrega de muestras completas



Prueba de resistencia de Frascos viales



**PERÚ****Ministerio
del Interior****Policía
Nacional del Perú****Dirección de
Sanidad Policial****Unidad Desconcentrada
Dosaje Etílico SUB DSP****"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"****Empresa: Laboratorio Mundo Medic S.A.C.**

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO
1	FRASCOS VIALES DE VIDRIO X 10 ML	X	

Laboratorio Mundo Medic S.A.C.	SI	NO
Se verifica el cumplimiento de los términos de referencia presentada por el participante	X	
EVALUACION DEL PRODUCTO		
Se basa en verificar el acabado y color, dimensiones, resistencia, sellado, espesor de los envases.		
Envase de vidrio neutro de resistencia hidrolítica Tipo I	X	
Apropiado para sangre y hemoderivados.	X	
Vial incoloro	X	
Diámetro externo de boca: 19.80mm ± 0.25 aprox.	X	
Diámetro interno de boca: 12.60mm ± 0.25mm aprox.	X	
Espesor de labio: 3.60 ± 0.20mm aprox.	X	
Espesor de fondo: 0.70 mínimo.	X	
Diámetro de cuerpo: 22.50 ± 0.25mm aprox.	X	
Radio de fondo: 1.50 aprox.	X	
Concavidad: 1.00 máximo.	X	
Altura total: 46.50 mm ± 0.50mm aprox.	X	
Espesor de pared: 1.10mm ± 0.5 aprox.	X	
ACABADO Y COLOR		
El acabado en las superficies de los frascos viales debe ser libre de manchas, burbujas, orificios, roturas, suciedad, deformaciones, mal sellado y cualquier otro defecto que afecte la funcionabilidad.	X	
PRUEBA DE RESISTENCIA		
Alta resistencia a los cambios térmicos. El material deberá resistir temperaturas de 110°C a más	X	
Material resistente a fuerza mecánica. No debe estallar, no debe rajarse a realizarse la ruptura.	X	
ENCARGADOS DE LA EVALUACION DE LAS MUESTRAS		
CRNL SPNP CABEZUDO REATEGUI José Dennis – Jefe de la UNIDDE		
CMDTE SPNP RUIZ MORA Rosa Antonia – Jefe de Logística de la UNIDDE		
LUGAR DONDE SE EVALUA LAS MUESTRAS		
UNIDAD DESCONCENTRADA DE DOSAJE ETILICO		
CONCLUSION		
Las muestras remitidas por la empresa Laboratorio Mundo Medic S.A.C., cumplen con todas las pruebas realizadas por el Área usuaria.		





PERÚ


Ministerio
del Interior

Policía
Nacional del Perú



Dirección de
Sanidad Policial

Unidad Desconcentrada
Dosaje Etílico SUB DSP

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

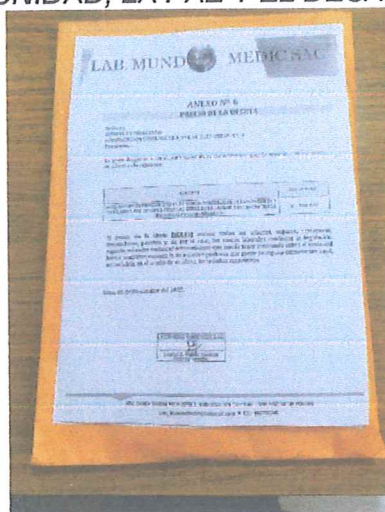

Entrega de muestras completas



Prueba de resistencia de Frascos viales



OS-271109
José Dennis CABEZUDO REATEGUI
CORONEL SPMP
JEFE UNIDAD DESCONCENTRADA
DOSAJE ETÍLICO SUBDIR DSP




OS-292859
Rosa Antonia RUIZ MORA
COMANDANTE SPNP
UNIDAD DESCONCENTRADA DE DOSAJE
ETÍLICO OFISECOM SUB. DSP

ANEXO N° 01

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 030-2023-DIRSAPOL-1, "ADQUISICION DE FRASCOS VIALES DE VIDRIO BOROSILICATO TRANSPARENTE x 10 ML CON TAPA DE GOMA PARA LAS SEDES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE DOSAJE ETILICO - DIRSAPOL"

DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA		CORPORACION MEDICAL BERTH'S S.A.C. RUC N° 20523370201	LABORATORIO MUNDO MEDIC S.A.C. RUC N° 20602215122
Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)		CUMPLE	CUMPLE
Copia del Certificado de Vigencia de Poder del Representante Legal		CUMPLE	CUMPLE
Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N°2)		CUMPLE	
Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)			
Adicionalmente, adjuntar folletos o catálogos o ficha técnica o manuales o carta del representante de la marca, SE ACEPTA TAMBIEN DOCUMENTO TECNICO (DE EMPRESA FABRICANTE) QUE INDIQUE QUE EL MATERIAL DE VIDRIO TIENE USO MEDICO PARA SANGRE Y HEMODERIVADOS , que permita corroborar de manera fehaciente el cumplimiento de las características técnicas solicitadas por el usuario; así mismo, se presentan en idioma español. Cuando los documentos no figuren en idioma español, se presenta la respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda.		CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)		CUMPLE	CUMPLE
Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)		NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
El precio de la oferta en Soles. Adjuntar obligatoriamente el (Anexo N° 6)		CUMPLE	CUMPLE
La presentación de muestras se realizará al momento de la presentación de ofertas, dichas muestras serán presentadas en: Horario de entrega: 08:00 am a 04:30 pm Lugar de Entrega: Mesa de partes del Area de Abastecimiento de la Unidad Ejecutora 020 – Sanidad de la PNP, sito: Av. Arequipa 4898, Miraflores, Lima. Cantidad de Muestras: Mínimo 15 viales con sus respectivas tapas y sus fichas técnicas de los bienes.		SEGÚN LA MUESTRA PRESENTADA SE INFORMA LO SIGUIENTE: -SI CUMPLE EN RELACION A ALTA RESISTENCIA A LOS CAMBIOS TERMICOS -NO CUMPLE EN RELACION A RESISTENCIA A FUERZA MECANICA SEGÚN INFORME DE VALIDACION DE MUESTRA REALIZADA POR LOS REPRESENTANTES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE DOSAJE ETILICO	SEGÚN LA MUESTRA PRESENTADA SE INFORMA LO SIGUIENTE: -SI CUMPLE EN RELACION A ALTA RESISTENCIA A LOS CAMBIOS TERMICOS -SI CUMPLE EN RELACION A RESISTENCIA A FUERZA MECANICA SEGÚN INFORME DE VALIDACION DE MUESTRA REALIZADA POR LOS REPRESENTANTES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE DOSAJE ETILICO
RESULTADOS		NO ADMITIDO	ADMITIDO



REQUISITOS DE CALIFICACION	CORPORACION MEDICAL BERTH'S S.A.C. RUC N° 20523370201	LABORATORIO MUNDO MEDIC S.A.C. RUC N° 20602215122
<p>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:</p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 24,500.00 (Veinticuatro Mil Quinientos con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes viales de vidrio, frascos de vidrio, tubos de vidrio.</p> <p>Acreditación:</p> <p><u>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</u></p>	-	CUMPLE
RESULTADOS		CALIFICADO

FACTORES DE EVALUACION	CORPORACION MEDICAL BERTH'S S.A.C. RUC N° 20523370201	LABORATORIO MUNDO MEDIC S.A.C. RUC N° 20602215122
PRECIO (100 PUNTOS)	S/ 117,600.00	S/ 98,000.00
RESULTADOS DE LA EVALUACION		

