

ANEXO N° 01:CUADRO DE ADMISIÓN DEL CONTENIDO DE LAS OFERTAS

AS-SM-01-2023-HRL-OEC-1

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.2.1 DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UM	CANT.	POSTORES	RESULTADO																		
					a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o)	p)	q)	r)	
1	ADQUISICIÓN DE DETERGENTE ENZIMATICO LIQUIDO, PARA EL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE	D A D	960	REPRESENTACIONES MEDICAS ROJAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	cumple	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Muestra, los proveedores deberán presentar obligatoriamente una (01) muestra del producto, y serán evaluadas por el área usuaria.	Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento. (BPA)	Certificado de buenas prácticas de almacenamiento (BPA) vigente, a nombre del proveedor, emitida por la ANM o ARM, según corresponda.	Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigente otorgado por la ANM.	Protocolo de análisis o certificado de análisis, suscrito por el personal responsable de control de calidad, en el que se señalan los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis con arreglo a las exigencias contempladas en la farmacopea o metodologías declaradas por el interesado en su solicitud de Registro Sanitario	Carta compromiso de canje por vicios ocultos	Carta de compromiso de canje por vencimiento del producto	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso. (Anexo N° 5)	El precio de la oferta. (Anexo N° 6)					
				ROKER PERU SA	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple			
				MEDISPEC PERU S.A.C.	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple		
				MARKETING MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.C	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple		


NOTA:

REPRESENTACIONES MEDICAS ROJAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA


Según lo solicitado en las bases en el literal e) presentación de muestras, para la aplicación del test de bioluminiscencia y la evaluación de muestras según se detalle en las bases integradas y la guía de procedimiento asistencial de enfermería en validación del lavado mecánico y manual del instrumental mediante Test de Bioluminiscencia adjuntada a las bases, según consta en el Acta de aplicación del Test de Bioluminiscencia se evidencia que la muestra presentada por el postor REPRESENTACIONES MEDICAS ROJAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, genero espuma, lo cual no estaría cumpliendo con la característica del detergente requerido que es NO ESPUMOSO, finalmente contando con la evaluación realizada por el área usuaria (ANEXO N° 01), El Órgano Encargado de las Contrataciones señala que la oferta queda NO ADMITIDA.

ROKER PERU SA

Según lo solicitado en las bases integradas en el literal e) presentación de muestras, para la aplicación del test de bioluminiscencia y la evaluación de muestras según la guía de procedimiento asistencial de enfermería en validación del lavado mecánico y manual del instrumental mediante Test de Bioluminiscencia adjuntada a las bases, según consta en el Acta de aplicación del Test de Bioluminiscencia se realizó la evaluación de la muestra presentada por el postor ROKER PERU SA, dando como resultado del test de bioluminiscencia aplicado a la muestra un VALOR DE 55 URL, siendo el rango máximo de aceptación 0 - 50 URL, lo cual no estaría cumpliendo con la característica del detergente en la muestra a través de Eficacia de la limpieza: resultado de prueba de test bioluminiscencia, finalmente contando con la evaluación realizada por el área usuaria(ANEXO N° 01), El Órgano Encargado de las Contrataciones señala que la oferta queda NO ADMITIDA.



ANEXO N° 02 :CUADRO DE EVALUACION Y CALIFICACION DEL CONTENIDO DE LAS OFERTAS													
AS-SM-01-2023-HRL-OEC-1													
ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	POSTOR	VALOR ESTIMADO	FACTORES DE EVALUACIÓN				CALIFICACIÓN	RESULTADO		
						OFERTA	PRECIO PUNTAJE	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN				
1	ADQUISICIÓN DE DETERGENTE ENZIMATICO LIQUIDO, PARA EL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE	U N I D A D	9 6 0	MEDISPEC PERU S.A.C.	S/. 345,600.00	S/.384,000.00	87.25	87.25 Puntos	2°	CUMPLE	CALIFICADA		
				MARKETING MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.C					100.0	100 Puntos	1°	CUMPLE	CALIFICADA



**GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE
HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE
ÁREA QUIRÚRGICA-CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN**


**ACTA DE APLICACIÓN DEL TEST DE
BIOLUMINISCENCIA**


Siendo el día 24 de Abril del 2023, a horas 11:00am se hicieron presentes a las instalaciones de la UPSS Central de Esterilización, el Sr. Alvaro Chavez Monteblanco, con DNI 47616945 y la Srta. Elies María Gomez Penoth, con CE 004432127, representantes de 02 postores de la Adjudicación Simplificada 01-2023-HRL-OEC., con la finalidad de observar y brindar transparencia a la aplicación de test de Bioluminiscencia a las diferentes muestras ofertadas.

Los resultados del test de Bioluminiscencia fueron los siguientes:

POSTOR	MEDISPEC	MMI	ROCKER	ROJAS
RESULTADO	18 URL	24 URL	55 URL	42 URL

Firman los presentes:


Elies Gomez
004432127

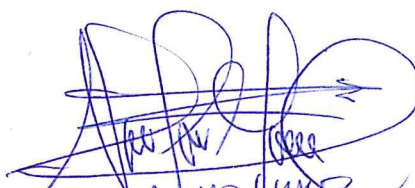
Alvaro Chavez
47616945


CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
GLORIA YSABEL CASIRO MEGO
LICENCIADA EN ENFERMERA
CEP: 55330
REG: 27378.

CHICLAYO, 24 DE ABRIL 2023

ITEM EVALUADO	POSTOR N°1		POSTOR N°2		POSTOR N°3		POSTOR N°4	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	MEDISPEC PERU		MMI		ROCKER		ROJAS	
EVALUACION DEL GALÓN:								
Envase de polietileno, cierre hermético con precinto de seguridad o tapa con sello de seguridad Industrial interno.	Sí		Sí			No	Sí	
Exento de partículas extrañas.	Sí		Sí		Sí		Sí	
Rotulado y/o etiqueta impreso en el envase junto a las instrucciones uso del producto.	Sí		Sí		Sí		Sí	
No menor de 3.785 ml	Sí		Sí		Sí		Sí	
CARACTERÍSTICAS DEL DETERGENTE ENZIMÁTICO LÍQUIDO								
Detergente enzimático Líquido.	Sí		Sí		Sí		Sí	
Detergente enzimático PH neutro, (7 +/- 0.1).	Sí		Sí		Sí		Sí	
Se utiliza para lavado manual y mecánico.	Sí		Sí		Sí		Sí	
Contiene de dos enzimas a más, proteasa indispensable.	Sí		Sí		Sí		Sí	
Contiene tensioactivos y/o secuestrantes.	Sí		Sí		Sí		Sí	
Certificación que el proceso de elaboración no daña a la naturaleza o al medio ambiente y/o Biodegradable de 97% a más vigente	Sí	99.7 %	Sí	100 %	Sí	ISSO 14001:2015	Sí	100% En 28 días.
Bacteriostático y/o antimicrobiano.	Sí		Sí		Sí		Sí	
No tóxico, adjunta certificación de organismo o laboratorio nacional o internacional indicando metodología y/o presentación de estudios vigente, (no mayor 10años).	Sí		Sí		Sí		Sí	
Presenta ficha de seguridad vigente, (no mayor 10años).	Sí		Sí		Sí		Sí	
No abrasivo.	Sí		Sí		Sí		Sí	
No espumoso.	Sí		Sí		Sí		Sí	No
Acción sinérgica instantánea.	Sí		Sí		Sí		Sí	
Acción constante del detergente.	Sí		Sí		Sí		Sí	
Indicaciones de uso en idioma español.	Sí		Sí		Sí		Sí	
Eficacia de la limpieza: resultado de prueba de Test Bioluminiscencia.	Sí	18 URL	Sí	24 URL	Sí	No 55 URL	Sí	42 URL







 CLINICA DE ESTERILIZACIÓN
 GLOMÉRULO DE ESTERILIZACIÓN
 LICENCIADA EN ENFERMERÍA
 C.P.R. 55330
 REC: 27378

Firma y sello de la Licenciada Especialista evaluadora de Central de Esterilización del Hospital Regional Lambayeque.

EVIDENCIA DEL NO CUMPLIMIENTO

ROCKER:

Se observó humedad en la parte externa de la galonera, desde la tapa hacia abajo, evidenciados notoriamente que mojó su rótulo, por lo tanto no presenta cierre hermético:

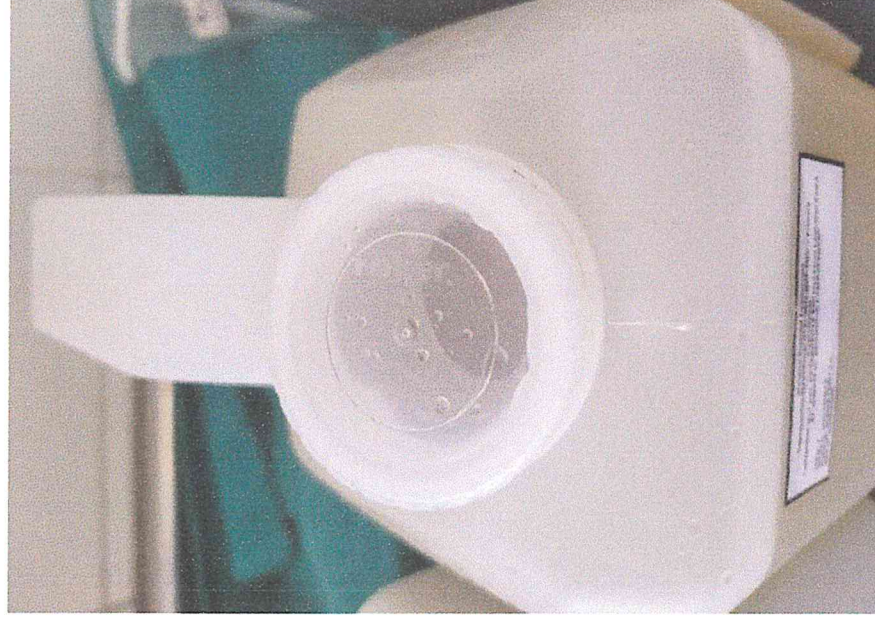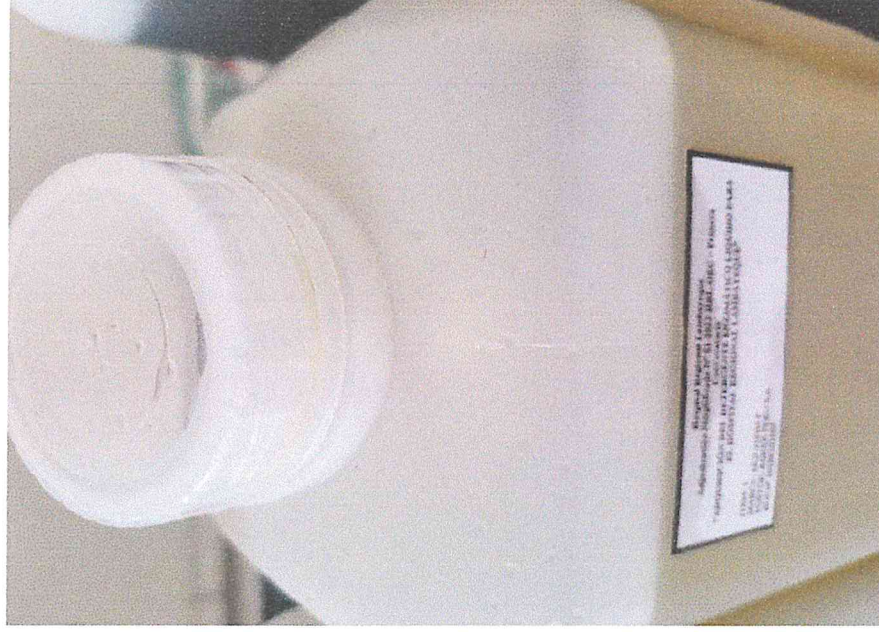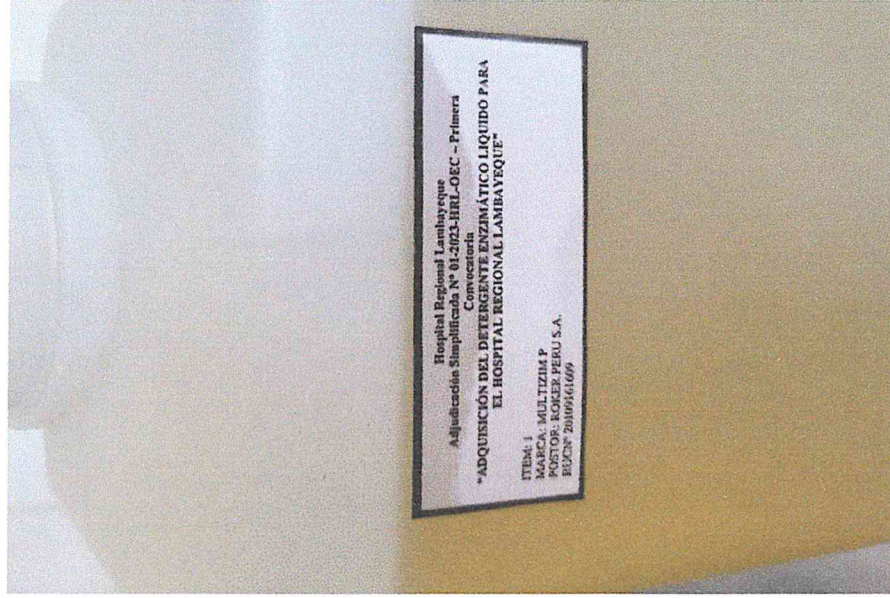


CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
Gloria Ysabel Casaromego
LICENCIADA EN ENFERMERA
CEP: 55330
REG: 27378

No alcanzó los valores establecidos para la prueba del Test de Bioluminiscencia:








CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
GLORIA YONDERCAS ROTUNDO
LICENCIADA EN ENFERMERIA
CEP: 55530
REC: 27378.

Generó espuma desde el inicio hasta el final de la prueba:

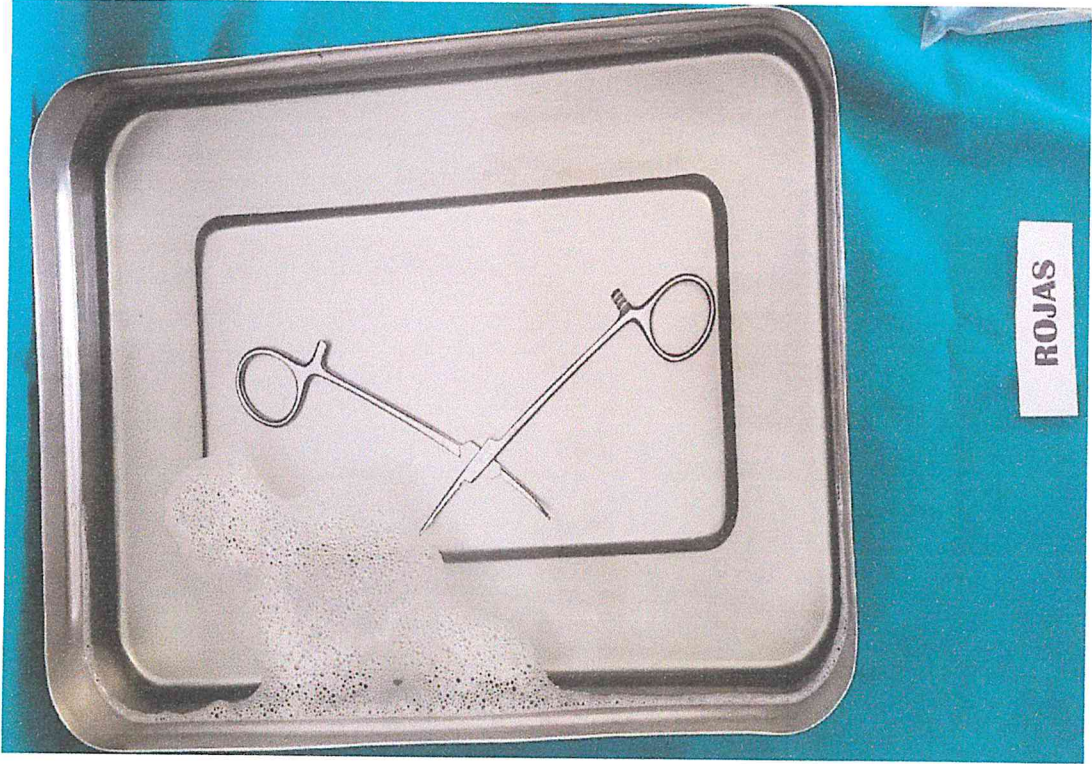

CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
GLORIA TSABELCAS ROTMEO
LICENCIADA EN ENFERMERIA
CEP: 55330
REC: 27378.

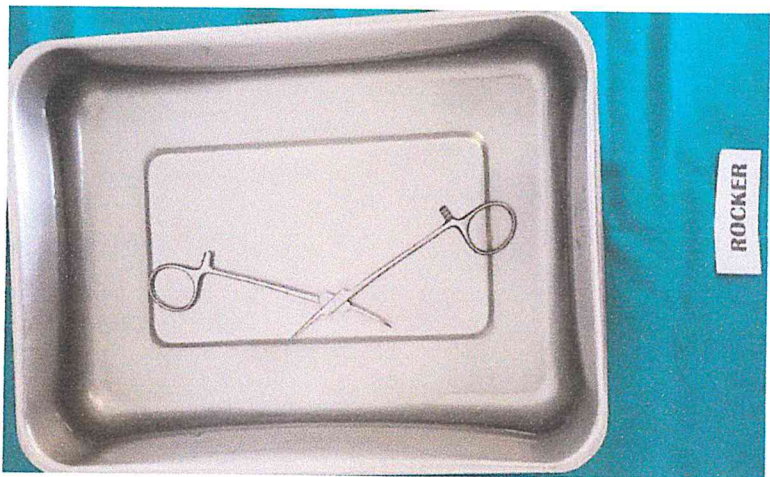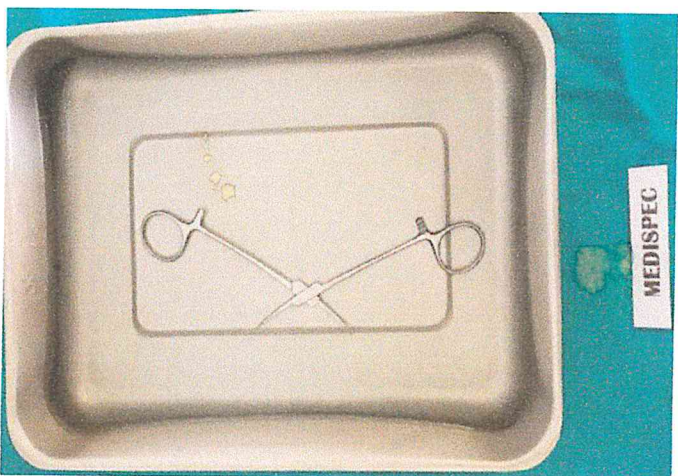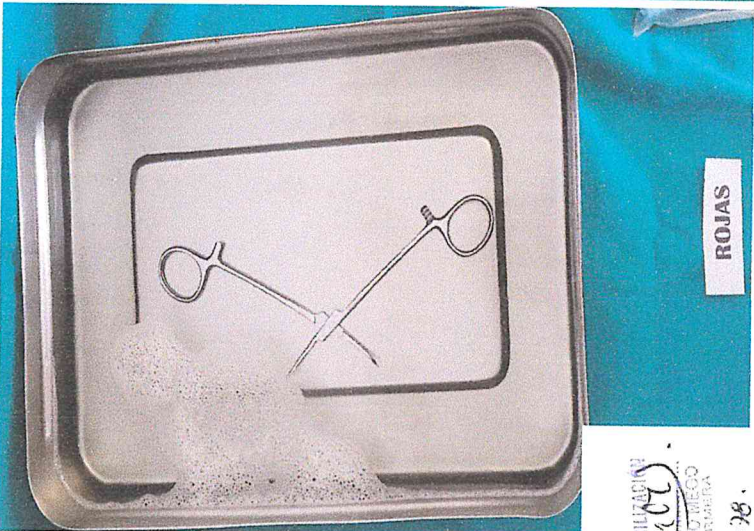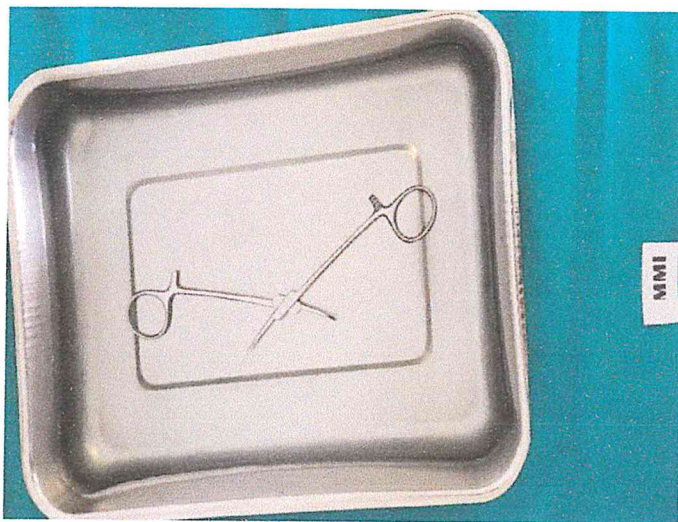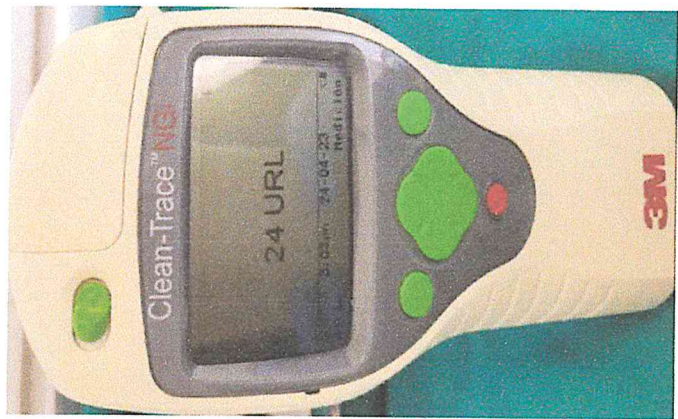

LABORATORIO DE ESTERILIZACIÓN
Bea Guitiérrez
GLICERINA ALCOHOLIZADA
LICENCIADA EN ESTERILIZACIÓN
REC: 24378.