

FORMATO N° 11

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

1	NÚMERO DE ACTA	001-2023-LPN°08-COMITÉ DE SELECCIÓN
----------	-----------------------	-------------------------------------

2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL
<p>En, la ciudad de Trujillo, a los 31 días del mes de octubre del año 2023, en el local del GERESALL, a las .08:00 horas, se reunieron los integrantes del COMITE DE SELECCION designados mediante FORMATO N°04, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de LP N°08-2023-GERESALL , cuyo objeto de convocatoria es "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO DE HEMOGLOBINÓMETRO - EQUIPAMIENTO DE LAS 327 IOARR'S EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES INCORE DEL DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", a fin de efectuar la APERTURA DE SOBRES, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.</p> <p>Nota.- En caso las actuaciones se realicen en diversos días, precisar la fecha, hora y local de las sesiones realizadas durante la evaluación y calificación de las ofertas, en el acto que corresponda.</p>	

3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)					
	El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
	Presidente	Econ. Angel Daniel Tejada Nuñez	Titular	X	Dependencia:	UTF - ABASTECIMIENTO
			Suplente			
	Primer Miembro	Ing. Renato Andreé Castillo Núñez	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION
			Suplente			
	Segundo Miembro	Ing. Lourdes de Fatima Rodriguez Llican	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION
			Suplente			

4

DETALLE DE LOS PARTICIPANTES		
De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:		
Nº	Nombre o razón social del participante	RUC
1	BIOLAB E.I.R.L.	20452274214
2	BAYOMED HEALTH PERU SAC	20480981775
3	PERLONGMEDIC E.I.R.L.	20494270421
4	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	20501887286
5	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	20524800510
6	CORPORACION DACMAR S.A.C.	20529457554
7	CHAPOLAB SAC	20545792177
8	SIMED PERU S.A.C.	20553853355
9	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	20565935861
10	CORPORACION CHEMICALS S.A.C.	20601595436
11	MEDIGETS CORPORATION E.I.R.L.	20604156476
12	GRUPO RG MEDIC S.A.C.	20604732019
13	TAMI SERVICIOS Y VENTAS E.I.R.L.	20604822964
14	INVERSIONES MITHIALI MEDIC S.A.C.	20606919388
15	CHAPOMEDIC S.A.C.	20607779695
16	CIENTIFICA INCA S.A.C.	20609157080
17	MANUFACTURA CAPITALMEDIC S.A.C.	20609607123
18	DROGUERIA DRUG MEDICAL S.R.L.	20610760407

5	DETALLE DE LOS POSTORES			
	En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad sus ofertas en sobre cerrado:			
	Nº	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación

FORMATO N° 11 ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN: BIENES (PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)				
1	1	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	23/10/2023	21:58:27
	2	BIOLAB-DDM MEDICAL	23/10/2023	23:30:42
	3	SIMED PERU S.A.C.	23/10/2023	19:31:02
	4	CIENTIFICA INCA SAC - CORPORACION CHEMICALS SAC	23/10/2023	15:59:22
	5	CHAPOLAB SAC	23/10/2023	22:31:49
6	Acto seguido, se procede con la apertura de los sobres que contienen las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.			
7	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:			
	N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión	
	1	SIMED PERU S.A.C.	SEGÚN ANEXO: INFORME N° 001-2023-GRLL-GGR-GRS-OP/LFRLL-RACN-LP N°08-2023-GERESA/LL	
	2	BIOLAB-DDM MEDICAL	SEGÚN ANEXO DE ADMISION N°01	
	3	CHAPOLAB SAC	SEGÚN ANEXO: INFORME N° 001-2023-GRLL-GGR-GRS-OP/LFRLL-RACN-LP N°08-2023-GERESA/LL	
8	DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación; sin embargo el comité de selección advierte una posible documentación adulterada (ficha técnica) por el postor DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C., cabe recalcar que este colegiado debe hacer presunción de la veracidad según jurisprudencias del TCE. Se deja constancia para su control posterior.			
	N°	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula	
	1	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	ITEM 1	
	2	CIENTIFICA INCA SAC - CORPORACION CHEMICALS SAC	ITEM 1	
9	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS			
	9.1	DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA		
	N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
	1	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	1,667,820.00	96.03
	2	CIENTIFICA INCA SAC - CORPORACION CHEMICALS SAC	480,700.00	27.68
	9.2	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo que forma parte de la presente Acta.		
10	PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES			
	COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR			
	10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	
		FACTORES	PUNTAJES	

FORMATO N° 11

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

	PRECIO	24.50 puntos
	PLAZO DE ENTREGA	15 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	39.50 puntos
10.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2	CIENTIFICA INCA SAC - CORPORACION CHEMICALS SAC
	FACTORES	PUNTAJES
	PRECIO	85 puntos
	PLAZO DE ENTREGA	15 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos

11	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	
	De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:	
	N° DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR
	1	CIENTIFICA INCA SAC - CORPORACION CHEMICALS SAC
	2	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.
	PUNTAJE TOTAL	
		100
		39.5
	Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.	

12	CALIFICACIÓN	
	Luego de culminada la evaluación, el COMITÉ DE SELECCION determinó si el postor que obtuvo el primer y segundo lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:	
12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	CIENTIFICA INCA SAC - CORPORACION CHEMICALS SAC
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE NO CUMPLE
	A EXPERIENCIA DEL POSTOR	
	A.1 FACTURACIÓN	X
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN	
12.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE NO CUMPLE
	A EXPERIENCIA DEL POSTOR	
	A.1 FACTURACIÓN	X
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN	
12.3	DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS	
	La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación, según Anexos que forma parte de la presente Acta.	

13	RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN	
	De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el SEGUNDO lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:	
N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR	
1	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	
	DE SER EL CASO INCLUIR:	
	Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases:	
N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN
1	CIENTIFICA INCA SAC - CORPORACION CHEMICALS SAC	ANEXO ADJUNTO

FORMATO N° 11 ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN: BIENES (PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)	
14	ACUERDO ADOPTADO <p>Los integrantes del COMITE DE SELECCION, por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.</p>
15	<div style="text-align: center;">  Econ. Angel Daniel Tejada Nuñez </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 100px;"> <div style="text-align: center;">  Ing. Renato André Castillo Nuñez </div> <div style="text-align: center;">  Ing. Lourdes de Fatima Rodriguez Llican </div> </div>
NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

ANEXO DE ADMISION N°01

LP-08-2023-GERESALL

ADQUISICION DE HEMOGLOBINOMETRO

418 UNIDADES

MONTA DISPONIBLE

S/ 1,736,790.00

MARCA PROCEDENCIA	CELERES -H7 CHINA	KONSUNG -H7 CHINA	KONSUNG -H7 CHINA	HEMO CONTROL ALEMANIA	HEMOQUE POLONIA
POSTORES	CONSORCIO CIENTIFICA INCA SAC	CHAPOLAB SAC.	CONSORCIO BIOLAB	DIAGNOSTICA PERUANA SAC	SIMED PERU SAC
DOCUMENTOS PARA ADMISION DE OFERTAS ITEM 01	ANEXO 01	ANEXO 01	ANEXO 01	ANEXO 01	ANEXO 01
DECLARACION JURADA DEL POSTOR ANEXO 01	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
COPIA CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL COPIA DE DNI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DECLARACION JURADA ANEXO 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 01	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE - EVALUACION TECNICA ADIUNTA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE - EVALUACION TECNICA ADIUNTA
GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN ITEM 1	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE- AL PRESENTAR UN DOCUMENTO DECLARANDO POR LA PERSONA ROSANA MARIELLA CRUZ MENESES Y FIRMADO POR EL APODERADO DE BIOLAB, NO TENIENDO COHERENCIA.	CUMPLE	CUMPLE
REGISTRO SANITARIO O DECLARACION JURADA	CUMPLE	CUMPLE	NO ACREDITA EL ANEXO 11 DE LAS MICROCUBETAS	CUMPLE	CUMPLE
DECLARACION JURADA DE POST VENTA ITEM 01	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE- AL PRESENTAR UN DOCUMENTO DECLARANDO POR LA PERSONA ROSANA MARIELLA CRUZ MENESES Y FIRMADO POR EL APODERADO DE BIOLAB, NO TENIENDO COHERENCIA.	CUMPLE	CUMPLE
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE ENTREGA ANEXO 4 ITEM 01	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PROMESA DE CONSORCIO	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE, EL FORMATO ESTABLECIDO POR EL OSCE NO HA SIDO RESPETADO, SE HA OBLIADO "Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado" NO HA LEGALIZADO LAS FIRMAS	NO APLICA	NO APLICA
PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES ANEXO 06 ITEM 1	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DOCUMENTACION DE PRESENTACION FACULTATIVA	APLICA—PERO NO PRESENTAN ANEXO DE SOLICITUD	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
BONIFICACION DE MYPE	5%				
PUNTAJES					
VALOR OFERTA ITEM 01	S/ 480,700.00	S/ 571,406.00	S/ 459,800.00	S/ 1,667,820.00	S/ 355,300.00
% DEL VALOR DE OFERTA ITEM 01	27.68%	32.90%	26.47%	96.03%	20.46%

85			24.50
15			15
100.00			39.50
0.00			0.00
100.00			39.50

28

1. 姓名	2. 性别	3. 年龄	4. 籍贯	5. 民族	6. 职业	7. 文化程度	8. 政治面貌	9. 婚姻状况	10. 健康状况	11. 兴趣爱好	12. 特长	13. 其他
张三	男	25	汉族	汉族	教师	大学	中共党员	已婚	良好	阅读	写作	
李四	女	30	汉族	汉族	医生	高中	民主党派	未婚	一般	运动	绘画	
王五	男	45	汉族	汉族	工程师	硕士	中共党员	已婚	良好	音乐	舞蹈	
赵六	女	20	汉族	汉族	学生	高中	共青团员	未婚	良好	阅读	写作	
孙七	男	35	汉族	汉族	公务员	大学	中共党员	已婚	良好	运动	绘画	
周八	女	28	汉族	汉族	护士	高中	民主党派	未婚	一般	音乐	舞蹈	
吴九	男	50	汉族	汉族	教授	博士	中共党员	已婚	良好	阅读	写作	
郑十	女	18	汉族	汉族	学生	初中	共青团员	未婚	良好	运动	绘画	
冯十一	男	40	汉族	汉族	经理	大学	中共党员	已婚	良好	音乐	舞蹈	
陈十二	女	32	汉族	汉族	会计	高中	民主党派	未婚	一般	阅读	写作	
林十三	男	22	汉族	汉族	程序员	大学	中共党员	未婚	良好	运动	绘画	
黄十四	女	27	汉族	汉族	设计师	高中	民主党派	未婚	一般	音乐	舞蹈	
徐十五	男	38	汉族	汉族	律师	大学	中共党员	已婚	良好	阅读	写作	
马十六	女	19	汉族	汉族	学生	高中	共青团员	未婚	良好	运动	绘画	
朱十七	男	42	汉族	汉族	工程师	大学	中共党员	已婚	良好	音乐	舞蹈	
李十八	女	31	汉族	汉族	教师	高中	民主党派	未婚	一般	阅读	写作	
王十九	男	24	汉族	汉族	程序员	大学	中共党员	未婚	良好	运动	绘画	
赵二十	女	26	汉族	汉族	设计师	高中	民主党派	未婚	一般	音乐	舞蹈	
孙二十一	男	36	汉族	汉族	律师	大学	中共党员	已婚	良好	阅读	写作	
周二十二	女	17	汉族	汉族	学生	初中	共青团员	未婚	良好	运动	绘画	
吴二十三	男	41	汉族	汉族	经理	大学	中共党员	已婚	良好	音乐	舞蹈	
郑二十四	女	33	汉族	汉族	会计	高中	民主党派	未婚	一般	阅读	写作	
冯二十五	男	23	汉族	汉族	程序员	大学	中共党员	未婚	良好	运动	绘画	
陈二十六	女	29	汉族	汉族	设计师	高中	民主党派	未婚	一般	音乐	舞蹈	
林二十七	男	39	汉族	汉族	律师	大学	中共党员	已婚	良好	阅读	写作	
黄二十八	女	16	汉族	汉族	学生	初中	共青团员	未婚	良好	运动	绘画	
徐二十九	男	43	汉族	汉族	工程师	大学	中共党员	已婚	良好	音乐	舞蹈	
马三十	女	34	汉族	汉族	教师	高中	民主党派	未婚	一般	阅读	写作	
朱三十一	男	25	汉族	汉族	程序员	大学	中共党员	未婚	良好	运动	绘画	
李三十二	女	30	汉族	汉族	设计师	高中	民主党派	未婚	一般	音乐	舞蹈	
王三十三	男	44	汉族	汉族	律师	大学	中共党员	已婚	良好	阅读	写作	
赵三十四	女	18	汉族	汉族	学生	初中	共青团员	未婚	良好	运动	绘画	
孙三十五	男	46	汉族	汉族	经理	大学	中共党员	已婚	良好	音乐	舞蹈	
周三十六	女	35	汉族	汉族	会计	高中	民主党派	未婚	一般	阅读	写作	
吴三十七	男	27	汉族	汉族	程序员	大学	中共党员	未婚	良好	运动	绘画	
郑三十八	女	37	汉族	汉族	设计师	高中	民主党派	未婚	一般	音乐	舞蹈	
冯三十九	男	47	汉族	汉族	律师	大学	中共党员	已婚	良好	阅读	写作	
陈四十	女	19	汉族	汉族	学生	初中	共青团员	未婚	良好	运动	绘画	
林四十一	男	49	汉族	汉族	工程师	大学	中共党员	已婚	良好	音乐	舞蹈	
黄四十二	女	36	汉族	汉族	教师	高中	民主党派	未婚	一般	阅读	写作	
徐四十三												

N° F001 - 00009963

CORPORACION CHEMICALS S.A.C.
JR. CHANCAY NRO. 531, LIMA, LIMA, LIMA
chemicalsglass@hotmail.com
943482124/943752521

20607977479

SANTA CRUZ MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 3756 URB. SAN BORJA NORTE - SAN BORJA

DIRECCIÓN
AV. JAVIER PÉREZ
1155 - LIMA

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
27/09/2021	27/09/2021

ITEM	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	5000	CAJ	MASCARILLA 3 PLEGUES COLOR CELESTE X 50 UND	6.00	30,000.00
02	10200	UND	MASCARILLA KN95 UND	1.00	10,200.00
03	200	UND	PARAFILM AZUL DE 44X250 - DEMIS	150.00	30,000.00
04	1000	90L	COBRE DESCARTABLE X 100 UND	14.00	14,000.00
05	1000	BOL	CUBRE CALZADO ANTIDESLUZANTE X 100 UND	23.00	23,000.00
06	100	UND	TELSOMETRO DIGITAL CONTEC MODELO DSD	100.00	10,000.00
07	2000	UND	PULSOMETRO CONTEC	45.00	90,000.00
08	10000	CAJ	MASCARILLA 3 PLEGUES UNDF/ COLOR NEGRO X 50 UND	8.00	80,000.00
09	16000	UND	MASCARILLA KN95 COLOR NEGRO	1.20	19,200.00
10	300	CAJ	GUANTES DE LATEX TALLA M X 100 UND - BILBAO	30.00	9,000.00
11	300	CAJ	GUANTES DE LATEX TALLA L X 100 UND - BILBAO	30.00	9,000.00
12	360	CAJ	GUANTES DE LATEX TALLA S X 100 UND - BILBAO	30.00	10,800.00
13	10	UND	CONCENTRADOR OLIVE 10L	4,700.00	47,000.00
SUB TOTAL \$/				313,550.32	
IGV 18% \$/				56,440.68	
TOTAL \$/					370,000.00



CORPORACION CHEMICALS

**FACTURA
ELECTRÓNICA**

N° F001 - 00007794

CORPORACION CHEMICALS S.A.C.
IR, CHANCAY NRO. 531, LIMA, LIMA

chemicalglass@hotmail.com
943482124/943752921

R.U.C. 20162406052
RAZÓN SOCIAL HOSPITAL REGIONAL DE ICA
DIRECCIÓN AV. PROLOG. AVIBACA COMATIANA NIPO. S/N HOSPITAL REGIONAL DE ICA
(PTE A LAS FARMACIAS) - ICA - (CA - ICA

FECHA DE EMISIÓN 02/03/2021
FECHA DE VENCIMIENTO 02/03/2021

ITEM	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	54	UND.	CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO PARA UCI MODELO ZIGOR, MARCA JHS, PROCEDENCIA PERU	25.500.00	1.377.000.00

SUB TOTAL S/1.166.949.15
IGV 18% S/ 210.050.85
TOTAL S/1.377.000.00

IMPORTE EN LETRAS UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CON 00/100 SOLES

N° DE ORDEN DE COMPRA

GUÍA DE REMISIÓN

CONDICIÓN DE PAGO

CONTADO

Representación impresa de la Factura Electrónica

Autorizada mediante Resolución de Intendencia No 034-005-0005315

Deposite en nuestras cuentas bancarias:

Banco	Moneda	N° de cuenta	N° de CCI
BBVA CONTINENTAL	SOLES	0011.0126.0100056149	
BCP	DOLARES	1912336846113	

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

INFORME N° 001-2023-GRLL-GGR-GRS-OP/LFRLL-RACN-LP N°08-2023-GERESA/LL

A: Eco. Ángel Daniel Tejada Núñez
Presidente del Comité de Selección LP N°08-2023-GERESA/LL

Asunto: RESULTADOS DE LA REVISIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA N°08-2023-GERESA/LL "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO DE HEMOGLOBINOMETRO".

Referencia:

- a) Correo electrónico con asunto: OFERTAS LP N° 08-2023-GERESA-LL L (24.10.2023)
- b) Bases integradas de la LP N°08-2023-GERESA/LL, disponible en el portal web del SEACE.

Fecha: Trujillo, 31 de octubre de 2023.

Nos es grato dirigirnos a usted para saludarlo y a la vez informarle sobre el resultado de la revisión técnica, en la que se ha verificado el cumplimiento de Especificaciones Técnicas de las propuestas, presentadas por las empresas postoras, de la LP N°08-2023-GERESA/LL "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO DE HEMOGLOBINOMETRO", teniendo en consideración las bases integradas, nos permitimos detallar lo siguiente:

1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES:

1.1. BASE LEGAL:

- Ley N° 27293, Ley Del Sistema Nacional De Inversión Pública y sus Modificatorias.
- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus Modificatorias.

1.2. ANTECEDENTES:

- Con fecha 24 de octubre de 2023, mediante referencia a), el presidente del Comité de Selección de la LP N°08-2023-GERESA/LL, solicita la evaluación técnica de las ofertas presentadas en el mencionado procedimiento de selección, el mismo que nos es derivado, para su atención correspondiente.

2. ANÁLISIS:

2.1. ÍTEM N° 1: HEMOGLOBINOMETRO:

2.1.1. EMPRESAS PARTICIPANTES: Las empresas postoras son las siguientes:

- 2.1.1.1. CONSORCIO BIOLAB E.I.R.L. Y DDM MEDICAL S.A.C.
- 2.1.1.2. CHAPOLAB S.A.C.
- 2.1.1.3. CONSORCIO CIENTIFICA INCA S.A.C. Y CORPORACION CHEMICALS S.A.C.
- 2.1.1.4. DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.
- 2.1.1.5. SIMED PERU S.A.C.

2.1.2. REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POSTORES:

Se procedió a realizar la revisión y verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, que corresponden en calidad de área usuaria, de las propuestas presentadas por los siguientes postores:

"Juntos por la Prosperidad"

Dirección: Calle Las Gemas N° 135 - Urb. Santa Inés. Anexo: Av. Mansiche N° 1130- Urb. Santa Inés.
Oficina de Planificación - E-mail: planificacion@diresalalibertad.gob.pe
Página Web: www.diresalalibertad.gob.pe

**Siempre
con el pueblo**

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"


2.1.2.1. CONSORCIO BIOLAB E.I.R.L. Y DDM MEDICAL S.A.C.

Respecto a la propuesta presentada por el mencionado postor, **SI CUMPLE** con los requerimientos técnicos mínimos establecidos por el área usuaria, los cuales están plasmados en las bases integradas para el **ITEM N° 1** de la **LP N°08-2023-GERESA/LL**, disponible en el portal del SEACE.

2.1.2.2. CHAPOLAB S.A.C.

Respecto a la propuesta presentada por el mencionado postor, **NO CUMPLE** con los requerimientos técnicos mínimos establecidos por el área usuaria, los cuales están plasmados en las bases integradas para el **ITEM N° 1** de la **LP N°08-2023-GERESA/LL**, disponible en el portal del SEACE.

El postor sustenta con diferentes modelos de equipos las especificaciones técnicas, haciendo mención en algunos folios al modelo "H7" y en otros al modelo "H7-3", lo cual no es concordante con su Hoja de Presentación en la que oferta el modelo H7-3, para su respectiva evaluación.

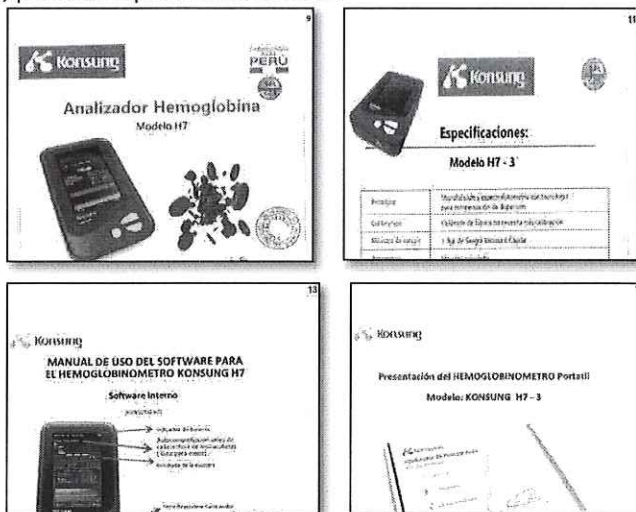

Existe contradicciones entre el sustento gráfico y literal. En la imagen presentada por el Postor (folio 15), se aprecia que el maletín de transporte no es rígido de plástico, a pesar que literalmente lo afirma; evidenciándose contradicciones entre ambos sustentos.



"Juntos por la Prosperidad"

Dirección: Calle Las Gemas N° 135 - Urb. Santa Inés. Anexo: Av. Mansiche N° 1130 - Urb. Santa Inés.

Oficina de Planificación - E-mail: planificacion@diressalalibertad.gob.pe

Página Web: www.diressalalibertad.gob.pe

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

2.1.2.3. **CONSORCIO CIENTIFICA INCA S.A.C. Y CORPORACION CHEMICALS S.A.C.**

Respecto a la propuesta presentada por el mencionado postor, **SI CUMPLE** con los requerimientos técnicos mínimos establecidos por el área usuaria, los cuales están plasmados en las bases integradas para el **ITEM N° 1** de la **LP N°08-2023-GERESA/LL**, disponible en el portal del SEACE.

2.1.2.4. **DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.**

Respecto a la propuesta presentada por el mencionado postor, **SI CUMPLE** con los requerimientos técnicos mínimos establecidos por el área usuaria, los cuales están plasmados en las bases integradas para el **ITEM N° 1** de la **LP N°08-2023-GERESA/LL**, disponible en el portal del SEACE.

2.1.2.5. **SIMED PERU S.A.C.**

Respecto a la propuesta presentada por el mencionado postor, **NO CUMPLE** con los requerimientos técnicos mínimos establecidos por el área usuaria, los cuales están plasmados en las bases integradas para el **ITEM N° 1** de la **LP N°08-2023-GERESA/LL**, disponible en el portal del SEACE.

El Postor sustenta el numeral 1.09 de las especificaciones técnicas, (folio 26) de su oferta, mediante carta de fabricante, donde indica lo siguiente:

"(...) Se verifica automáticamente el desempeño del analizador cada vez que se enciende y cada dos horas durante el uso. Se llevan a cabo controles de calidad adicionales (...)"



24

Angelholm February 2, 2021

Clarifying letter regarding HemoCue® Hb 201* and HemoCue® Hb 301 Systems

To whom it may concern

By this document, HemoCue AB, declares that HemoCue® Hb 201* Analyzer and HemoCue® Hb 301 Analyzer have internal quality control, the self-test. It automatically verifies the performance of the analyzer every time it is turned on and every second hour when in use. Additional quality controls are performed continuously when cuvette holder is in outer position and always prior to measurement.

HemoCue AB has issued this document in order to meet the request of SIMED, Peru.


Carta aclaratoria acerca de sistemas HemoCue® Hb 201* y HemoCue® Hb 301

A quien corresponda,

Bajo el presente documento, HemoCue AB declara que los equipos HemoCue® Hb 201* y los equipos HemoCue® Hb 301, disponen de control de calidad interno, el autodiagnóstico. Se verifica automáticamente el desempeño del analizador cada vez que se enciende y cada dos horas durante el uso. Se llevan a cabo controles de calidad adicionales cuando el soporte para cubetas está en posición de carga y siempre antes de una medición.

HemoCue AB ha emitido este documento con el propósito de atender la solicitud de SIMED, Perú.

HEMOCUE AB


Charlotta Blomstrand
Global Product Manager

No cumpliendo lo solicitado en el mencionado numeral, ya que sólo cuenta con **controles de calidad adicionales** cuando el soporte para cubetas esta en posición de carga y siempre antes de una medición, como lo manifiesta su carta de fabricante.

"Juntos por la Prosperidad"

Dirección: Calle Las Gemas N° 135 - Urb. Santa Inés. Anexo: Av. Mansiche N° 1130- Urb. Santa Inés.

Oficina de Planificación - E-mail: planificacion@diresalalibertad.gob.pe

Página Web: www.diresalalibertad.gob.pe

 **Siempre**
con el pueblo



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

El Postor en su propuesta técnica, no sustenta de acuerdo a las bases, el numeral 2.06 de las especificaciones técnicas.

3. CONCLUSIÓN:

3.1. Se realizó la revisión técnica de las propuestas para la la "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO DE HEMOGLOBINOMETRO" de la LP N°08-2023-GERESA/LL, los resultados de la revisión técnica se plasman en el ANEXO 01 adjunto al presente informe, siendo los postores que cumplen con los requerimientos técnicos mínimos establecidos por el área usuaria, los siguientes:

- ✓ CONSORCIO BIOLAB E.I.R.L. Y DDM MEDICAL S.A.C.
- ✓ CONSORCIO CIENTIFICA INCA S.A.C. Y CORPORACION CHEMICALS S.A.C.
- ✓ DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.


4. RECOMENDACIONES:

4.1. Se recomienda trasladar el presente informe, con los actuados a la fecha, al órgano encargado de las contrataciones o quien haga sus veces de la LP N°08-2023-GERESA/LL para que continúe con los procedimientos correspondientes para la, "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO DE HEMOGLOBINOMETRO", de la mencionada Licitación.

4.2. Así mismo se recomienda que una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se le haya asignado tal función realice la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro, tal como lo establece el artículo 64.6 del Reglamento.

Es todo cuanto podemos informar, para conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



Lourdes De Fatima Rodriguez Lican
ING. ELECTRONICO
R. CIP. N° 210202

REGION LA LIBERTAD
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
OFICINA DE PLANIFICACION


Ing. Mec. Renato Andree Castillo Nunez
C.I.P. 241117
UNIDAD FORMULADORA

"Juntos por la Prosperidad"

Dirección: Calle Las Gemas N° 135 - Urb. Santa Inés. Anexo: Av. Mansiche N° 1130- Urb. Santa Inés.

Oficina de Planificación - E-mail: planificacion@diresalalibertad.gob.pe

Página Web: www.diresalalibertad.gob.pe

 **Siempre**
con el pueblo

ANEXO 01

ITEM 1: RESULTADOS DE LA REVISIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS DE LA LP-SM-8-2023-GERESA/LL-1

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO DE HEMOGLOBINOMETRO"

POSTOR:	1. CONSORCIO BIOLAB E.I.R.L. Y DDM MEDICAL S.A.C.	2. CHAPOLAB S.A.C.	3. CONSORCIO CIENTIFICA INCA S.A.C. Y CORPORACION CHEMICALS S.A.C.	4. DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	5. SIMED PERU S.A.C.
MARCA	KONSUNG	KONSUNG	CELEREST	EKF DIAGNOSTICS	HEMOCUE
MODELO	H7-3	H7-3	H7	HEMO CONTROL	HB201
PROCEDENCIA	CHINA	CHINA	CHINA	ALEMANIA	SUECIA
CANTIDAD	418	418	418	418	418
GARANTÍA	2 AÑOS	2 AÑOS	2 AÑOS	2 AÑOS	2 AÑOS
OBSERVACIONES	<p>Cumple con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en las bases.</p> <p>El postor sustenta con diferentes modelos de equipos las especificaciones técnicas, haciendo mención en algunos folios al modelo "H7" y en otros al modelo "H7-3", lo cual no es concordante con su Hoja de Presentación en la que oferta el modelo H7-3, para su respectiva evaluación.</p> <p>Existe contradicciones entre el sustento gráfico y literal. En la imagen presentada por el Postor (folio 15), se aprecia que el maletín de transporte no es rígido de plástico, a pesar que literalmente lo afirma; evidenciándose contradicciones entre ambos sustentos.</p> <p>El Postor sustenta el numeral 1.09 de las especificaciones técnicas, (folio 26) de su oferta, mediante carta de fabricante, donde indica lo siguiente: "(...)" Se verifica automáticamente el desempeño del analizador cada vez que se enciende y cada dos horas durante el uso. Se llevan a cabo controles de calidad adicionales (...)"</p> <p>No cumpliendo lo solicitado en el mencionado numeral, ya que sólo cuenta con controles de calidad adicionales cuando el soporte para cubetas esta en posición de carga y siempre antes de una medición, como lo manifiesta su carta de fabricante.</p> <p>El Postor en su propuesta técnica, no sustenta de acuerdo a las bases, el numeral 2.06 de las especificaciones técnicas.</p>				